


# Liko løftebuks, mod. 92

## Brugsanvisning

PR7DK160161-01

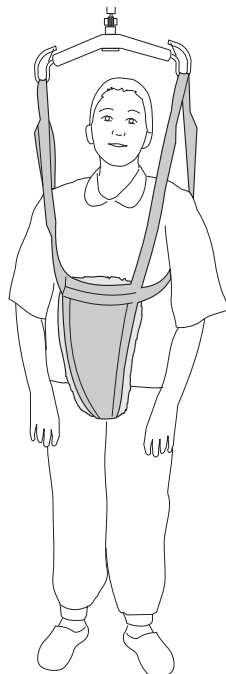

## Liko Løftebuks

Løftebuksen fremmer tryk og sikker stå- og gangtræning for personer med nedsat balance og dårlig funktion i benene. Den øgede tryghed giver ofte mod på at prøve lidt mere. Løftebuksen giver frihed til at bevæge sig med større eller mindre aflastning af kropsvægten. Den løfter på en sikker måde og gør det muligt for brugeren at gå og bevæge sig uden faldrisiko. Under træningen er liften klar til at tage hele belastningen mens bruger og hjælper kan koncentrere sig om træningen uden at være bange for konsekvenserne af et fejltrin.

Løftebuksen tager den største belastning i skridtet, hvilket er velegnet til brugere som ikke kan tåle tryk mod overkroppen. Polstringen aflaster mod tryk.

### Flere forskellige størrelser

Løftebuksen findes i flere størrelser for at kunne passe til brugere med forskellig højde og omfang.

### Valg af egnet lift

Løftebuksen kan bruges sammen med Likos loft- eller mobilifte.

Med en loftlift kan brugeren bevæge sig ubesværet indenfor liftens løfteområde. Vælg mellem: Likorall, Multirall eller Liko Masterlift.

Løftebuksen kan også bruges sammen med mobilift, især Golvo, Uno eller Viking. For nogle brugere kan det være en fordel at aflaste ved hjælp af armene, eksempelvis på liftens armstøtter (Golvo, Viking) eller på et gangstativ.

### Alternativ

Som alternativ til Løftebuksen anbefales Liko Løftevest, mod. 60 eller 64.


**△ er en advarselstrekant for steder hvor særlig forsigtighed bør iagttages.**

*I teksten kaldes personen som løftes for brugeren og den som hjælper til for hjælperen.*

**△ Læs brugsanvisning på både lift og løftesejl inden anvendelse.**

**Brugsanvisninger kan downloades gratis på [www.liko.com](http://www.liko.com).**


# Liko Løftebuks

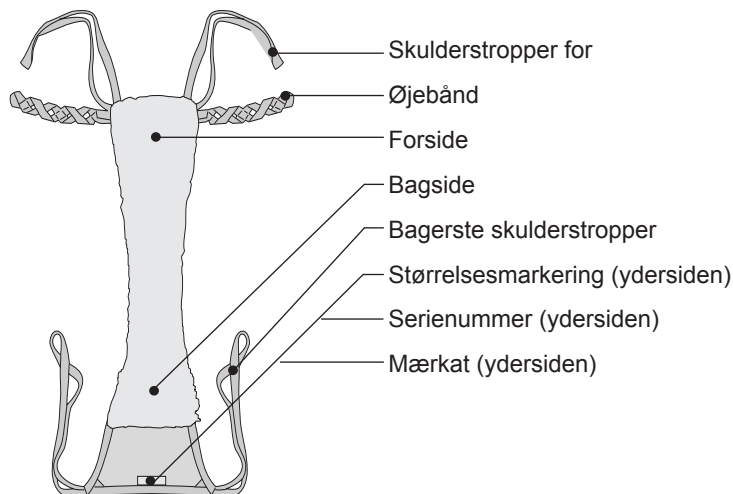

Patentsökt

## △ Sikkerhedsforeskrifter


- Om der er behov for en eller flere hjælpere, skal bedømmes for hvert tilfælde.
- Planlæg løftet før det udføres, så det sker så trygt og smidigt som muligt.
- Selv om Likos løftebøjler er forsynede med afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages: Før brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt er det vigtigt at kontrollere at båndøjerne sidder korrekt på løftebøjlen!
- Løft aldrig en bruger højere end hvad der er hensigtsmæssigt ift. brugerens forudsætninger. Juster liftens højeste løftehøjde for at umuliggøre en løftesituation hvor brugeren ufrivilligt bliver løftet for højt.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
- Sørg for at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste i løftesituationen.
- Kontroller at den lift som bruges har en nødsænkning som virker.

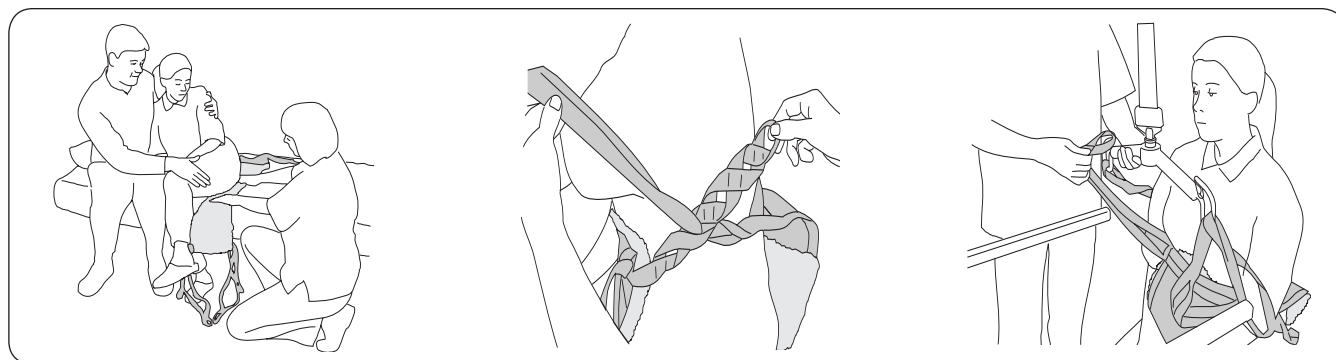

Udgangspunktet for at bruge løftebuksen er siddende. Brugeren læner sig til den ene side så løftebuksen kan placeres lige under stussen. Placer løftebuksen så langt ind under brugeren som muligt og med markering nedad/bag.

Løft den forreste del frem mellem benene så båndene bliver tilgængelige på forsiden. Træk de bagerste stropper igennem passende båndøjer.

Placer de bagerste og forreste skulderstropper på løftebøjlen. Det yderste båndøje er mest brugt.

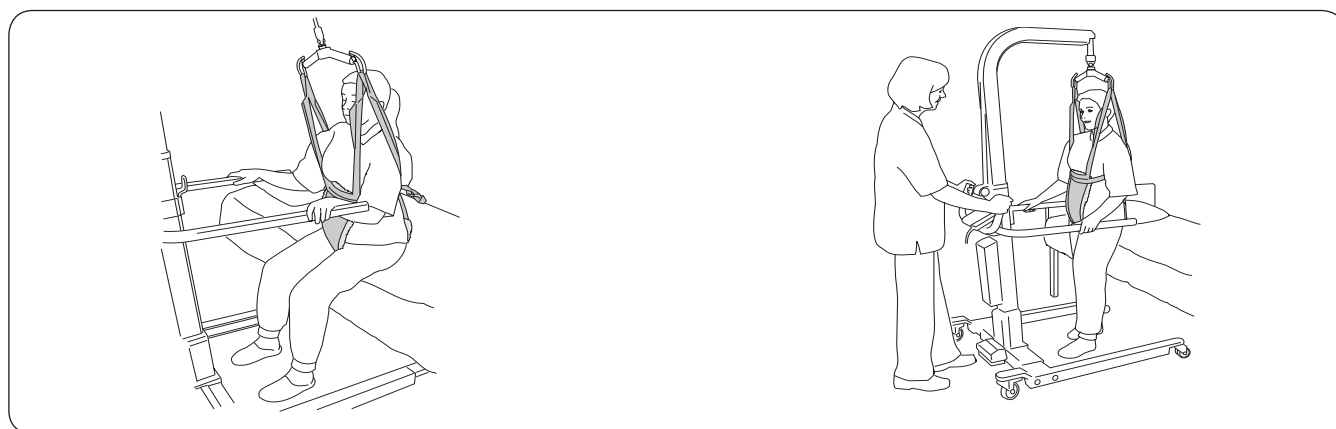

**Før oprejsning:** Sørg for at brugeren har fødderne stabilt på gulvet, for at belastningen kan overføres ved oprejsningen. Hæv liften en smule så båndene bliver strakt uden at stussen løftes og sikr at båndene strammer tilpas meget omkring livet.

**Under løftet:** Træk liften frem i gangretningen så vægtoverføringen sker korrekt til brugeren står oprejst, med god balance. Løft kun så meget som er nødvendigt for at brugeren bliver tilstrækkeligt oprejst men stadig har tilstrækkelig kontakt til gulvet.

## Justering af øjebånd


Båndene som sidder omkring overkroppen må hverken være for løse eller stramme for meget. En behagelig stramning er det bedste.



En tynd person kan have skulderstropperne igennem et af de inderste båndøjer.

En kraftig person må have skulderstropperne igennem et af de ydre båndøjer.

## Tilbehør til Liko Løftebuks

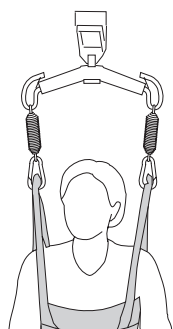

### Fjedre

Elastiske fjedre fås som tilbehør for at opnå en blødere, fjedrende bevægelse ved gangtræning.


De stimulerer det naturlige bevægelsesmønster og gør det lettere for brugeren at finde den rette gangteknik.

Likos Fjedre for brugervægt op til 70 kg fås i to længder:

- Lang 28 cm art.nr. 3156511
- Kort 22 cm art.nr. 3156512

Korte fjedre anbefales hvor løftehøjden er begrænset.


For brugervægt op til 100 kg: art.nr. 3156513.



### Polstring

Som tilbehør fås trykafastende polstring til montering på de forreste skulderstropper.

Polstringen er forsynet med velcrobånd i den ene langside og kan let fjernes/monteres.




### Øjeclips

Praktisk tilbehør til at afmærke individuelt afprøvet størrelse.

Det letter arbejdet for hjælperne at finde det korrekte øje/størrelse hver gang.

# Oversigt Liko Løftebuks mod. 92



Patentsøkt

Artikel	Art. Nr.	Størrelse	Brugervægt*	Brugerhøjde*	Materiale
Løftebuks	3592823	XS Extra Small	< 30 kg	< 130 cm	Polyester med bamsetryk
Løftebuks	3592324	S Small	20 - 50 kg	120 - 160 cm	Polyester netvæv
Løftebuks	3592325	M Medium	50 - 85 kg	160 - 180 cm	Polyester netvæv
Løftebuks	3592326	L Large	70 - 120 kg	170 - 200 cm	Polyester netvæv
Løftebuks	3592327	XL Extra Large	100 - 300 kg	170 - 210 cm	Polyester netvæv

\* N.B. Den angivne vægt/højde er kun vejledende – afvigelser kan forekomme.

## Vælg den rigtige størrelse

Løftebuksen skal nå op over taljen men ikke så højt at den trykker i armhulen.

En kraftig person kan have behov for en størrelse større end en tynd person på samme højde.

Likos løftesejl er godkendte til 200 kg eller mere, se produktmærkning.

## Vaskeanvisning:



Læs altid vaskeanvisningen på løftesejlets mærkning før vask!

## Anbefalede kombinationer med Liko Løftebuks og Likos løftebøjler

	Minibøjle 220	Smal 350	Universal 350	Standard 450	Universal 450	Universal 600	Bred 670	Univ. 670 Twin	Firepunktsbøjle	Krydsbøjle 450	Krydsbøjle 670
Løftebuks, XS	2	1	1	1	1	3	3	3	3	3	
Løftebuks, S	2	1	1	1	1	3	2	2	2	2	3
Løftebuks, M	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1
Løftebuks, L	3	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1
Løftebuks, XL	3	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1

### Forklaring:

- 1 Anbefales
- 2 Acceptabelt
- 3 Frarådes
- 4 U hensigtsmæssigt

Medicinteknisk klasse 1 produkt

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din Liko repræsentant for opdatering, information og råd.

## **Vigtigt!**

Løft og forflytning af en person indebærer altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til både lift og liftilbehør grundigt. Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugsanvisningen helt. Kun velinformeret personale bør anvende udstyret.

Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Vær forsigtig og omhyggelig ved anvendelsen.

Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed.

Du skal være informeret om dennes muligheder for at håndtere løftesituationen.

Kontrollér løftesejlet med regelmæssige mellemrum, især efter vask. Se efter slitage eller skader på sømme, stof og øjestropper. Brug ikke beskadiget liftilbehør.

Kontakt producenten/leverandøren, hvis du er i tvivl om noget. For kombinationer med lifte af andre fabrikater end Liko kontakt leverandøren.

**Liko**

[www.liko.com](http://www.liko.com)

Fabrikant:

**Liko AB**  
SE-975 92 Luleå  
Sweden  
info@liko.se

Forhandler i Danmark:

**A/S A.P. Botved**  
Nørrelundvej 5  
2730 Herlev  
Tlf: 80373737  
Fax: 70203737  
info@botved.dk

