


Måling for HospiTech A/S
 Madras: Sentry TS 508-8
 På madrassen: Kvinde 170 cm, 75 kg, BMI 29,95
 Målingen udført af Raskov og Co den 19-02-2014

19. februar 2014 10:28:46,385




Maximum (mmHg)	16.49
Average (mmHg)	6.28
Coefficient of variation (%)	57.24
Sensing area (cm ²)	6138.28
Regional distribution (%)	100.00




Udvalgt 4 trykmålingsbilleder der viser hvordan trykket skifter gennem en cyklus på 10 minutter.


19. februar 2014 10:33:13,639



19. februar 2014 10:34:51,883



19. februar 2014 10:37:24,741

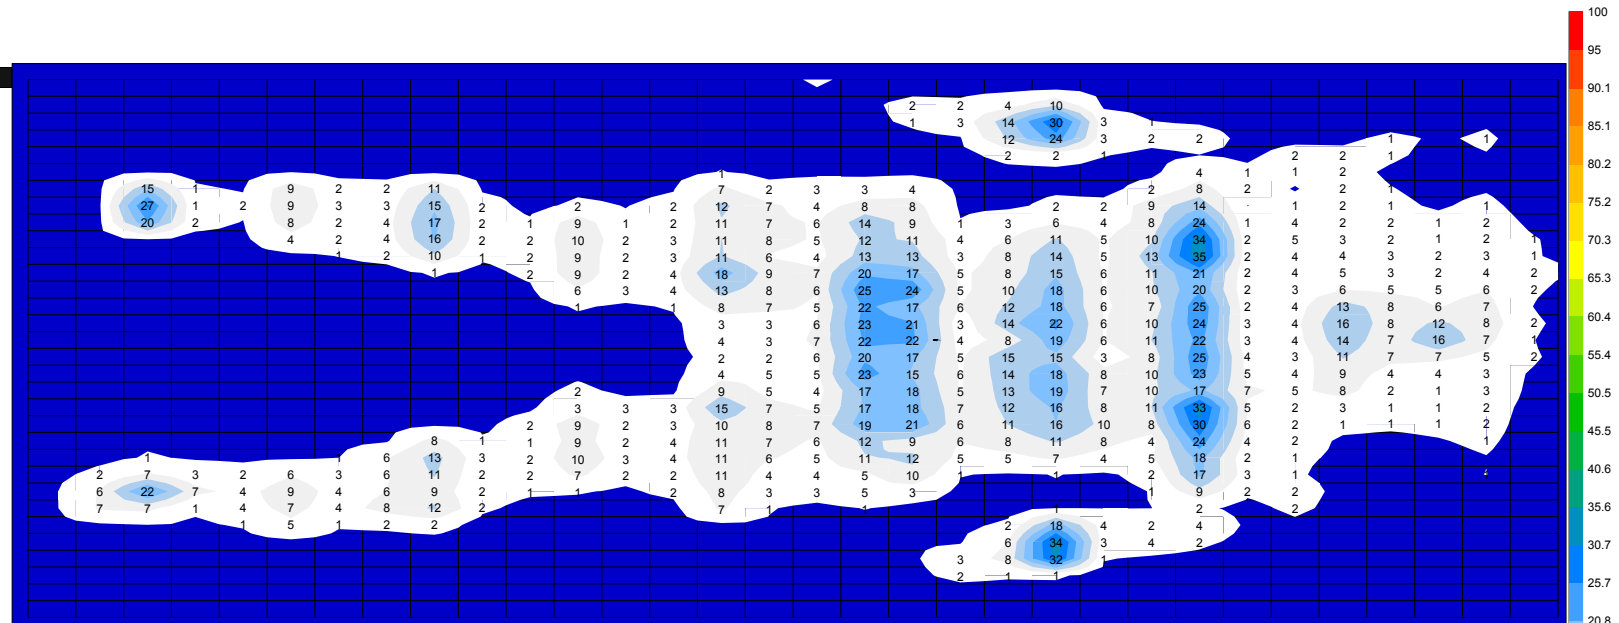

Maximum (mmHg)	35.09
Average (mmHg)	7.06
Coefficient of variation (%)	93.63
Sensing area (cm ²)	5897.81
Regional distribution (%)	100.00

