

INSTRUCTIONS FOR USE

Pentaflex Elegance

Mattress replacement



EN · DA · DE · ES · FR · IT · NL · RO · SR · SV · CS · KO · TH · RU
KK · TR · EL · BG · HR · UK · SL · SK · LV · LT · ET · HU · PL · VI

Brugsvejledning · Bedienungsanleitung · Instrucciones de uso · Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso · Gebruiksaanwijzing · Instrucțiuni de utilizare · Uputstvo za upotrebu
Bruksanvisning · Návod k použití · 사용 지침 · ការិយោគប្រាក់ងារ · Инструкция по эксплуатации
Пайдалану һүсқаулыры · Kullanım Talimatları · Οδηγίες χρήσης · инструкции за употреба
Upute za upotrebu · Інструкції з використання · Navodila za uporabo · Návod na používanie
Lietošanas pamācība · Naudojimo instrukcijos · Kasutusjuhend · Használati útmutató
Instrukcja obsługi · Hướng dẫn Sử dụng



WARNING

To avoid injury, always read this Instructions For Use and accompanied documents before using the product.



Mandatory to read the Instructions For Use.

Design Policy and Copyright

® and ™ are trademarks belonging to the Arjo group of companies.


© Arjo 2019.

As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice. The content of this publication may not be copied either whole or in part without the consent of Arjo.

Product Descriptions

Mattress replacement system

The Pentaflex® Elegance mattress replacement design comprises of a reversible 4-way turn, high resilience polyurethane core with 5 anatomical pressure redistributing zones per side, protected by a 2-way stretch, vapour permeable, water resistant cover.

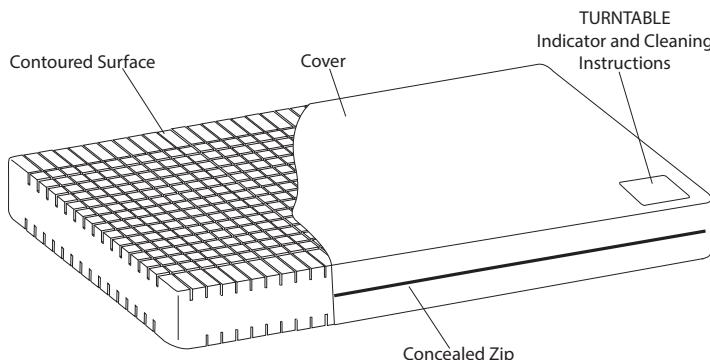

A Pentaflex Elegance foam squab (part no. SQB2) is available for use with in-built bed extensions, providing an extra 15 cm for the taller patient.

WARNING

Mattress handles are for mattress transport only.

Clinical applications

Indications for Use

Pentaflex Elegance is indicated for users up to 140 kg (308 lbs / 22 stones). Suitable for a wide range of patients including those with superficial ulcers (in association with an individualised plan of care).

Note: These are guidelines only and should not replace clinical experience or judgement. If there is no improvement in the patient's condition, specialist advice should be sought.

WARNING

The cover of this product is vapour permeable but not air permeable and may present a suffocation risk. It is the responsibility of the care giver to ensure that the user can use this product safely.

If a serious incident occurs in relation to this medical device, affecting the user, or the patient then the user or patient should report the serious incident to the medical device manufacturer or the distributor. In the European Union, the user should also report the serious incident to the Competent Authority in the member state where they are located.

Instructions for Use

Mattress replacement system:

1. Remove all packaging.
2. Lay the Pentaflex Elegance mattress replacement onto the bed frame, ensuring that there are no sharp edges which may rip the cover.

CAUTION

Do not use the mattress without a cover. It provides a protective barrier against biological contamination of the foam.

3. Ensure the correct month is showing on the Turntable™ indicator at the foot of the cover. If the incorrect month is showing, rotate the mattress to show correct month at the foot end. Months are indicated as follows:
1/12 = January
2/12 = February, etc.
4. Use the Turntable indicator as a guide for the monthly rotation and turning of the mattress. This helps to even out wear of the mattress and to extend the life of the product.

Decontamination

To Clean the Cover

Wipe all exposed surfaces with a cloth which has been moistened in simple detergent and water. Ensure to remove any organic debris that may be adherent to the surfaces. Dry thoroughly.

To Disinfect the Cover

For disinfection we recommend a chlorine-releasing agent such as NaOCl or NaDCC diluted to 1,000 ppm (range may vary between 250 & 10,000 ppm depending on contamination status and local policy).

Wipe with a cloth moistened with clean water and dry thoroughly.

Alternatively, use a cloth moistened with alcohol (70%) all allow to air dry.

Routine checks

The foam core and cover should be inspected regularly for any signs of damage, soiling or staining.

Technical Data

Typical Bed size	-	-	Acute Single Size	-	-	Community Standard Size	Community Double Size
Suitable for use on Arjo Bedframe	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 and 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 and Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 and 980	-	-
Size (cm) L x W x D x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Product Code	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Material	High resilience polyurethane foam						
Cover Material	Polyurethane coated polyester fabric with enhanced durability						

*Penta*flex Elegance mattresses are available in other custom made sizes, e.g. PEYYY/ZZZHx, where YYY specifies the length (between 140 and 216 cm), and ZZZ specifies the width (between 66 and 140 cm), Hx specifies the number of handles (available number of handles 2, 4, 5, 6 or 7). All sizes must be specified in increments of 2 cm.

When combining beds and mattresses outside the table given above, it is the customer's responsibility to ensure compatibility of mattress and bed frame. Please refer to your bed manufacturers recommended mattress sizes. For further details contact Arjo.

Fire retardancy:



System meets the requirements of BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, and BS 6807: 2006, 5.

FIRE WARNING

Cigarettes, lighters, naked flames and exposed heating elements e.g. in electric fires (and other electrical appliances) are sources of fire hazard and could ignite bed linen, blankets and clothing. It is essential that these fire sources are kept away from the mattress.

NB: It is highly dangerous to smoke in bed.

End of Life Disposal

The following advice is recommended:

- Fabric material used on the mattresses or any other textiles, polymers or plastic materials etc. should be sorted as combustible waste.
- Mattresses at the end of life should be disposed of as waste according to the national or local requirements which may be landfill or combustion.

Note: Follow all local regulations and, if applicable, healthcare facility standard operating procedures.

Warranty and Service

Standard terms and conditions apply to all sales. A copy is available upon request. These contain full details of warranty terms and do not limit the statutory rights of the consumer.

For service, maintenance, and any questions regarding this, or any other product, please contact your local distributor.

Symbols

	Recommended wash temperature: 15 min at 60°C Maximum wash temperature: 15 min at 95°C
	Do not iron
	Do not use phenol-based cleaning solutions
	Hospital name
	Tumble dry at 60°C Maximum drying temperature 80°C
	Wipe all surfaces with cleaning solution, then wipe with a cloth moistened with water and dry thoroughly.
	Date of first use
	Refer to user instructions
	Routine disinfection: 1,000 ppm. 1000ppm NaOCl NaDCC
	Fire retardancy
	Safe Working Load (SWL) 140 kg / 309 lb
	CE marking indicating conformity with European Community harmonised legislation
	Indicates the product is a Medical Device according to EU Medical Device Regulation 2017/745



ADVARSEL

For at undgå skader skal denne brugsvejledning og de medfølgende dokumenter altid gennemlæses, før produktet tages i brug.




Det er obligatorisk at gennemlæse brugsvejledningen.

Produktbeskrivelser

Helmadrassystem

Pentaflex® Elegance-helmadrassystemet består af en 4-vejs vendbar kerne af polyuretan med høj elasticitet og med 5 anatomiske trykfordelingszoner pr. side, som er beskyttet af et vandtæt og dampgennemtrængeligt betræk med 2-vejs stræk.

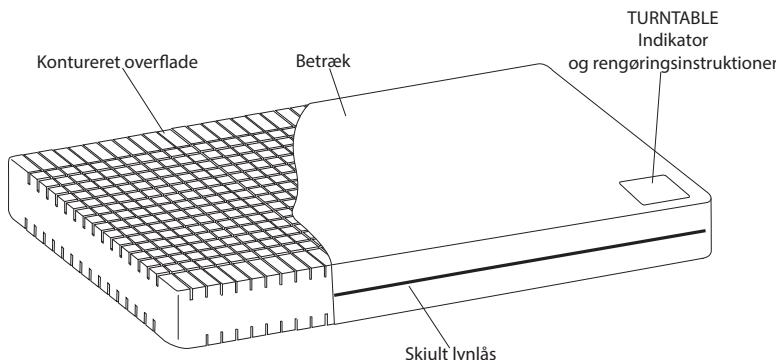

Der fås en Pentaflex Elegance-skumpude (varenr. SQB2), som kan anvendes sammen med indbyggede sengeførslængere og giver 15 cm ekstra til høje plejemandtagere.

ADVARSEL

Madrashåndtagene er udelukkende til transport af madrassen.

Klinisk anvendelse

Indikationer

Pentaflex Elegance er beregnet til brugere, der vejer op til 140 kg (308 lb/22 stones). Madrassen er egnet til mange slags plejemandtagere, herunder plejemandtagere med overfladesår (i samarbejde med en personlig behandlingsplan).

Bemærk: Dette er kun beregnet som en vejledning og må ikke erstatte klinisk vurdering eller erfaring. Hvis der ikke sker nogen forbedring i plejemandtagerens tilstand, skal der søges specialsthjælp.

ADVARSEL

Betrækket på dette produkt er dampgennemtrængeligt, men ikke luftgennemtrængeligt, og kan udgøre en kvælningsrisiko. Det er plejepersonalets ansvar at sikre, at plejemandtageren kan anvende dette produkt på forsvarlig vis.

Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelse med denne enhed, som påvirker brugeren eller plejemandtageren, så bør brugeren eller plejemandtageren rapportere den alvorlige hændelse til producenten af enheden eller forhandleren. I EU bør brugere også indberette den alvorlige hændelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra enheden kommer.

Brugsvejledning

Helmadrassystem:

1. Fjern al emballage.
2. Læg Pentaflex Elegance-helmadrassen på sengerammen, og sørge for, at der ikke er nogen skarpe kanter, der kan skære hul i betrækket.

FORSIGTIG

Anvend aldrig madrassen uden et betræk. Det fungerer som en beskyttelsesbarriere mod biologisk kontaminering af skummet.

3. Sørg for, at den korrekte måned vises på Turntable™-indikatoren ved betrækets fodende. Hvis den forkerte måned vises, skal madrassen vendes således, at den korrekte måned vises i fodenden. Måneder vises som følger:
1/12 = januar
2/12 = februar osv.
4. Anvend Turntable-indikatoren som vejledning til den månedlige rotation og vending af madrassen. På denne måde fordeles madrassens slitage, og produktets levetid forlænges.

Dekontaminering

Rengøring af betrækket

Tør alle overflader af med en klud, der er fugtet med almindelig vand og sæbe. Sørg for at fjerne alle organiske efterladenskaber, der sidder fast på overfladerne. Tør grundigt efter.

Desinfektion af betrækket

Til desinfektion anbefales et klorinfrigørende stof, såsom NaOCl eller NaDCC, fortynet op til 1.000 ppm (mængden kan variere mellem 250 og 10.000 ppm alt afhængig af kontamineringsgraden og lokal praksis).

Aftør med en klud fugtet med rent vand, og tørgrundigt efter.

Alternativt anvendes en klud fugtet med sprit (70 %), hvorefter overfladen lufttørres.

Rutinemæssig kontrol

Skumkernen og betrækket bør kontrolleres jævnligt med henblik på at konstatere tegn på skade, snavs eller pletter.

Tekniske data

Typisk sengestørrelse	-	-	Enkeltstørrelse ved akutbehandling	-	-	Standardstørrelse i lokalområde	Dobbelstørrelse i lokalområde
Velegnet til brug på Arjo-sengerammer	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 og 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 og Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 og 980	-	-
Størrelse (cm) L x B x D x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Produktkode	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Materiale	Polyuretanskum med høj elasticitet						
Materiale, betæk	Polyuretanbelagt polyesterstekstil med øget holdbarhed						

Pentaflex Elegance-madrasser fås også i andre specialstørrelser, f.eks. PEYYY/ZZZHx, hvor YYY angiver længden (mellem 140 og 216 cm), og ZZZ angiver bredden (mellem 66 og 140 cm). Hx angiver antallet af håndtag (tilgængelige antal håndtag 2, 4, 5, 6 eller 7). Alle størrelser skal angives i intervaller på 2 cm.

Hvis man kombinerer senge og madrasser, der ikke er anført i tabellen herover, er det kundens ansvar at sørge for, at madrassen og sengerammen passer sammen. Se venligst din sengeforhandlers anbefalede madrasstørrelser. Kontakt Arjo for yderligere information.

Brandhæmning:



Systemet overholder bestemmelserne i BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, og BS 6807: 2006, 5.

BRANDFARE

Cigaretter, lightere, åben ild og åbne varmeelementer i f.eks. elektriske varmeapparater (og andre elektriske apparater) er kilder til brandfare og kan antænde sengetøj, tæpper og tøj. Det er yderst vigtigt, at disse brandkilder holdes væk fra madrassen.

OBS: Det er livsfarligt at ryge i sengen.

Bortskaffelse af et udtjent produkt

Det anbefales, at nedenstående råd følges:

- Stofmateriale, der bruges på madrasser, eller andre tekstiler, polymerer eller plastikmaterialer osv. skal sorteres som brændbart affald.
- Udtjente madrasser skal bortslettes som affald i overensstemmelse med nationale eller lokale krav, og det kan være på løslepladsen eller forbrændingen.

Bemærk: Følg alle lokale bestemmelser og eventuelt plejeinstitutionens operationelle standardprocedurer.

Garanti og service

Standardvilkår og betingelser gælder for alt salg. En kopi heraf udleveres på anmodning.

De indeholder en komplet beskrivelse af garantibetingelser og begrænsninger ikke kundens lovbestemte rettigheder.

Kontakt din lokale distributør vedrørende oplysninger om service, vedligeholdelse eller spørgsmål herom.

Symboler



Anbefalet vasketemperatur:
15 min. ved 60 °C
Maksimal vasketemperatur:
15 min. ved 95 °C



Må ikke stryges



Brug ikke fenolbaserede rengøringsmidler



Hospitalsnavn



Tørretumbles ved 60 °C
Maksimal tørretemperatur 80 °C



Tør alle overflader af med rengøringsopløsningen, aften derefter med en klud, der er fugtet med vand, og tør grundigt.



Dato for første ibrugtagning



Se brugsanvisningen



Rutinemæssig desinfektion:
1.000 ppm.



Brandhæmning



Sikker arbejdsbelastning (SWL)
140 kg/309 lb



CE-mærkning angiver overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs harmoniserede lovgivning



Angiver, at produktet er medicinsk udstyr ifølge forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr



WARNUNG

Zur Vermeidung von Verletzungen lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die beigefügten Dokumente, bevor Sie das Produkt verwenden.



Bedienungsanleitung unbedingt lesen!


Design-Richtlinie und Urheberrecht
® und ™ sind Marken der Arjo Unternehmensgruppe.
© Arjo 2019.

Da kontinuierliche Verbesserung unser Firmengrundsatz ist, behalten wir uns das Recht vor, Designs ohne vorherige Ankündigung zu verändern. Der Nachdruck dieser Schrift, auch auszugsweise, ist ohne die Genehmigung von Arjo verboten.

Produktbeschreibungen

Matratzenersatzsystem

Das Pentaflex® Elegance Matratzenersatzdesign umfasst ein umkehrbares Vier-Wege-Drehsystem mit hochelastischem Polyurethanskern und 5 anatomischen Druckverteilzonen pro Seite, geschützt durch einen wasserdampfdurchlässigen, wasserabweisenden Doppelstretchbezug.

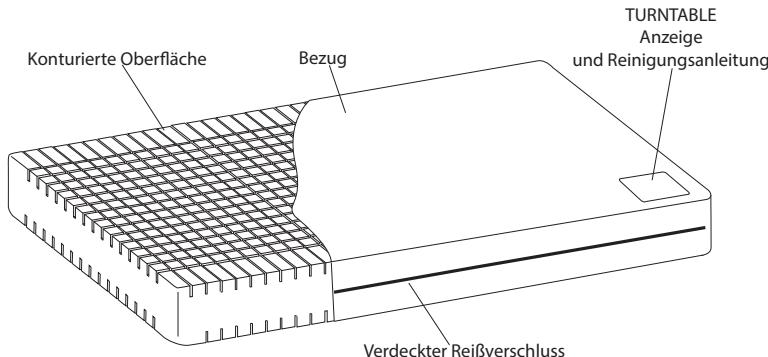

Ebenfalls erhältlich ist ein *Pentaflex Elegance Schaumstoffkissen* (Art.-Nr. SQB2) für die Verwendung mit eingebauten Bettverlängerungen, das zusätzliche 15 cm für größere Patienten bietet.

WARNUNG

Die Matratzengriffe dienen nur dem Transport der Matratze.

Klinische Anwendung

Indikationen für die Verwendung

Pentaflex Elegance ist für Benutzer bis 140 kg (308 lbs / 22 Stones) geeignet. Geeignet für einen breiten Patientenbereich, unter anderem für Patienten mit oberflächlichen Geschwüren (in Verbindung mit einem individuell abgestimmten Pflegeplan).

Hinweis: Dies sind lediglich Richtlinien und sollen die klinische Diagnose oder Erfahrung nicht ersetzen. Wenden Sie sich an einen Spezialisten, wenn der Zustand des Patienten sich nicht verbessert.

WARNUNG

Der Bezug dieses Produkts besteht aus wasserdampfdurchlässigem, aber nicht luftdurchlässigem Material, das bei unsachgemäßer Patientenpositionierung ein Erstickungsrisiko darstellen kann. Es liegt in der Verantwortung des zuständigen Pflegepersonals, sicherzustellen, dass der Benutzer dieses Produkt bedenkenlos anwenden kann.

Tritt im Zusammenhang mit diesem Hilfsmittel ein schwerwiegender Vorfall auf, der den Benutzer oder den Patienten betrifft, sollte der Benutzer oder Patient den schwerwiegenden Vorfall dem Hersteller des Hilfsmittels oder dem Händler melden. In der Europäischen Union sollte der Benutzer den schwerwiegenden Vorfall auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem er sich befindet.

Bedienungsanleitung

Matratzenersatzsystem:

1. Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.
2. Legen Sie den Matratzenersatz *Pentaflex Elegance* auf den Bettrahmen und vergewissern Sie sich, dass keine scharfen Kanten vorhanden sind, die den Bezug aufreißen könnten.

ACHTUNG

Verwenden Sie die Matratze nicht ohne Bezug. Er dient als Schutz vor biologischen Verunreinigungen des Schaumstoffs.

3. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Turntable™-Indikator am Fußende des Bezugs der richtige Monat angezeigt wird. Ist das nicht der Fall, wenden Sie die Matratze, sodass der richtige Monat am Fußende zu sehen ist. Die Monate werden wie folgt angezeigt:
1/12 = Januar
2/12 = Februar usw.
4. Verwenden Sie den *Turntable*-Indikator als Leitfaden für das monatliche Drehen und Wenden der Matratze. Dies trägt dazu bei, den Verschleiß der Matratze gleichmäßig zu halten und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Dekontaminierung

Reinigung des Bezugs

Wischen Sie alle äußerer Flächen mit einem mit einfache Reinigungsmittel und in Wasser getränkten Tuch ab. Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche Rückstände entfernen, die unter Umständen an den Flächen haften. Gründlich abtrocknen.

Desinfektion des Bezugs

Für die Desinfektion empfehlen wir einen Chlor freisetzenden Wirkstoff wie NaOCl oder NaDCC, verdünnt auf 1.000 ppm (die Verdünnung kann je nach Verunreinigung und örtlichen Richtlinien zwischen 250 und 10.000 ppm variieren).

Mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abwischen und anschließend gründlich trocknen lassen.

Alternativ dazu können Sie ein mit Alkohol (70 %) getränktes Tuch verwenden und den Bezug danach an der Luft trocknen lassen.

Routineprüfungen

Der Schaumstoffkern und der Bezug sollten regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung, Verschmutzung oder Flecken überprüft werden.

Technische Daten

Typische Bettgröße	-	-	Einzelbett akut	-	-	Pflegebett Standardgröße	Pflegebett Doppelgröße
Geeignet für die Verwendung mit Arjo-Bettrahmen	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 und 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 und Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 und 980	-	-
Größe (cm) L × B × T × Hx	170 × 86 × 15 × H2	182 × 78 × 15 × H2	198 × 86 × 15 × H2	200 × 90 × 15 × H2	202 × 88 × 15 × H2	190 × 92 × 15 × H2	190 × 138 × 15 × H2
PENTAFLEX ELEGANCE Produktcode	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Material	Hochelastischer Polyurethanschaumstoff						
Bezugsmaterial	Polyurethanbeschichteter Polyester mit verbesserter Haltbarkeit						

Pentaflex Elegance-Matratten sind auch in weiteren Sondergrößen erhältlich, zum Beispiel PEYYY/ZZZHx, wobei YYY die Länge (zwischen 140 und 216 cm), ZZZ die Breite (zwischen 66 und 140 cm) und Hx die Anzahl der Handgriffe (erhältlich mit 2, 4, 5, 6 oder 7 Handgriffen) angibt. Alle Größen müssen in Schritten zu 2 cm angegeben werden.

Werden Betten und Matratzen in anderer Weise als nach der obigen Tabelle kombiniert, liegt es in der Verantwortung des Kunden, die Kompatibilität von Matratze und Bettrahmen zu gewährleisten. Bitte informieren Sie sich über die von Ihrem Bettenhersteller empfohlenen Matratzengrößen. Nähere Einzelheiten erhalten Sie von Arjo.

Feuerfestigkeit:



System erfüllt die Anforderungen gemäß BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, und BS 6807: 2006, 5.

FEUERWARNUNG

Zigaretten, Feuerzeuge, offene Flammen und ungeschützte Heizelemente z. B. in elektrischen Öfen (und anderen Elektrogeräten) stellen Quellen für Brandgefahr dar und können Bettleinen, Decken und Laken entzünden.
Es ist wichtig, dass solche Brandquellen von Matratzen ferngehalten werden.

Anmerkung: Es ist sehr gefährlich, im Bett zu rauchen.

Entsorgung nach Ende der Lebensdauer

Es wird Folgendes empfohlen:

- Auf den Matratzen verwendetes Bezugsmaterial oder andere Textilien, Polymere oder Kunststoffmaterialien usw. sollten als brennbarer Abfall entsorgt werden.
- Matratzen sollten am Ende der Lebensdauer gemäß den nationalen oder lokalen Anforderungen, möglicherweise auf einer Deponie oder Verbrennungsanlage, als Abfall entsorgt werden.

Hinweis: Befolgen Sie alle örtlichen Vorschriften und ggf. die Standardarbeitsanweisungen Ihrer Einrichtung.

Gewährleistung und Kundendienst

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verkäufe. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne ein Exemplar zur Verfügung. In den Geschäftsbedingungen finden sich auch alle Informationen zu den Garantie- und Gewährleistungsbedingungen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben davon unberührt.

Bei Fragen zu Kundendienst, Wartung oder anderen Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner vor Ort.

Symbole



Empfohlene Waschtemperatur:
15 Min. bei 60 °C
Maximale Waschtemperatur:
15 Min. bei 95 °C



Nicht bügeln



Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Phenolbasis.



Krankenhausname



Im Wäschetrockner bei 60 °C trocknen
Maximale Trocknertemperatur 80 °C



Alle Oberflächen mit der Reinigungs-lösung abwischen, dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch nachwischen und gründlich trocknen lassen.



Datum der ersten Verwendung



Siehe Benutzeranweisungen



Routinedesinfektion: 1.000 ppm.



Feuerhemmwirkung



Sichere Arbeitslast (SWL)
140 kg/309 lb



Die CE-Kennzeichnung weist auf die Übereinstimmung mit den harmonisierten Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft hin.



Weist darauf hin, dass das Produkt ein medizinisches Hilfsmittel gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte ist.



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, lea siempre estas instrucciones de uso y los documentos adjuntos antes de usar el producto.




Es obligatorio leer las instrucciones de uso.

Descripciones de los productos

Colchón de reposición

El diseño del colchón de reposición Pentaflex® Elegance consta de un núcleo de espuma de poliuretano de alta resiliencia reversible con rotación de cuatro modos con 5 zonas de redistribución de presión anatómica por lado, protegido por una funda de elasticidad bidireccional resistente al agua y permeable al vapor.

ES

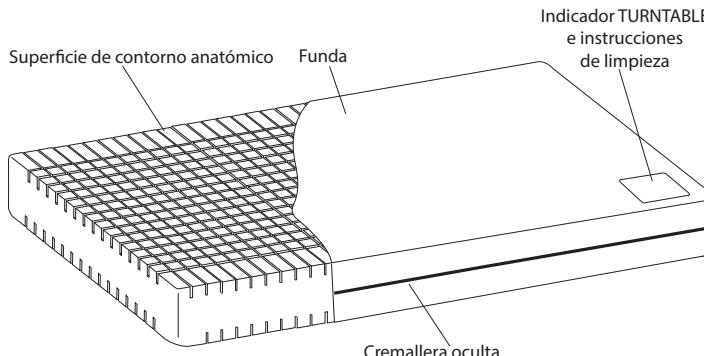

Hay un cojín de espuma *Pentaflex* Elegance (referencia SQB2) disponible para su uso con las extensiones incorporadas a la cama que proporciona 15 cm adicionales para los pacientes de mayor estatura.

ADVERTENCIA

Las asas del colchón son exclusivamente para transportar el colchón.

Aplicaciones clínicas

Indicaciones de uso

Pentaflex Elegance está indicado para usuarios con un peso máximo de 140 kg (308 libras / 22 stones). Apropriado para un amplio espectro de pacientes, incluidos los que padecen úlceras superficiales (junto con un plan de cuidados individualizado).

Nota: Esta información se facilita únicamente a modo de guía y no debe reemplazar a la experiencia o el juicio clínico. Si no se produce una mejoría en el estado del paciente, será preciso consultar a un especialista.

ADVERTENCIA

La funda de este producto es permeable al vapor pero no al aire y puede presentar riesgo de asfixia. Es responsabilidad del cuidador asegurarse de que el uso del producto es seguro para el paciente.

Si se produce un incidente grave en relación con este dispositivo sanitario que afecte al usuario o al paciente, el usuario o el paciente deberán informar acerca de este incidente grave al fabricante del producto sanitario o al distribuidor. En la Unión Europea, el usuario también deberá comunicar el incidente grave a las autoridades competentes del estado miembro en el que se encuentre ubicado.

Instrucciones de uso

Colchón de reposición:

1. Retire el embalaje.
2. Coloque el colchón de reposición *Pentaflex* Elegance sobre la estructura de cama, asegurándose de que no haya bordes punzantes que puedan rasgar la funda.

PRECAUCIÓN

No utilice el colchón sin la funda. Esta ofrece una barrera de protección que evita la contaminación biológica de la espuma.

3. Asegúrese de que aparece el mes correcto en el indicador Turntable™ situado a los pies de la funda. Si no aparece el mes correcto, dé la vuelta al colchón de modo que aparezca el mes correcto a los pies del colchón. Los meses se indican de la siguiente manera:
1/12 = Enero
2/12 = Febrero, etc.
4. Utilice el indicador Turntable como guía para la rotación mensual y el volteo del colchón. Esto ayuda a nivelar el desgaste del colchón y a prolongar la vida útil del producto.

Descontaminación

Limpieza de la funda

Limpie todas las superficies expuestas con un paño humedecido en detergente y agua. Asegúrese de eliminar cualquier resto orgánico que esté adherido a las superficies. Séquelo adecuadamente.

Limpie con un paño empapado con agua limpia y seque adecuadamente.

De manera alternativa, utilice un paño humedecido con alcohol (concentrado al 70 %) y deje secar al aire.

Comprobaciones rutinarias

Se deben inspeccionar periódicamente la funda y el núcleo de espuma para detectar cualquier indicio de daños, suciedad o manchas.

Desinfección de la funda

Para la desinfección recomendamos un agente que proporcione cloro, como NaOCl o NaDCC diluido a 1000 ppm (el rango puede oscilar entre 250 y 10 000 ppm dependiendo del estado de contaminación y la política local).

Información técnica

Tamaño habitual de la cama			Cama individual cuidados intensivos			Cama comunitaria estándar	Cama comunitaria doble
Adecuado para su uso en estructuras de cama de Arjo	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 y 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 y Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 y 980	-	-
Tamaño (cm) L. x An. x Prof. x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Código de producto	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Material	Espuma de poliuretano de alta resiliencia						
Material de la funda	Tejido de poliéster recubierto de poliuretano con mayor durabilidad						

Los colchones PentaFlex Elegance están disponibles en otros tamaños personalizados, por ejemplo PEYYY/ZZZHx, donde YYY especifica la longitud (entre 140 y 216 cm), ZZZ especifica la anchura (entre 66 y 140 cm) y Hx especifica el número de asas (puede haber 2, 4, 5, 6 o 7 asas). Todos los tamaños se deben especificar en incrementos de 2 cm.

Si se combinan camas y colchones no incluidos en la tabla anterior, es responsabilidad del cliente asegurarse de la compatibilidad del colchón y la estructura de cama. Consulte los tamaños de colchón recomendados por el fabricante de las camas. Para obtener más información, póngase en contacto con Arjo.

Ignífugo:



El colchón de reposición cumple los requisitos establecidos en las normas BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, y BS 6807: 2006, 5.

ADVERTENCIA DE INCENDIO

Los cigarrillos, encendedores, llamas directas y elementos de calefacción expuestos, por ejemplo en fuegos eléctricos (y otros electrodomésticos) presentan riesgo de incendio y pueden prender fuego a las sábanas, las mantas y las prendas de vestir. Es fundamental que dichas fuentes de incendio estén alejadas del colchón.

NOTA: Es muy peligroso fumar en la cama.

Eliminación al final de la vida útil

Se recomienda seguir el siguiente consejo:

- El material de tela utilizado en los colchones o cualquier otro material textil, polímeros o materiales plásticos, etc., se deben clasificar como residuos combustibles.
- Al final de su vida útil, los colchones se deben desechar como un residuo de acuerdo con los requisitos nacionales o locales, que pueden establecer su traslado a un vertedero o su eliminación mediante combustión.

Nota: Siga todas las normas locales y, si fuera el caso, los procedimiento de trabajo estándar de su centro sanitario.

Garantía y Mantenimiento

Todas las ventas están sujetas a las cláusulas y condiciones estándar. Puede solicitar una copia. Las copias contienen los detalles completos de los términos de la garantía y no limitan los derechos legales del consumidor.

Para solicitar servicios de mantenimiento o reparaciones, o formular cualquier pregunta relativa a este u otros productos, póngase en contacto con su distribuidor local.

Símbolos



Temperatura de lavado recomendada:

15 min a 60 °C

Temperatura de lavado máxima:
15 min a 95 °C



No planchar.



No utilice soluciones de limpieza con base de fenol



Nombre del hospital



Secar en secadora a 60 °C

Temperatura de secado máxima 80 °C



Limpie todas las superficies con la solución de limpieza, frótelas con un paño humedecido con agua y séquelas adecuadamente.



Fecha del primer uso



Consulte las instrucciones del usuario



Desinfección de rutina: 1.000 ppm.



Retardancia al fuego



Carga de trabajo segura (CTS)
140 kg / 309 lb



El marcado CE indica la conformidad con la legislación armonizada de la Comunidad Europea



Indica que el producto es un producto sanitario de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Unión Europea 2017/745 sobre productos sanitarios



AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure, il est important de lire ce mode d'emploi et les documents joints avant toute utilisation du produit.




Il est obligatoire de lire le mode d'emploi.

Descriptions du produit

Système de remplacement de matelas

Le matelas à quatre positions de rotation Pentaflex® est composé d'un noyau en polyuréthane réversible, haute résilience, avec cinq zones de répartition de la pression des deux côtés, protégé par une housse extensible dans les deux sens, perméable à la vapeur d'eau et imperméable aux liquides.

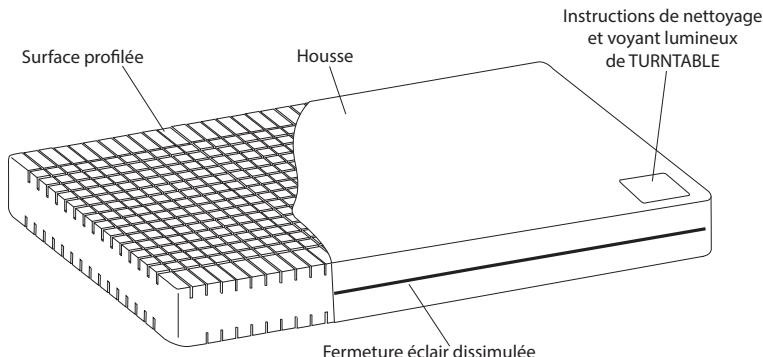

FR

Un coussin en mousse Pentaflex Elegance (pièce n°SQB2) est disponible pour une utilisation sur les rallonges de lit intégrées, qui offrent 15 cm supplémentaires à un patient de grande taille.

AVERTISSEMENT

Utiliser exclusivement les poignées du matelas pour transporter celui-ci.

Applications cliniques

Indications d'utilisation

Pentaflex Elegance est indiqué pour les utilisateurs jusqu'à 140 kg (308 lb/22 st). Adapté à de nombreux patients, y compris ceux atteints d'ulcères superficiels (en association avec un programme de soins personnalisé).

Remarque : Ces indications sont données uniquement à titre de lignes directrices et ne doivent en aucun cas remplacer l'expérience clinique ou un avis médical. Si l'état du patient ne s'améliore pas, demander conseil à un spécialiste.

AVERTISSEMENT

La housse de ce produit est perméable à la vapeur mais pas à l'air. Elle peut présenter un risque d'étouffement. Il appartient au personnel soignant de veiller à ce que ce produit puisse être utilisé en toute sécurité.

Si un incident grave se produit en rapport avec ce dispositif médical et affecte l'utilisateur ou le patient, l'utilisateur ou le patient doit le signaler au fabricant ou au distributeur du dispositif médical. Dans l'Union européenne, l'utilisateur doit également signaler l'incident grave à l'autorité compétente de l'État membre où il se trouve.

Mode d'emploi

Système de remplacement de matelas :

1. Retirer tout l'emballage.
2. Poser le matelas Pentaflex Elegance sur le sommier, en veillant à éviter les bords tranchants susceptibles de déchirer la housse.

ATTENTION

N'utilisez pas le matelas sans sa housse. Celle-ci constitue une barrière protectrice contre la contamination biologique de la mousse.

3. Vérifier que le mois qui apparaît sur l'indicateur Turntable™ au pied de la housse est correct. Si ce n'est pas le cas, tourner le matelas pour que le mois qui convienne apparaisse au niveau des pieds. Les mois sont indiqués comme suit :
1/12 = janvier
2/12 = février, etc.
4. L'indicateur Turntable sert de guide pour la rotation et le retournement du matelas chaque mois. Cela permet d'uniformiser l'usure du matelas et de prolonger sa durée de vie.

Décontamination

Pour nettoyer la housse

Essuyer toutes les surfaces exposées avec un chiffon trempé dans un simple détergent et de l'eau. Retirer tous les débris organiques susceptibles d'adhérer aux surfaces. Sécher soigneusement.

Pour désinfecter la housse

Pour la désinfection, nous recommandons l'utilisation d'un agent libérateur de chlore, comme le NaOCl ou le NaDCC, dilué à 1 000 ppm (pouvant varier entre 250 ppm et 10 000 ppm en fonction de la réglementation locale et du niveau de contamination).

FR

Fiche technique

Taille de lit standard	-	-	Simple Acute	-	-	Standard Community	Double Community
Convient au sommier Arjo	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 et 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 et Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 et 980	-	-
Taille (en cm) L x l x P x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Code du produit	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Matériau	Mousse de polyuréthane haute résilience						
Matériau de la housse	Tissu en polyester recouvert de polyuréthane doté d'une meilleure durabilité.						

Les matelas *Pentaflex Elegance* sont également disponibles dans des dimensions personnalisées de type PEYYY/ZZZHx, où YYY indique la longueur (entre 140 et 216 cm) et ZZZ indique la largeur (entre 66 et 140 cm), Hx indique le nombre de poignées (nombre de poignées disponibles : 2, 4, 5, 6 ou 7). Toutes les dimensions doivent être indiquées avec des incrémentés de 2 cm.

En cas de combinaison de lits et de matelas sans référence au tableau fourni ci-dessus, il incombe au client d'assurer la compatibilité entre le matelas et le sommier. Veuillez vous référer aux dimensions de matelas recommandées par votre fabricant. Pour plus d'informations, veuillez contacter Arjo.

Résistance au feu :



Le système est conforme aux exigences de la norme BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, et BS 6807: 2006, 5.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE

**Les cigarettes, les briquets, les flammes nues et les éléments chauffants exposés comme les cheminées électriques (et autres appareils électriques) entraînent un risque d'incendie et peuvent enflammer les draps de lit, les couvertures et les vêtements.
Il est très important de tenir ces sources d'incendie à l'écart du matelas.**

NB : il est très dangereux de fumer au lit.

Élimination en fin de vie

Recommandation :

- Les tissus utilisés sur les matelas ou tout autre textile, polymère ou matière plastique, etc. doivent être triés en tant que déchets combustibles ultimes.
- Les matelas en fin de vie doivent être éliminés conformément aux exigences nationales ou locales en vigueur en tant que déchets ultimes pouvant être enfouis ou incinérés.

Remarque : respecter toutes les réglementations locales et, le cas échéant, les procédures opérationnelles standard des établissements de soins de santé.

Garantie et service

Les conditions standard s'appliquent à tous les produits. Une copie est disponible sur demande. Elles contiennent tous les détails des conditions de garantie et ne limitent pas les droits du consommateur.

Pour toute question relative notamment à l'utilisation ou à la maintenance de ce produit, contacter votre distributeur agréé.

FR

Symboles



Température de lavage recommandée :

15 min à 60 °C

Température de lavage maximale :
15 min à 95 °C



Ne pas repasser



Ne pas utiliser de solutions de nettoyage
à base de phénol



Nom de l'hôpital



Séchage en machine à 60 °C

Température maximale de séchage :
80 °C



Nettoyer toutes les surfaces avec
une solution nettoyante, rincer avec
un chiffon humidifié avec de l'eau
et sécher soigneusement.



Date de première utilisation



Se reporter aux instructions d'utilisation



Désinfection régulière : 1 000 ppm.



Résistance au feu



Capacité maximale admissible (CMA)
140 kg/309 lb



Marquage CE indiquant la conformité
avec la législation harmonisée
de la Communauté européenne



Indique que le produit est un dispositif
médical conforme au règlement UE
2017/745 sur les dispositifs médicaux



AVVERTENZA

Per evitare lesioni, leggere sempre le presenti istruzioni per l'uso e i documenti a corredo prima di utilizzare il prodotto.



È obbligatorio leggere le istruzioni per l'uso.

Politica di progettazione e copyright

® e ™ sono marchi di proprietà del gruppo di società Arjo.


© Arjo 2019.

La politica dell'azienda è volta al miglioramento costante, per tale ragione questa si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso. È vietato riprodurre integralmente o parzialmente il contenuto della presente pubblicazione senza espresso consenso di Arjo.

Descrizioni prodotto

Sistema sostitutivo del materasso

Il materasso sostitutivo Pentaflex® Elegance è regolabile in 4 posizioni e ha un interno in poliuretano ad alta resilienza con 5 zone per la ridistribuzione della pressione anatomico, protetto da una cover elastica, permeabile al vapore e resistente all'acqua.

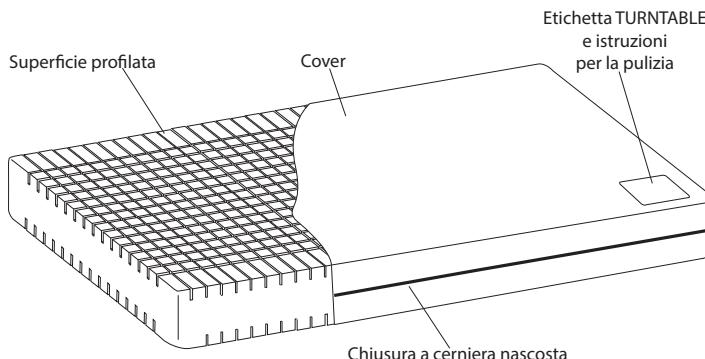

È disponibile un inserto imbottito Pentaflex Elegance (codice SQB2) da utilizzare con le estensioni del letto incorporate, che garantiscono ulteriori 15 cm per i pazienti più alti.

AVVERTENZA

Le maniglie del materasso devono essere utilizzate solo per il trasporto dello stesso.

Applicazioni cliniche

Indicazioni per l'uso

Pentaflex Elegance è indicato per utenti con peso fino a 140 kg (308 lb/22 stone). Adatto a un'ampia varietà di pazienti, inclusi quelli che presentano lesioni superficiali (in associazione col piano di cura individuale).

Nota: queste sono soltanto indicazioni e non intendono sostituirsi in alcun modo a un parere o a una valutazione clinica. Se le condizioni del paziente non mostrano miglioramenti, richiedere il parere di uno specialista.

AVVERTENZA

La cover è permeabile al vapore, ma non all'aria, pertanto può essere causa di soffocamento.
È responsabilità dell'operatore assicurarsi che l'utente possa utilizzare questo prodotto in modo sicuro.

In caso di incidente grave in relazione al presente dispositivo medico a danno dell'utilizzatore o del paziente, questi devono segnalare la circostanza al produttore o al distributore del dispositivo medico. All'interno dell'Unione europea, l'utilizzatore deve segnalare l'incidente grave anche all'autorità competente dello Stato membro in cui opera.

Istruzioni per l'uso

Sistema sostitutivo del materasso:

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Sistemare il materasso sostitutivo Pentaflex Elegance sul telaio del letto, assicurandosi che non ci siano bordi o spigoli taglienti che possano lacerarne la cover.

ATTENZIONE

Non utilizzare il materasso senza cover. Questa funge da barriera protettiva contro la contaminazione biologica dell'imbottitura.

3. Assicurarsi che sull'etichetta Turntable™ ai piedi della cover sia indicato il mese corrente. Se non è indicato il mese corrente, basterà girare il materasso in modo che il mese corretto sia sulla parte del materasso dove si appoggiano i piedi. I mesi sono così indicati:
1/12 = gennaio
2/12 = febbraio, ecc.
4. Usate l'etichetta Turntable come guida per la rotazione mensile e per il cambio di posizione del materasso. Ciò aiuta a uniformare l'usura del materasso e a prolungare la vita del prodotto.

Decontaminazione

Pulizia della cover

Passare un panno inumidito in acqua e detergente su tutte le superfici esposte. Assicurarsi di eliminare ogni residuo organico che potrebbe avere aderito alle superfici. Asciugare accuratamente.

Disinfezione della cover

Per la disinfezione consigliamo l'utilizzo di un agente a base di cloro come NaOCl o NaDCC diluito a 1.000 ppm (la differenza può variare fra 250 e 10.000 ppm in base allo stato di contaminazione e le normative locali).

Pulire con un panno imbevuto di acqua pulita e asciugare accuratamente.

In alternativa, utilizzare un panno inumidito con alcol (70%) e lasciare asciugare all'aria.

Controlli di routine

L'interno in schiuma e la cover devono essere controllati regolarmente onde individuare qualsiasi segno di danneggiamento, sporco o macchie.

Specifiche tecniche

Dimensioni tipiche del letto	-	-	Dimensioni singole acute	-	-	Dimensioni standard per l'uso in comunità	Dimensioni doppie per l'uso in comunità
Adatto all'uso su telai del letto Arjo	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 e 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 e Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 e 980	-	-
Dimensioni (cm) L x W x D x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Codice prodotto	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Materiale	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza						
Materiale cover	Poliestere rivestito in poliuretano a lunga durata.						

I materassi PentaFlex Elegance sono disponibili in altre dimensioni realizzate su misura, ad esempio: PEYYY/ZZZHx, dove YYY indica la lunghezza (fra 140 e 216 cm), ZZZ indica la larghezza (fra 66 e 140 cm) e Hx indica il numero di maniglie (disponibile con 2, 4, 5, 6 o 7 maniglie). Tutte le dimensioni devono essere specificate in incrementi di 2 cm.

Quando si combinano letti e materassi al di fuori della tabella riportata qui sopra, è responsabilità del cliente assicurarsi che materasso e telaio del letto siano compatibili. Fare riferimento alle dimensioni dei materassi raccomandate dai produttori dei letti utilizzati. Per avere ulteriori dettagli contattare Arjo.

Resistenza al fuoco:



Il sistema rispetta i requisiti delle norme BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, e BS 6807: 2006, 5.

AVVERTENZA ANTINCENDIO

Sigarette, accendini, fiamme libere ed elementi riscaldanti esposti, ad esempio in stufette elettriche (ed altri apparecchi elettrici), sono fonti di rischio di incendio e potrebbero dar fuoco alla biancheria da letto, alle coperte e agli indumenti. È indispensabile che queste fonti di incendio siano tenute a debita distanza dal materasso.

NB: fumare a letto è molto pericoloso.

Smaltimento a fine vita

Si consiglia quanto segue:

- Smaltire il materiale tessile utilizzato nei materassi o altri tessuti, polimeri o materiali plastici, ecc. come rifiuto combustibile.
- Alla fine del loro ciclo di vita, smaltire i materassi in conformità alle disposizioni nazionali o locali che possono prevedere il conferimento in discarica o in impianti di incenerimento.

Nota: seguire tutte le normative locali e, se previste, le procedure operative standard delle strutture sanitarie.

Garanzia e assistenza

I termini e le condizioni standard sono validi per tutti i prodotti venduti. È possibile ottenerne una copia su richiesta. Questo documento contiene tutti i dettagli riguardanti le condizioni di garanzia e non limita i diritti legittimi del consumatore.

Per richieste di assistenza o manutenzione e per qualsiasi domanda su questo o altri prodotti, rivolgersi al rivenditore locale.

Simboli



Temperatura di lavaggio consigliata:
15 min a 60 °C
Temperatura di lavaggio massima:
15 min a 95 °C



Non stirare



Non usare per la pulizia prodotti a base fenolica



Nome della struttura ospedaliera



Asciugatrice a 60 °C
Temperatura di asciugatura massima:
80 °C



Applicare la soluzione pulente su tutte le superfici, quindi strofinare con un panno inumidito con acqua e asciugare accuratamente.



Data di primo utilizzo



Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso



Disinfezione di routine: 1.000 ppm.



Caratteristiche fuocoritardanti



Carico di lavoro sicuro (SWL)
140 kg/309 lb



Marcatura CE attestante la conformità alla legislazione armonizzata della Comunità europea



Indica che il prodotto è un dispositivo medico in base al regolamento dell'UE sui dispositivi medici 2017/745.

IT



WAARSCHUWING

Lees altijd de gebruiksaanwijzing en bijbehorende documenten voordat u het product gaat gebruiken om letsel te voorkomen.



Verplicht om de gebruiksaanwijzing te lezen.


Beleid met betrekking tot het ontwerp en auteursrecht
® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo-bedrijvgengroep.
© Arjo 2019.

Omdat ons beleid voortdurend in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor om ontwerpen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is zonder de toestemming van Arjo niet toegestaan de inhoud van deze publicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren.

Productbeschrijvingen

Matrasvervangend systeem

Het Pentaflex® matrasvervangend systeem bestaat uit een 4-zijdige, polyurethaan kern met sterke veerkracht en 5 anatomische zones voor herverdeling van de druk aan elke kant, beschermd door een 2-zijdig elastische, dampdoorlatende, waterbestendige hoes.

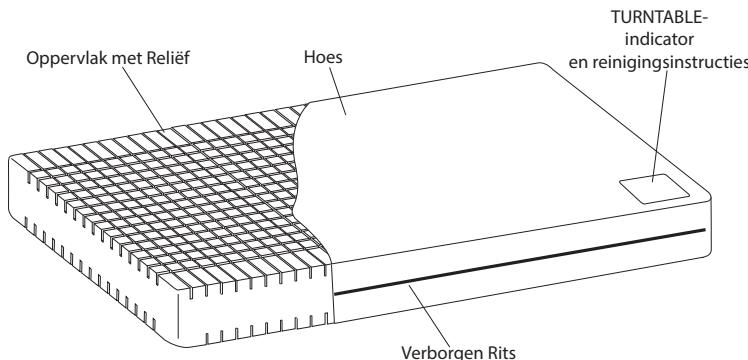

NL

Er is een *Pentaflex Elegance* schuimrubber verlengstuk verkrijgbaar (onderdeelnummer SQB2) voor gebruik bij ingebouwde bedverlengingen, waardoor de matras met 15 cm kan worden verlengd voor zorgvragers die langer zijn.

WAARSCHUWING

De handgrepen van de matras zijn enkel bedoeld om de matras te verplaatsen.

Klinische toepassingen

Indicaties voor gebruik

Pentaflex Elegance is geschikt voor gebruikers tot 140 kg (308 lb. / 22 stone). Geschikt voor verschillende zorgvragers, inclusief zorgvragers met oppervlakkige decubituswonden (samen met een afgestemd verzorgingsplan).

Opmerking: Dit zijn slechts richtlijnen en mogen de ervaring en het oordeel van een arts niet vervangen. Als de toestand van de zorgvraag niet verbeterd, dient u een specialist te raadplegen.

WAARSCHUWING

De hoes van dit product is dampdoorlatend, maar niet luchtdoorlatend en kan daarom verstikking veroorzaken. De zorgverleener is verantwoordelijk voor correct gebruik van dit product door de patiënt.

Als er een ernstig incident optreedt, gerelateerd aan dit product, dat invloed heeft op de gebruiker of de zorgvraag, dan moet de gebruiker of de zorgvraag het incident melden aan de fabrikant of de distributeur van het product. In de Europese Unie moet de gebruiker het incident bovendien melden aan de bevoegde autoriteit in de lidstaat waarin hij of zij zich bevindt.

Gebruiksaanwijzing

Matrasvervangend systeem:

1. Verwijder de volledige verpakking.
2. Leg het *Pentaflex Elegance* matrasvervangend systeem op het bedkader en zorg ervoor dat er geen scherpe randen zijn waardoor de hoes kan scheuren.

LET OP

Gebruik de matras niet zonder hoes. Deze biedt een beschermende laag tegen biologische verontreiniging van het schuimrubber.

3. Zorg ervoor dat de juiste maand wordt getoond op de Turntable™-indicator aan het voeteneind van de hoes. Als de juiste maand niet wordt getoond, draai dan de matras zodat de juiste maand aan het voeteneind zichtbaar is. Maanden worden als volgt weergegeven:
1/12 = januari
2/12 = februari enz.
4. Gebruik de Turntable-indicator als een leidraad voor het maandelijks draaien van de matras. Dit zorgt ervoor dat de matras gelijkmatig slijt en dat de levensduur van het product wordt verlengd.

Reiniging en desinfectie

Reiniging van de hoes

Neem de buitenzijde af met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat organische verontreiniging die zich aan de buitenzijde bevindt, wordt verwijderd. Goed laten drogen.

Desinfecteren van de hoes

Voor desinfectie raden wij een chloorafgevend middel aan, zoals NaOCl of NaDCC, verduld tot 1.000 ppm (hoeveelheid mag variëren tussen 250 en 10.000 ppm, afhankelijk van de ernst van de verontreiniging en plaatselijke bepalingen).

Reinig met een doek die met schoon water is bevochtigd en droog grondig af.

Of gebruik een met alcohol (70%) bevochtigde doek en laat aan de lucht drogen.

Routinecontroles

De schuimrubber kern en de hoes dienen regelmatig geïnspecteerd te worden op tekenen van beschadiging of vervuiling.

Technische gegevens

Standaard bedafmeting	-	-	Eenpersoons-maat	-	-	Standaardmaat	Dubbele Grootte
Geschikt voor gebruik op een Arjo bedkader	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 en 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 en Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 en 980	-	-
Afmeting (cm) L x b x h x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Productcode	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Materiaal	Polyurethaan schuimrubber met sterke veerkracht						
Hoesmateriaal	Polyurethaangecoate polyesterstof met een verbeterde duurzaamheid						

Pentaflex Elegance matrassen zijn verkrijgbaar in andere speciale afmetingen, bv. PEYYY/ZZZHx, waarbij YYY de lengte (tussen 140 en 216 cm) en ZZZ de breedte (tussen 66 en 140 cm) aangeeft. Hx geeft het aantal handgrepen aan (beschikbaar aantal handgrepen 2, 4, 5, 6 of 7). Alle maten moeten met een toename van 2 cm worden weergegeven.

Bij het combineren van bedden en matrassen die niet in de tabel hierboven worden aangegeven, is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de matras en het bedkader combineerbaar zijn. Zie de door de fabrikant aanbevolen matrasmaten. Neem voor verdere details contact op met Arjo.

Brandvertraging:



Het systeem voldoet aan de eisen van BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, en BS 6807: 2006, 5.

WAARSCHUWING VOOR BRAND

Sigaretten, aanstekers, open vuur en blootliggende verwarmingselementen bijv. in elektrische kachels (en andere elektrische apparaten) kunnen brand veroorzaken en bedlinnen, lakens en kleding doen ontbranden.

Het is van essentieel belang dat deze vuurbronnen uit de buurt van de matras worden gehouden.

NB. Het is erg gevaarlijk om in bed te roken.

Verwijdering na einde levensduur

De volgende werkwijze wordt aanbevolen:

- Stofmateriaal dat bij matrassen is gebruikt of eventuele andere textielen, polymeren of plastic materialen enz., moeten worden gesorteerd als ontvlambaar afval.
- Aan het einde van hun levensduur moeten matrassen worden verwijderd als afval in overeenstemming met de nationale of lokale vereisten, mogelijk naar de vuilstortplaats of voor verbranding.

Opmerking: Volg alle plaatselijke regels en, indien van toepassing, standaard bedrijfsprocedures voor de gezondheidszorg.

Garantie en service

De standaardvooraarden gelden voor alle producten. Een exemplaar hiervan is op verzoek verkrijgbaar. Deze voorwaarden bevatten alle informatie over de garantievooraarden en hebben geen invloed op de wettelijke rechten van de consument.

Voor service, onderhoud en vragen hierover of over andere producten, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke distributeur.

Symbolen



Aanbevolen wastemperatuur: 15 min.
op 60 °C
Maximale wastemperatuur:
15 min. op 95 °C



Niet strijken



Gebruik geen reinigingsoplossingen
op basis van fenol



Naam van het ziekenhuis



Drogen in droogtrommel op 60 °C
Maximale droogtemperatuur 80 °C



Neem alle oppervlakken
af met dureinigingsoplossing, daarna
met een met water bevochtigde
doek en laat goed drogen.



Datum van eerste gebruik



Raadpleeg de gebruiksinstructies



Routinematige desinfectie: 1.000 ppm



Brandvertraging



Veilige tilbelasting
(SWL – Safe Working Load)
140 kg / 309 lb.



CE-markering die conformiteit
aanduidt met de geharmoniseerde
wetgeving van de Europese
Gemeenschap



Duidt aan dat het product een
apparaat is in overeenstemming
met EU-verordening betreffende
medische hulpmiddelen 2017/745

NL



AVERTISMENT



Pentru a evita accidentele, citiți întotdeauna instrucțiunile de utilizare și documentele însotitoare înainte de a utiliza produsul.

Consultarea instrucțiunilor de utilizare este obligatorie.

Politica de proiectare și dreptul de autor

® și ™ sunt mărci comerciale care aparțin grupului de companii Arjo.


© Arjo 2019.

Pentru că politica noastră presupune o optimizare continuă, ne rezervăm dreptul de a modifica modelele fără preaviz. Conținutul acestui articol nu poate fi copiat, în totalitate sau parțial, fără acordul scris al Arjo.

Descrierea produsului

Sistemul cu saltea modulară

Saltea modulară Pentaflex® Elegance dispune de 4 poziții care pot fi utilizate pe rând, un nucleu de poliuretan de mare rezistență cu 5 zone anatomicice de redistribuire a presiunii pe fiecare parte, fiind protejată de o husă impermeabilă la apă, permeabilă la vaporii, realizată din material elastic în 2 direcții.

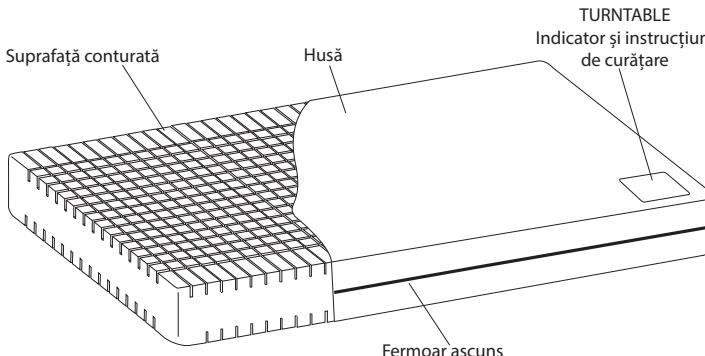

RO

Este disponibilă o pernă de spumă *Pentaflex Elegance* (cod piesă SQB2) pentru a fi utilizată cu extensiile de pat încorporate, asigurând o portiune suplimentară de 15 cm pentru pacienții înalți.

AVERTISMENT

Mânerele saltelei sunt destinate numai pentru transportul acesteia.

Utilizări clinice

Instrucțiuni de utilizare

Saltea *Pentaflex Elegance* este indicată pentru utilizatorii cu greutatea maximă de 140 kg (308 lb/22 stone). Este adecvată pentru o gamă largă de pacienți, inclusiv pentru cei cu ulcere superficiale (în asociere cu un plan de îngrijire personalizat).

Notă: Instrucțiunile de mai sus sunt doar recomandări și nu vor înlocui decizia sau experiența medicală. Dacă starea pacientului nu se îmbunătățește, cereți părerea unui specialist.

AVERTISMENT

Husa acestui produs este permeabilă la vaporii, dar nu este permeabilă la aer și poate prezenta risc de sufocare. Personalul medical are responsabilitatea de a se asigura că utilizatorul poate utiliza acest produs în siguranță.

Dacă survine un incident grav legat de acest dispozitiv medical, care afectează utilizatorul sau pacientul, atunci utilizatorul sau pacientul trebuie să raporteze acest incident grav producătorului dispozitivului medical sau distribuitorului. În Uniunea Europeană, utilizatorul trebuie să raporteze incidentul grav și autorității competente din statul membru în care se află.

Instrucțiuni de utilizare

Sistemul cu saltea modulară:

1. Scoateți ambalajul.
2. Așezați saltea modulară *Pentaflex Elegance* pe cadrul patului și asigurați-vă că nu se produc muchii ascuțite care pot rupe husa.

ATENȚIE

Nu utilizați saltea fără husă. Asigură o barieră de protecție împotriva contaminării biologice a spumei.

3. Asigurați-vă că indicatorul Turntable™ din partea de la picioare a husei arată luna corectă. Dacă nu este afișată luna corectă, rotiți saltea, astfel încât luna corectă să apară în partea de la picioare. Lunile sunt indicate în felul următor:
1/12 = ianuarie
2/12 = februarie etc.
4. Utilizați indicatorul Turntable ca punct de reper pentru rotirea și întoarcerea saltelei în fiecare lună. În acest fel, saltea se va uza în mod uniform, ceea ce va prelungi durata de utilizare a produsului.

Decontaminarea

Curățarea husei

Curățați toate suprafetele expuse, folosind o cârpă înmuiată în apă cu detergent simplu. Asigurați-vă că ati îndepărta toate resturile organice care pot rămâne pe suprafete. Uscați bine.

Dezinfectarea husei

Pentru dezinfecțare, se recomandă folosirea unui agent pe bază de clor, precum NaOCl sau NaDCC, în concentrație de 1.000 ppm (concentrația poate varia între 250 ppm și 10.000 ppm, în funcție de starea de contaminare și de politica locală).

Stergeți cu o lavetă îmbibată cu apă curată și uscați bine.

De asemenea, puteți utiliza o cârpă înmuiată în alcool (70%), lăsând apoi produsul să se usuze.

Verificările de rutină

Nucleul de spumă și husa trebuie examineate periodic pentru a se depista semne de uzură, murdărire sau pătare.

Date tehnice

Dimensiune pat obișnuită	-	-	Dimensiune pat de o singură persoană	-	-	Dimensiune standard comunitară	Dimensiune pat dublu comunitară
Adecată pentru utilizare pe cadrul de pat Arjo	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 și 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 și Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 și 980	-	-
Dimensiuni (cm) L x l x Î x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Cod de produs	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Material	Spumă poliuretanică de mare rezistență						
Materialul husei	Material din poliester acoperit cu poliuretan cu durabilitate sporită						

Saltelele PentaFlex Elegance sunt disponibile cu alte dimensiuni particularizate, cum ar fi PEYYY/ZZZHx, unde YYY indică lungimea (între 140 și 216 cm), ZZZ indică lățimea (între 66 și 140 cm), iar Hx indică numărul de mânere (numărul de mânere disponibile 2, 4, 5, 6 sau 7). Toate dimensiunile trebuie specificate în trepte de 2 cm.

În cazul în care sunt combinate paturi și saltele de dimensiuni care nu apar în tabelul de mai sus, clientul are responsabilitatea de a asigura compatibilitatea între saltea și cadru patului. Consultați dimensiunile de saltea recomandate de producătorul patului. Pentru mai multe detalii, contactați Arjo.

Rezistența la incendiu:



Sistemul îndeplinește cerințele standardelor BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, și BS 6807: 2006, 5.

AVERTISMENT PRIVIND INCENDIUL

Tigările, brichetele, focul deschis și elementele de încălzire expuse, cum ar fi focul electric (și alte dispozitive electrice), constituie surse de pericol de incendiu, care pot aprinde lenjerie de pat, păturile și îmbrăcăminte. Este important să păstrați aceste surse de foc cât mai departe de saltea.

NB: fumatul în pat este extrem de periculos.

Eliminarea la sfârșitul duratei de utilizare

Se recomandă următoarele:

- Materialele folosite pentru saltele, orice alte materiale textile, polimeri sau materiale din plastic etc. trebuie sortate ca deșeuri combustibile.
- Saltelele aflate la sfârșitul duratei de utilizare trebuie eliminate ca deșeuri conform cerințelor naționale sau locale, care pot să prevadă aruncarea la groapa de gunoi sau arderea.

Notă: respectați toate reglementările locale și, dacă este cazul, procedurile standard de funcționare ale unității medicale.

Garanție și service

Tuturor produselor vândute li se aplică clauze și condiții standard. O copie poate fi obținută la cerere. Aceste clauze și condiții conțin detalii complete referitoare la condițiile de garanție și nu limitează drepturile legale ale consumatorului.

Pentru service, întreținere și orice întrebări referitoare la acest produs sau la orice alt produs, vă rugăm să contactați distribuitorul local.

Simboluri



Temperatură recomandată de spălare:
15 min la 60 °C
Temperatură maximă de spălare:
15 min la 95 °C



Nu călcăți



Nu utilizați soluții de curățare pe bază de fenol



Numele spitalului



Uscare în mașina de uscat rufe la 60 °C
Temperatură maximă de uscare 80 °C



Ștergeți toate suprafețele cu soluția de curățare, apoi ștergeți cu o lavetă umedă și uscați complet.



Data primei utilizări



Consultați instrucțiunile de utilizare



Dezinfectare de rutină: 1.000 ppm.



Rezistență la incendiu



Sarcina maximă admisă (SMA)
140 kg/309 lb



Marcaj CE care arată conformitatea cu legislația armonizată a Comunității Europene



Indică faptul că produsul este un dispozitiv medical conform Regulamentului UE 2017/745 privind dispozitivele medicale

RO



UPOZORENJE

Da biste izbegli povrede, uvek pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i prateću dokumentaciju pre korišćenja proizvoda.




Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Opisi proizvoda

Sistem zamenskog dušeka

Zamenski dušek Pentaflex® Elegance se sastoji od poliuretanskog jezgra visoke izdržljivosti koje se može obrnuti i okrenuti na 4 načina i ima 5 zona redistribucije pritiska po svakoj strani i zaštite u vidu dvostrano rastegljive, vodootporne navlaka koja propušta paru.

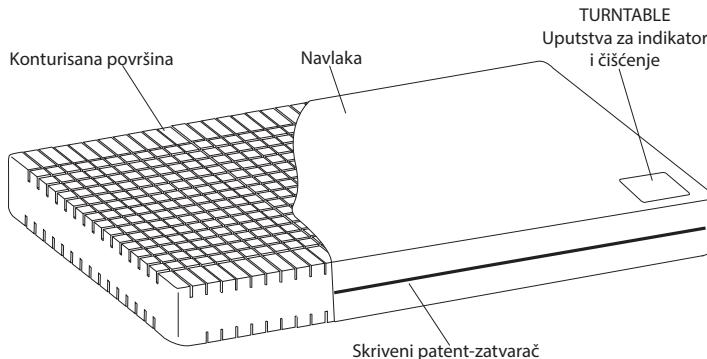

SR

Pentaflex Elegance jastuče od pene (br. dela SQB2) je dostupno za upotrebu sa ugrađenim produžecima kreveta koji pružaju dodatnih 15 cm za više pacijente.

UPOZORENJE

Ručke na dušku služe isključivo za transport duška.

Kliničke primene

Indikacije za upotrebu

Pentaflex Elegance je indikovan za korisnike težine do 140 kg (308 lb / 22 stouna). Adekvatan je za mnoge tipove pacijenata, uključujući i one sa površinskim dekubitalnim ranama (uz prilagođeni plan nege).

Napomena: Ovo su samo smernice, pa ne treba da imaju prednost nad kliničkim iskustvom ili mišljenjem. Ukoliko nema poboljšanja u stanju pacijenta, treba potražiti savet stručnog lica.

UPOZORENJE

Navlaka ovog proizvoda propušta paru, ali ne i vazduh, pa može da predstavlja rizik od gušenja. Negovatelj je odgovoran za bezbednu upotrebu ovog proizvoda.

Ako u vezi sa ovim uređajem dođe do ozbiljnog incidenta koji utiče na korisnika ili pacijenta, onda bi taj korisnik ili pacijent trebalo da prijave taj ozbiljni incident proizvođaču ili distributeru medicinskog sredstva. U Evropskoj uniji korisnik bi trebalo da prijavi takav ozbiljni incident i nadležnom organu u državi članici u kojoj se nalazi.

Uputstvo za upotrebu

Sistem zamenskog dušeka:

1. Uklonite sve delove pakovanja.
2. Postavite zamenski dušek Pentaflex Elegance na okvir kreveta, pazeci da ne pocepite navlaku na oštре ivice.

OPREZ

Ne koristite dušek bez navlake. Ona predstavlja zaštitnu barijeru protiv biološke kontaminacije pene.

3. Uverite se da se na indikatoru Turntable™ u podnožju navlake prikazuje ispravan mesec. Ako nije prikazan odgovarajući mesec, okrenite dušek da biste prikazali tačan mesec u njegovom podnožju. Meseci su označeni na sledeći način:
1/12 = januar
2/12 = februar itd.
4. Koristite indikator Turntable kao smernicu za mesečno okretanje i obrtanje duška. Na taj način se dušek jedнако haba i produžava se njegov radni vek.

Dekontaminacija

Čišćenje navlake

Prebrišite sve izložene površine krpom koja je navlažena običnim deterdžentom i vodom. Obavezno uklonite svu organsku prljavštinu ukoliko se zlepila za površine. Temeljno osušite.

Dezinifikovanje navlake

Za dezinfekciju preporučujemo sredstvo koje otpušta hlor, kao što su NaOCl ili NaDCC, razblaženo na 1000 ppm (opseg razblaživanja može da se kreće od 250 do 10.000 ppm, zavisno od stanja kontaminacije i lokalnih propisa).

Prebrišite krpom koja je navlažena vodom i dobro osušite.

Druga mogućnost je da koristite tkaninu navlaženu alkoholom (70%), te da ostavite da se osuši na vazduhu.

Rutinske provere

Redovno proveravajte da li na jezgru i navlaci dušeka ima znakova oštećenja, prljavštine ili fleka.

SR

Tehnički podaci

Uobičajena veličina kreveta	-	-	Jednostruki za akutnu negu	-	-	Standardni za uobičajenu negu	Dupli za uobičajenu negu
Adekvatan za upotrebu na Arjo okvиру za krevet	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 i 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 i Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 i 980	-	-
Veličina (cm) D x Š x D x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Kód proizvoda	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Materijal	Poliiuretanska pena visoke izdržljivosti						
Materijal navlake	Poliestersko vlakno prekriveno poliiuretanom, sa poboljšanom izdržljivošću						

Pentaflex Elegance dušeci su dostupni i u drugim nestandardnim veličinama, npr. PEYYY/ZZZHx, gde YYY predstavlja dužinu (između 140 i 216 cm), a ZZZ predstavlja širinu (između 66 i 140 cm), Hx predstavlja broj ručki (dostupan broj ručki 2, 4, 5, 6 ili 7). Sve veličine moraju biti navedene sa povećanjem od 2 cm.

Pri kombinovanju kreveta i dušeka van gorenavedene tabele, korisnik je odgovoran za kompatibilnost dušeka i okvira kreveta. Pročitajte preporuke u vezi sa veličinama dušeka koje navodi proizvođač kreveta. Ako vam je potrebno više detalja, обратите se kompaniji Arjo.

Otpornost na požar:



Sistem ispunjava zahteve standarda BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, i BS 6807: 2006, 5.

UPOZORENJE NA ZAPALJIVOST

Cigaretе, upaljačи, otvoreni plamen i izložena grejna tela, npr. strujni grejačи (i drugi električni uređaji) predstavljaju izvor opasnosti od požara i mogu da zapale posteljinu, čebad i odeću. Obavezno držite te izvore vatre dalje od dušeka.

NAPOMENA: Izuzetno je opasno pušiti u krevetu.

Odlaganje na kraju radnog veka

Preporučuju se sledeći saveti:

- Tkanina koja se koristi na dušecima ili bilo koji drugi tekstilni materijali ili materijali od polimera ili plastike itd. trebalo bi da se sortiraju kao zapaljivi otpad.
- Dušeci bi trebalo da se na kraju radnog veka odlože na otpad u skladu sa nacionalnim ili lokalnim zahtevima, što može da podrazumeva odvoženje na deponiju ili spaljivanje.

Napomena: Sledite sve lokalne propise i standardne radne procedure u zdravstvenoj ustanovi, ako je to primenljivo.

Garancija i servis

Standardni uslovi i odredbe primenjuju se na sve prodane artikle. Kopija je dostupna na zahtev. Oni sadrže sve detalje uslova garancije i ne ograničavaju zakonska prava potrošača.

Radi servisa, održavanja i svih pitanja u vezi sa ovim ili bilo kojim drugim proizvodom, обратите se lokalnom distributeru.

Simboli



Preporučena temperatura pranja:
15 min na 60 °C
Maksimalna temperatura pranja:
15 min na 95 °C



Ne peglajte



Ne koristite sredstva za pranje
na bazi fenola



Naziv bolnice



Mašinsko sušenje na 60 °C
Maksimalna temperatura sušenja
80 °C



Prebrišite sve površine rastvorom
za čišćenje, a zatim prebrišite
krpom koja je navlažena vodom
i dobro osušite.



Datum prve upotrebe



Pročitajte uputstva za korisnike



Rutinska dezinfekcija: 1000 ppm.



Otpornost na požar



Bezbedno radno opterećenje
140 kg / 309 lb



Oznaka CE, koja ukazuje
na usaglašenost sa usklađenim
zakonodavstvom Evropske
zajednice



Ukazuje na to da je proizvod uređaj
u skladu sa Regulativom Evropske
unije za medicinska sredstva
2017/745



VARNING

Minska risken för skador genom att alltid läsa denna bruksanvisning och medföljande dokumentation innan du använder produkten.



Obligatoriskt att läsa bruksanvisningen.

Designpolicy och upphovsrätt

® och ™ är varumärken som tillhör Arjo-koncernen.


© Arjo 2019.

Vår policy är ha en kontinuerlig produktutveckling och vi förbehåller oss därför rätten att ändra konstruktioner och specifikationer utan att meddela detta i förväg. Innehållet i detta dokument får inte kopieras varje sig helt eller delvis utan tillstånd från Arjo.

Produktbeskrivningar

Ersättningssmadrass

Pentaflex® Elegance madrassersättning består av en 4-vägs vändbar kärna i högmotståndskraftigt polyuretan med 5 anatomiska tryckfördelningszoner per sida, skyddad av ett 2-vägs elastiskt, ångpermeabelt, vattentåligt överdrag.

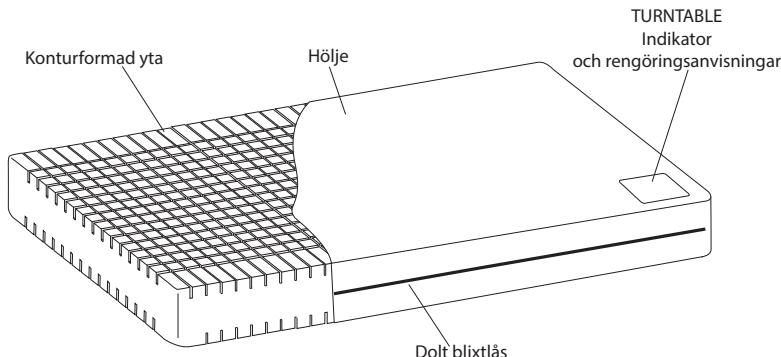

SV

En *Pentaflex Elegance* förlängningsdel i skum (art.nr SQB2) finns för användning med inbyggda sängförlängningar och ger 15 cm extra längd för långa patienter.

VARNING

Madrasshandtagen ska endast användas vid transport av madrassen.

Kliniska tillämpningar

Indikationer för användning

Pentaflex Elegance är avsedd för användare upp till 140 kg (308 lbs/22 stones). Lämplig för många olika patienter, inbegripet patienter med trycksår (i samband med en individanpassad vårdplan).

Obs! Dessa är riktlinjer och ersätter inte klinisk bedömning eller erfarenhet. Om patientens tillstånd inte förbättras ska en specialist konsulteras.

VARNING

Överdraget till denna produkt släpper igenom fukt, men inte luft, och kan därför medföra en kvävningsrisk. Det är vårdpersonalens ansvar att försäkra sig om att användaren kan använda produkten på ett säkert sätt.

Om en allvarlig incident med koppling till denna medicintekniska enhet inträffar, och denna incident påverkar användaren eller patienten, ska användaren eller patienten rapportera denna allvarliga incident till tillverkaren eller distributören av den medicintekniska enheten. Inom EU ska användaren även rapportera den allvarliga incidenten till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren är bosatt.

Bruksanvisning

Ersättningssmadrass:

1. Avlägsna allt förpackningsmaterial.
2. Lägg *Pentaflex Elegance* ersättningssmadrass på sängramen och kontrollera att det inte finns några vassa kanter som kan trasa sönder överdraget.

AKTA

Använd inte madrassen utan överdrag. Det ger ett skyddslager mot biologisk kontamination av skummet.

3. Kontrollera att rätt månad visas på Turntable™-indikatorn vid överdragets fotända. Om fel månad visas ska madrassen vridas så att den rätta månaden visas vid fotändan. Månaderna indikeras enligt följande:
1/12 = januari
2/12 = februari osv.
4. Använd Turntable-indikatorn som vägledning för den månatliga vridningen och vändningen av madrassen. Detta bidrar till att jämna ut madrassens förslitning och förlänger produkten s livslängd.

Rengöring

Rengöring av överdraget

Torka av alla synliga ytor med en trasa som fuktats med enkelt rengöringsmedel och vatten. Se till att ta bort eventuella organiska rester som kan sitta fast på ytorna. Torka noggrant.

Desinficering av överdraget

För desinficering rekommenderar vi ett kloravgivande ämne som NaOCl eller NaDCC utspätt till 1 000 ppm (mängden kan variera mellan 250 och 10 000 ppm beroende på graden av förorening och lokala bestämmelser).

Torka sedan med en trasa fuktad med rent vatten. Låt torka.

Du kan även använda en trasa som fuktats med alkohol (70 %) och låta lufttorka.

Rutinkontroller

Skumkärnan och överdraget skall inspekteras regelbundet efter tecken på skada, nedsmutsning eller fläckar.

Tekniska data

SV

Typisk sängstorlek	-	-	Akut enkelstorlek	-	-	Sjukhus-standardstorlek	Sjukhus-dubbelstorlek
Passar för Arjo sängram	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 och 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 och Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 och 980	-	-
Storlek (cm) L x B x D x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Produktkod	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Material	Högmotståndskraftig polyuretanskum						
Överdrags-material	Polyuretanbelagd polyesterväv med förbättrad hållbarhet.						

Pentaflex Elegance madrasser finns även att få i andra specialstorlekar, t.ex. PEYYY/ZZZHx, där YYY är längden (mellan 140 och 216 cm) och ZZZ är bredden (mellan 66 och 140 cm) och Hx är antalet handtag (tillgängligt antal handtag: 2, 4, 5, 6 eller 7). Alla storlekar måste anges i steg om 2 cm.

Vid kombinationer av sängar och madrasser som inte ingår i tabellen ovan, är det kundens ansvar att se till att madrass och sängram passar ihop. Se rekommenderad madrasstorlek från sängtillverkaren. För ytterligare information, kontakta Arjo.

Brandhärdighet:



Systemet uppfyller kraven i BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995 och BS 6807: 2006, 5.

BRANDWARNING

Cigaretter, tändare, öppna lågor och värmeelement i exempelvis elektriska kaminer (och andra elektriska apparater) är brandrisker som kan antända sänglinne, filter och kläder. Det är mycket viktigt att dessa brandrisker inte förekommer i närlheten av madrassen.

OBS! Det är mycket farligt att röka i sängen.

Kassering av uttjänta produkter

Vi rekommenderar följande:

- Tygmaterial som används på madrasser och alla eventuella övriga textilier, polymerer eller plastmaterial och liknande ska sorteras som brännbart avfall.
- Uttränta madrasser ska kasseras som avfall i enlighet med nationella eller lokala bestämmelser, vilket kan innebära att den kasseras som deponiavfall eller brännbart avfall.

Obs! Följ alla lokala bestämmelser och, om tillämpligt, vårdinrättningens standardrutiner.

Garanti och service

Standardvillkor gäller för all försäljning. En kopia kan erhållas på begäran. Dessa innehåller fullständig information om garantivillkor och begränsar inte kundens lagenliga rättigheter.

För service, underhåll och frågor om denna eller någon annan produkt, kontakta din lokala distributör.

SV

Symboler



Rekommenderad tvättemperatur:
15 minuter vid 60 °C
Högsta tvättemperatur:
15 minuter vid 95 °C



Strykning ej tillåten



Använd inte fenolbaserade
rengöringslösningar



Sjukhusets namn



Torktumla vid 60 °C
Högsta torktemperatur 80 °C



Torka av alla ytor med rengörings-
lösningen och torka sedan noggrant
av med en mjuk trasa fuktad med
vatten. Låt torka.



Datum för första användningen



Läs i användarmanualen



Rutindesinficering: 1 000 ppm.



Brandhärdighet



Säker arbetslast (SWL)
140 kg/309 lb



CE-märkning som indikerar överens-
stämmelse med Europeiska gemen-
skaps harmoniserade lagstiftning



Visar att produkten är en medicinteknisk
enhet i enlighet med EU:s förordning
om medicintekniska produkter 2017/745



VAROVÁNÍ

Z důvodu ochrany před zraněním si před používáním produktu vždy přečtěte tento návod k použití a doprovodné dokumenty.



Přečtení návodu k použití je povinné.

Zásady vnější úpravy a copyright

® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.


© Arjo 2019.

V souladu s naší zásadou neustálého zlepšování si vyhrazujeme právo na změnu designu bez předchozího upozornění. Obsah této publikace nesmí být kopírován zcela ani částečně bez souhlasu společnosti Arjo.

Popisy produktů

Systém náhrady matrace

Náhradní matrace Pentaflex® Elegance se vyznačuje vysoko odolným polyuretanovým jádrem s 5 anatomickými zónami pro redistribuci tlaku, jež je otočné ve čtyřech směrech a je chráněno voděodolným, paropropustným potahem s obousměrným napínáním.

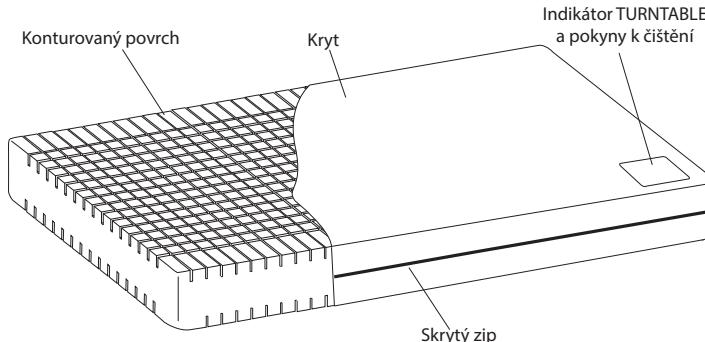

Při použití lůžka s vestavěnou funkcí prodloužení je k dispozici pěnový nástavec *Pentaflex Elegance* (obj. č. SQB2), který poskytuje dalších 15 cm pro vyšší klienty.

CS

VAROVÁNÍ

Držadla matrací jsou určena pouze na přenášení matrací.

Klinické použití

Indikace k použití

Matrace *Pentaflex Elegance* je určena pro uživatele do hmotnosti 140 kg (308 lb/22 st). Je vhodná pro celou řadu klientů, včetně osob postižených povrchovými výedy (v kombinaci s individuálním plánem péče).

Poznámka: Uvedené informace jsou pouze orientační a neměly by nahrazovat klinické zkušenosti či úsudek. V případě, že nedojde ke zlepšení klientova stavu, doporučujeme konzultovat situaci se specialistou.

VAROVÁNÍ

Potah tohoto výrobku je paropropustný, není však prodyšný, proto může představovat nebezpečí udušení. Poskytovatel péče odpovídá za to, aby uživatel uměl používat zařízení bezpečně.

Pokud se v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem vyskytne závažná nežádoucí příhoda ovlivňující uživatele nebo pacienta, pak by ji uživatel nebo pacient měl ohlásit výrobcí či distributorovi zdravotnického prostředku. V Evropské unii by uživatel měl závažnou nežádoucí příhodu rovněž ohlásit příslušnému orgánu v členském státě, v němž se nachází.

Návod k použití

Systém náhrady matrace:

1. Odstraňte všechny obaly.
2. Náhradní matraci *Pentaflex Elegance* položte na rám lůžka a ujistěte se, že na něm nejsou žádné ostré hrany, které by mohly protrhnout potah.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte matraci bez potahu. Slouží jako ochranná bariéra proti biologické kontaminaci pěny.

3. Zkontrolujte, zda indikátor Turntable™ v nožní části potahu zobrazuje správný měsíc. Pokud ne, otočte matraci tak, aby se v nožní části zobrazil správný měsíc. Měsíce jsou zobrazeny následovně:
1/12 = leden
2/12 = únor, atd.
4. Indikátor Turntable používejte jako pomůcku pro otáčení a převracení matrace v měsíčních intervalech. Bude tak zajištěno rovnoměrné opotřebení matrace a prodloužení její životnosti.

Dekontaminace

Cištění potahu

Všechny obnažené povrchy otřete hadříkem navlhčeným v roztoku běžného čisticího prostředku a vody. Dbejte na to, aby byly odstraněny organické nečistoty, které mohou k povrchu potahu přilnout. Zařízení důkladně osušte.

Dezinfekce potahu

Pro dezinfekci doporučujeme použít činidlo uvolňující chlór, jako např. NaOCl nebo NaDCC zředěné na 1 000 ppm (koncentrace se může pohybovat v rozmezí od 250 do 10 000 ppm v závislosti na stupni znečištění a na místních postupech).

Technické údaje

CS

Typický rozměr lůžka	-	-	Akutní jednolůžko	-	-	Komunitní standardní lůžko	Komunitní dvoulůžko
Vhodné pro použití s rámem lůžka Arjo	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 a 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 a Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 a 980	-	-
Velikost (cm) D x Š x H x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Kód výrobku	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Materiál	Vysoce odolná polyuretanová pěna						
Materiál potahu	Polyesterová tkanina s polyuretanovou povrchovou úpravou a zvýšenou odolností						

Matrace PentaFlex Elegance jsou dostupné i v rozměrech upravených na míru, např. PEYYY/ZZZHx, kde YYY je délka (140 až 216 cm) a ZZZ je šířka (66 až 140 cm). Hx specifikuje počet úchyttů (dostupný počet úchyttů je 2, 4, 5, 6 nebo 7). Všechny rozměry je nutno uvádět ve 2cm přírůstcích.

Při kombinaci lůžka a matrace s rozměry neuvedenými v tabulce je povinností zákazníka zajistit kompatibilitu matrace a rámu lůžka. Ověřte si rozměry matrace doporučené výrobcem. Pro další podrobnosti kontaktujte Arjo.

Zpomalení hoření:



Systém splňuje požadavky normy BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, a BS 6807: 2006, 5.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Cigarety, zapalovače, otevřený plamen a obnažené topné články, jako např. v elektrickém topení (a jiných elektrických spotřebičích), jsou zdrojem nebezpečí požáru a mohou zapálit ložní prádlo, pokrývky a oděvy. Matraci proto uchovávejte mimo dosah těchto zdrojů zapálení.

Poznámka: Kouření na lůžku představuje vysoké nebezpečí.

Likvidace po skončení životnosti

Věnujte pozornost následujícím doporučením:

- Textilní materiál použitý na matracích nebo jiné textilie, polymery, plastové materiály apod. by měly být vytrídeny jako hořlavý odpad.
- Matrace by po uplynutí jejich životnosti měly být zlikvidovány v souladu s národními nebo místními požadavky, tj. odvezeny na skládku nebo do spalovny odpadu.

Poznámka: Dodržujte veškeré místní předpisy a – pokud jsou stanoveny – standardní provozní postupy zdravotnického zařízení.

Záruka a servis

Na veškeré výrobky se vztahují standardní smluvní podmínky. Kopie je k dispozici na vyžádání. Obsahuje úplné informace o podmínkách záruky a neomezuje zákonné práva zákazníka.

S dotazy týkajícími se servisu, údržby a jakýmkoli dalšími dotazy souvisejícími s tímto produktem, nebo jakýmkoli jiným, se obraťte na místního distributora.

Symboly



Doporučená teplota praní:
15 min při 60 °C
Maximální teplota praní:
15 min při 95 °C



Nežehlit



Nepoužívejte fenolové čisticí roztoky



Jméno nemocnice



Sušte v bubnové sušičce
při teplotě 60 °C
Maximální teplota sušení 80 °C



Otřete všechny povrchy čisticím roztokem a poté je otřete hadříkem navlhčeným ve vodě a důkladně je vysušte.



Datum prvního použití



Viz návod k použití



Rutinní dezinfekce: 1 000 ppm



Zpomalení hoření



Bezpečné pracovní zatížení (SWL)
140 kg / 309 lb



Značka CE potvrzující shodu s harmonizovanou legislativou Evropského společenství.



Označuje, že výrobek je zdravotnický prostředek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích

KO



경고

부상을 방지하기 위해 제품 사용 전 항상 사용 지침과 첨부 문서를 읽으십시오.



사용 지침을 반드시 읽으십시오.

설계 정책 및 저작권

® 및 ™은 Arjo 그룹사의 상표입니다.


© Arjo 2019.

지속적인 개선은 당사의 방침이므로, 당사는 사전 예고 없이 설계를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.
Arjo의 동의 없이는 본 출판물 내용의 전부 또는 일부를 복사할 수 없습니다.

제품 설명

매트리스 교체 시스템

Pentaflex® 엘레강스 매트리스 교체 디자인은 측면당 5개의 해부학적 압력 재분배 영역이 있으며 원상 회복이 가능한 4방향 회전, 고탄력성 폴리우레탄 코어로 구성되며 양방향 스트레치, 증기 투과성, 방수 커버로 보호됩니다.

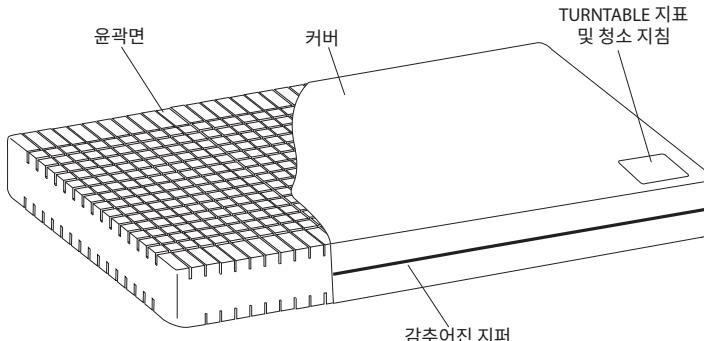

Pentaflex 엘레강스 품 소파(부품 번호 SQB2)는 내장된 침대 확장 부분과 함께 사용하여 키가 큰 환자를 위해 추가로 15 cm를 제공합니다.

KO

경고

매트리스 핸들을 매트리스 이동 시에만 사용하기 위한 것입니다.

임상 적용

사용 지침

Pentaflex 엘레강스는 최대 140 kg(308 lbs / 22 stones)의 사용자용으로 고안되었습니다. 표면 궤양과 같은 질환이 있는 다양한 환자들에게 적합합니다(개별 치료 계획과 관련이 있음).

참고: 이는 단지 지침일 뿐이며 임상 경험 또는 판단을 대체해서는 안 됩니다. 환자 상태가 호전되지 않을 경우, 전문가의 조언을 구해야 합니다.

경고

제품의 커버는 공기 투과 방식이 아닌 증기 투과 방식이며 질식 위험이 나타날 수 있습니다. 사용자가 본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 보장하는 책임은 간병인에게 있습니다.

본 의료기기와 관련하여 사용자 또는 환자에게 영향을 미치는 심각한 사고가 일어나면 사용자나 환자는 해당 심각한 사고를 의료기기 제조업체나 유통업자에게 보고해야 합니다. 유럽연합에서는 사용자가 위치한 해당 주의 감독관청에도 심각한 사고를 보고해야 합니다.

사용 지침

매트리스 교체 시스템:

- 모든 포장을 제거하십시오.
- 넓카로운 가장자리 부분으로 인해 커버가 찢어지지 않도록 유의하여 Pentaflex 엘레강스 매트리스 교체품을 침대 프레임 위에 놓으십시오.

주의 사항

커버 없이 매트리스를 사용하지 마십시오. 커버는 품의 생물학적 오염을 막는 보호 장벽을 제공합니다.

- 정확한 달이 커버 밭 끝에 있는 Turntable™ 지표에 표시되는지 확인하십시오. 부정확한 달이 표시되어 있을 경우 정확한 달이 밭 끝부분에 표시되도록 매트리스를 회전시킵니다. 달은 다음과 같이 표시됩니다.
1/12 = 1월
2/12 = 2월 등
- Turntable 지표를 월별 회전 및 매트리스 회전을 위한 가이드로 사용하십시오. 이는 매트리스가 굽지 않고 제품의 수명을 늘려주는데 도움을 줍니다.

오염 제거

커버 청소 방법

세제 및 물에 적신 천을 사용해 표면 전체를 닦습니다. 표면에 붙어 있을 수 있는 유기 잔해를 제거합니다. 완전히 건조시키십시오.

커버 소독 방법

소독을 위해 NaOCl 또는 NaDCC와 같은 염소이형제를 1,000 ppm(범위는 오염 상태 및 현지 정책에 따라 250~10,000 ppm까지 다를 수 있음)으로 희석하길 권장합니다.

깨끗한 물에 적신 천으로 닦은 후 완전히 말리십시오.

또는 알코올(70%)로 적신 천을 사용한 후 자연 건조할 수 있습니다.

정기 점검

폼 코어 및 커버는 손상, 오염 또는 얼룩이 없는지 정기적으로 검사해야 합니다.

기술 자료

일반 침대 크기	-	-	급성 환자용 싱글 크기	-	-	커뮤니티용 표준 크기	커뮤니티용 더블 크기
Arjo 침대 프레임에 사용하기에 적합	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 및 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 및 Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 및 980	-	-
크기(cm) 길이 x 폭 x 높이 x 핸들의 수	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX 엘레강스 제품 코드	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
재질	고탄성 폴리우레탄 폼						
커버 재질	내구성이 향상된 폴리우레탄 코팅 폴리에스테르 섬유						

PentaFlex 엘레강스 매트리스는 예를 들어 PEYYY/ZZZHx(여기서 YYY는 길이(140 ~ 216 cm)를 가리키며 ZZZ는 너비(66 ~ 140 cm)를 가리키고 Hx는 핸들의 수(사용 가능한 핸들의 수 2, 4, 5, 6 또는 7)를 가리킴) 등의 다양한 맞춤 규격으로 판매됩니다. 모든 크기는 2 cm 단위로 지정해야 합니다.

표에 제공된 지침대로 침대 및 매트리스를 결합하지 않을 경우 매트리스 및 침대 프레임의 호환성이 보장되지 않으며 이는 고객의 책임입니다. 침대 제조업체가 권장하는 매트리스 크기를 참조하십시오. 더 자세한 사항은 Arjo에 문의하시기 바랍니다.

방역:



시스템은 다음의 요건을 충족합니다. BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, 및 BS 6807: 2006, 5.

화재 경고

담배, 라이터, 화염 및 노출된 발열체(예, 전기 난로 및 그외 전기 가전제품)은 화재 위험원이며 침대 린넨, 담요 및 천에 불이 붙을 수 있습니다. 이러한 화재 위험원을 매트리스에 가까이 두지 않아야 합니다.

NB: 침대에서 흡연하는 것은 매우 위험합니다.

수명 종료(End of Life) 제품 폐기

다음 지시를 따를 것을 권장합니다.

- 매트리스에 사용되는 직물 재료 또는 기타 모든 섬유, 종합체 또는 플라스틱 재료 등은 가연성 폐기물로 분류해야 합니다.
- 수명이 종료된 매트리스는 국가 또는 현지 요건에 따라 쓰레기 매립 또는 가연성이 될 수 있는 폐기물로 폐기해야 합니다.

참고: 모든 현지 규정을 준수하고, 해당되는 경우, 의료 시설 표준 운영 절차를 준수합니다.

보증 및 서비스

표준 약관이 모든 판매에 적용됩니다. 사본을 요청할 수 있습니다. 이는 보증 조건의 전체 내용을 포함하고 소비자의 법적 권리를 제한하지는 않습니다.

서비스, 유지 보수 및 이 제품, 또는 기타 다른 제품에 대한 문의사항은 해당 지역의 대리점에 문의하시기 바랍니다.

기호



권장 세척 온도: 60°C에서 15분
최대 세척 온도: 95°C에서 15분



다림질하지 마십시오.



페놀이 함유된 세척제를 사용하지
마십시오.



병원명



60°C에서 회전식 건조기로
건조시키십시오.
최대 건조 온도 80°C



세정액으로 모든 표면을 닦아낸 후
물을 적신 천으로 닦은 다음 완전히
말리십시오.



최초 사용 날짜



사용자 지침을 참조하십시오.



정기 소독: 1,000 ppm.



방염



안전 사용 하중(SWL)
140 kg / 309 lb



유럽 공동체의 조율 규정을
준수하였음을 나타내는 CE 마킹



본 제품은 EU 의료기기 규정
2017/745에 따른 의료 장치임을
나타냄.

KO



คำเตือน



เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ โปรดอ่าน คำแนะนำในการใช้งานนี้ และเอกสารประกอบที่ให้มาด้วยทุกครั้งก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องอ่านคำแนะนำในการใช้งาน

นโยบายด้านการออกแบบและวินิชัยสิกธ์

® และ ™ เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Arjo


© Arjo 2019

เนื้อหาในนโยบายของเรานี้คือการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดแปลงแก้ไขการออกแบบของเราโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาในรูปแบบนี้ก็ได้หมดหรือบางส่วน หากนำไปได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก Arjo

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ระบบเบาะ

ชุดเบาะ PentafileX® Elegance ประกอบด้วยตัวหุบปรับได้ 4 กีฬาทางแบบกลับล่างได้ วัสดุแกนโพลียูรีเทนความยืดหยุ่นสูง พร้อมพื้นที่ปรับกระจายแรงดันตามสภาวะร่างกาย 5 ระดับต่อส่วน ได้รับการปักป่องโดยตัวปรับยืดหยุ่น 2 ทาง ใบหน้าซึ่งผ่านได้ พร้อมปลอกหุ้มที่กันน้ำได้

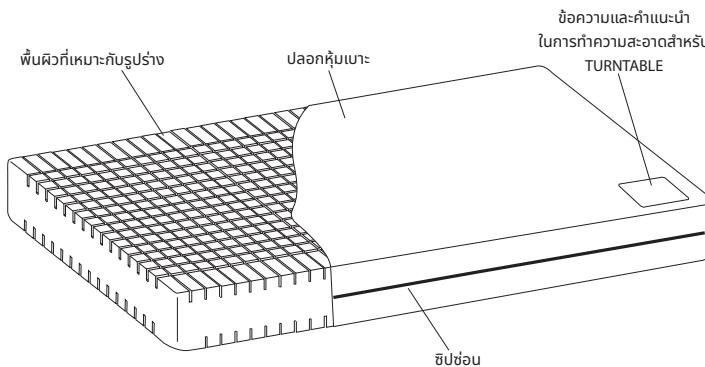

เบาะไฟฟ้าสปริง Pentafilex Elegance (ชั้นล้วนหมายเลขอ SQB2) มีให้เลือกใช้กับส่วนขยายเตียงในตัว ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ 15 ซม. สำหรับคนใช้ที่สูงกว่า

TH

คำเตือน

กรุณารับทราบว่าสำหรับการขับขี่ทางเบาะเท่านั้น

การใช้งานทางคลินิก

ข้อมูลบ่งชี้ในการใช้งาน

Pentafilex Elegance ระบบเบาะใช้กับผู้ใช้ที่กันน้ำหนักสูงสุด 140 กก. (308 ปอนด์/22 สโตน) เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องไปร่วมสิ่งผู้ป่วยที่มีผลพลบดี (โดยสัมพันธ์กับแผนการรักษาเฉพาะบุคคล)

หมายเหตุ: ข้อความเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและไม่ควรใช้แทนคำวินิจฉัยหรือประับการณ์ทางการแพทย์ หากสภาพของผู้ป่วยไม่ดีขึ้น ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

คำแนะนำการใช้งาน

ระบบเบาะสำหรับเปลี่ยน:

1. แกะวัสดุบรรจุทึบหมดออก
2. วางเบาะ Pentafilex Elegance ลงบนโครงเตียง ถูกและให้แบ่งจังหวะไม่มีขอบคมก่ออาเจก์ให้ปลอกหุ้มเบาะอีกข้างได้

ข้อควรระวัง

อย่าใช้เบาะที่ไม่ปิดปลอกหุ้ม ปลอกหุ้มจะช่วยกันหัวกับปักป่องเบาะ ไม่ให้ไฟฟ้าบนเบื้องหลังทำงาน

3. ตรวจสอบว่ามีการแสดงเดือนอย่างถูกต้องบนบัตรข้อความ Turntable™ ที่ล้วนปลายของปลอกหุ้ม หากแสดงเดือนไม่ถูกต้อง ให้หุบเบาะเพื่อให้แสดงเดือนอย่างถูกต้องก่อนที่ส่วนปลายเท้า โดยข้อมูลเดือนหมายความดังนี้
1/12 = บกราคบ
2/12 = ฤกษ์พัฒน์ ฯลฯ
4. ใช้ป้ายข้อความ Turntable เป็นแนวทางสำหรับการหมุนและการปรับเปลี่ยนที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้การเลื่อนสภาพของเบาะเกิดขึ้นทุกด้านได้ และช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ การแพเกินยี่นี ชั้นสั่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานหรือผู้ป่วย ผู้ใช้งานหรือผู้ป่วยควรรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ ในสหภาพโรคปริญี่ปุ่นควรรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในรัฐบาลซึ่งมีอำนาจที่พอกษาอยู่

คำเตือน

ปลอกหุ้มเบาะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบที่ไม่สามารถซื้อได้ แต่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะของผลิตภัณฑ์นี้ ไม่สามารถซื้อได้ และอาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการล้ากการดูแลให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่อย่างปลอดภัยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ดูแล

การขัดการประท้วง

การทำความสะอาดปลอกหัวเมาก

ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด โดยการเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดและน้ำ ตรวจสอบว่าได้เช็ดขัดเคลียร์กันแล้ว ก็เป็นสารอิกรายต่างๆ ซึ่งอาจติดอยู่ที่พื้นผิวอวบน้ำได้ จึงต้องเช็ดให้แห้งสนิท ก่อนนำเข้าห้องน้ำ

การเข้าเชื่อมปลอกห้มเบาะ

สำหรับการห้ามเชื้อ เรายังนำให้ใช้สารที่มีส่วนผสมของคลอริน เช่น NaOCl หรือ NaDCC เจือจางที่ 1,000 ppm (บ่งค่า อาจแตกต่างกันได้ตั้งแต่ 250 ถึง 10,000 ppm ขึ้นกับสถานการปนเปื้อนและนโยบายท้องถิ่น)

เชิดด้วยผ้าชูบหน้าสะอาด และกึ่งไว้ให้แห้งสนิท

หรือใช้ผ้าชูบแลกขอซอล (70%) และปล่อยให้แห้ง

การตรวจสอบเป็นประจำ

แกนปีฟอนและปลอกหุ้มเบาะควรได้รับการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อถูกล้ำร่องของความเสียหาย รอยเปื้อน หรือคราบสกปรกหรือไม่

ข้อมูลด้านเทคโนโลยี

ເບານ *Pentaflex Elegance* ມີໄຫວ້ເລືອກໃຊ້ໃນບາດທີ່ກຳນົດອັບໆ ເຊັ່ນ PEYYYY/ZZZHx ເນື້ອ YYY ພາຍຄົງຄວາມຍາວ (ຮະຫວ່າງ 140 ຄົງ 216 ຊມ.) ແລະ ZZZ ພາຍຄົງຄວາມກວ້າງ (ຮະຫວ່າງ 66 ແລະ 140 ຊມ.) Hx ພາຍຄົງຈຳບັນດ້ານລັບ (ຈຳບັນດ້ານລັບທີ່ມີ 2, 4, 5, 6 ຂອງ 7) ບາດທັງໝົດຕັ້ງຮະບບປັບປຸງທີ່ພື້ນຂຶ້ນ 2 ຂມ.

ເຊື່ອປັກໃຫ້ຮັວງກົບຮະກວ່າງເຕີຍງິນແລະເບາງບອກເຫຼືອຈາກທີ່ຮະບູນໃດຕ່ຖານຂ້າງຕົ້ນ ອຸປະກຳໜ້າທີ່ດູແລກໄສໃຫ້ຈານຮ່ວມກົນໄດ້ຮະກວ່າງເບາງກົບໂຄຣນີເຕີຍງິນນີ້ ໂປດສອນຄານີ້ຜົດລົດເຕີຍງິນຂອງຄົນສົ່ງຂາດເນາງທີ່ແພະນຳ ສ້າງຮ້ຽຮອລະເຍື້ອດພື້ນເຕີມ ໂປດຕິດຕ່ອງ Arjo

សាសនប៊ុងវិរ័យ



ระบบเป็นไปตามข้อกำหนด BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995,
และ BS 6807: 2006 5

คำเตือนเกี่ยวกันไฟ

บุหรี่ ที่จุดบุหรี่ เปปูลไฟ และสิ่งอื่นๆ ที่เปิดความร้อนโดยตรง เช่น ในเตาเผาไฟฟ้า (และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น) เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดอันตรายไฟไหม้ และทำให้ผ้าปะทิช ผ้าห่ม และเสื้อผ้าติดไฟได้ ต้องดูแลเก็บแห้งจากความร้อนดังกล่าวให้ห่างจากเบาะ:

หมายเหตุ: การสบบหรือบันเตียงเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง

การกำจัดเบื้องสืบสุดอายุการใช้งาน

แนะนำให้ถูกต้องตามคำแนะนำไปนี้:

- วัสดุผ้าที่ถูกใช้กับเก็บน้ำ หรือ สิ่งของอื่น ๆ วัสดุโพลีเมอร์ หรือพลาสติกอื่น ๆ เป็นต้น ควรจะจัดเป็นช่องที่ติดไฟได้จำกัด
- ควรกำจัดกับอบนเมื่อสืบสุดอายุการใช้งานเป็นขั้นตอนตามกฎหมายป้องกันของประเทศหรือก้องกีบซึ่งอาจเป็นการฝังกลับหรือการเผาไหม้

หมายเหตุ: โปรดถูกต้องตามมาตรฐานของสถานพยาบาลก่อนที่จะนำส่ง

การรับประคับและบริการ

เชื่อมไฟและข้อกำหนดมาตรฐานมีผลกับการชำห่าภายในห้อง
โดยสามารถขอรับสำเนาเอกสารได้ สำเนาเหล่านี้ประกอบด้วย
รายละเอียดที่ครบถ้วนของเพื่อนในการรับประคับ และไม่ว่ากันด้วย
สิ่งใดของตามกฎหมายของผู้บริโภค

สำหรับการบริการ การซ่อมบำรุง และคำคำนวณได้ฯ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อตัวแทนเก็บจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

สัญลักษณ์



อุณหภูมิการซักล้างที่แนะนำ: 15 นาทีที่ 60°C
อุณหภูมิการซักล้างสูงสุด: 15 นาทีที่ 95°C



อย่ารีด



อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสม
ของฟลูออล



ชื่อโรงพยาบาล



อบแห้งที่ 60°C
อุณหภูมิการอบแห้งสูงสุดที่ 80°C



เช็ดพื้นผิวที่ 60°C
จากบนเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด และกึ่งไว้
ให้แห้งสบัก



อบที่ใช้งานเครื่องแรก



ดูคำแนะนำสำหรับผู้ใช้



การนำเข้าเชือดตามปกติ: 1,000 ppm



สารหน่วงไฟ



น้ำหนักใช้งานที่ปลอดภัย (SWL)
140 กก. / 309 ปอนด์



เครื่องหมาย CE และสิ่งความสอดคล้องกับ
มาตรฐานโลกที่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับ



บังบองว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ตามกฎหมายเป็นอุปกรณ์ทาง
การแพทย์สหภาพยุโรป 2017/745

TH



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травм перед использованием изделия обязательно прочтите данную Инструкцию по эксплуатации и прилагаемые документы.




Обязательно изучите настоящую Инструкцию по эксплуатации.

Описание изделия

Заменитель матраса

Заменитель матраса Pentaflex® Elegance содержит переворачиваемую в четырех направлениях высокоупругую полиуретановую набивку с пятью анатомическими зонами распределения давления на каждую сторону, защищенную растягивающимся в двух направлениях паропроницаемым водостойким чехлом.

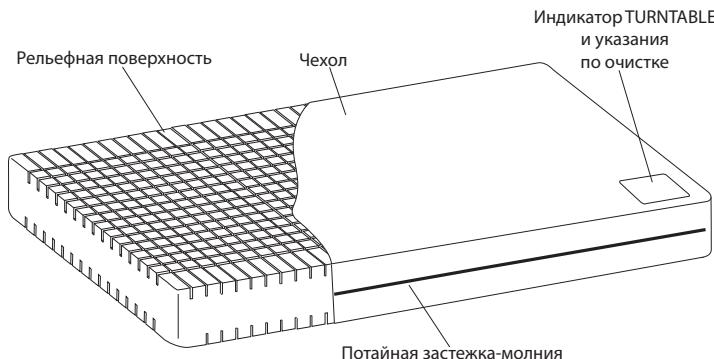

Подушка Pentaflex Elegance из пеноматериала (номер по каталогу SQB2) доступна для использования со встроенным удлинением кровати, обеспечивающим дополнительные 15 см для более высокого пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ручки на матрасе служат только для переноски матраса.

RU

Клиническое применение

Показания к применению

Устройство Pentaflex Elegance предназначено для пользователей весом до 140 кг (308 фунтов / 22 стоннов). Подходит для широкого круга пациентов, включая пациентов с поверхностными язвами (в сочетании с индивидуальным планом лечения).

Примечание. Данные инструкции носят исключительно рекомендательный характер. Решающую роль играют клиническая оценка и состояние пациента. При отсутствии улучшения состояния пациента необходимо проконсультироваться со специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чехол этого изделия паропроницаемый, но не пропускает воздух и может представлять риск удушения. Медработник должен убедиться в безопасности использования изделия пациентом.

При возникновении серьезного инцидента, связанного с данным медицинским устройством и затрагивающего пользователя либо пациента, пользователь либо пациент должен сообщить об этом серьезном инциденте производителю или дистрибутору медицинского устройства. В Европейском союзе пользователь также должен сообщить о серьезном инциденте в компетентный орган того государства — члена ЕС, в котором он находится.

Инструкция по эксплуатации

Заменитель матраса

1. Удалите всю упаковку.
2. Поместите заменитель матраса Pentaflex Elegance на каркас кровати и убедитесь в отсутствии острых краев, способных прорезать чехол.

ОСТОРОЖНО!

Не используйте матрас без чехла. Чехол обеспечивает барьер, защищающий пеноматериал от биологического загрязнения.

3. Убедитесь, что на индикаторе Turntable™ на ножном конце чехла месяц отображается верно. Если он отображается неверно, переверните матрас, чтобы на ножном конце месяц отображался верно. Месяцы обозначаются следующим образом:
1/12 = январь;
2/12 = февраль и т. д.
4. Ориентируйтесь на индикатор Turntable, чтобы поворачивать и переворачивать матрас ежемесячно. Это помогает сделать износ матраса равномерным и продлить срок службы изделия.

Дезинфекция

Чистка чехла

Протрите все открытые поверхности тканью, смоченной обычным моющим средством и водой. Тщательно удалите все органические остатки, которые могут прилипнуть к поверхностям. Вытряните насухо.

Дезинфекция чехла

Для дезинфекции рекомендуется использовать высвобождающий хлор агент, например, гипохлорит натрия (NaOCl) или дихлоризоцианурат натрия (NaDCC), разбавленный до концентрации 1000 м. д. (диапазон концентрации может быть от 250 до 10 000 м. д., в зависимости от степени загрязнения и местных правил).

Технические данные

Стандартный размер кровати			Односпальная для отделений неотложной помощи			Стандартный размер, для ухода за пациентами в домашних условиях	Двойной размер, для ухода за пациентами в домашних условиях
Подходит для использования на каркасе кроватей Arjo	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 и 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 и Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 и 980	-	-
Размер (см) Д x Ш x Г x Нx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Код продукта	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Материал	Высокоупругий полиуретановый пеноматериал						
Материал чехла	Ткань из полиэстера с полиуретановым покрытием, обладающая повышенной износостойкостью						

Матрасы PentaFlex Elegance доступны в других специализированных размерах, например PEYYY/ZZZHx, где YYY — длина (от 140 до 216 см) и ZZZ — ширина (от 66 до 140 см), Hx — количество ручек (доступное количество ручек: 2, 4, 5, 6 или 7). Все размеры необходимо указывать с шагом в 2 см.

При использовании кроватей и матрасов, не указанных в приведенной таблице, потребитель сам несет ответственность за совместимость матраса и каркаса кровати. За информацией о рекомендуемых размерах матрасов обращайтесь к производителям кроватей. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Arjo.

Огнестойкость



Система отвечает требованиям стандартов BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, и BS 6807: 2006, 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сигареты, зажигалки, открытый огонь и открытые нагревательные элементы, например, в электрокаминах (и других электрических устройствах), являются источниками пожарной опасности и могут привести к воспламенению белья, одеяла и одежды.

Такие источники огня необходимо держать на удалении от матраса.

Примечание. Курить в кровати чрезвычайно опасно.

Утилизация после окончания срока службы

Соблюдайте следующие рекомендации:

- Тканый материал на матрасах или любые другие ткани, полимеры либо пластиковые материалы и т. п. следует сортировать как горючие отходы.
- По окончании срока службы матрасы следует утилизировать как отходы в соответствии с национальными или местными нормативными требованиями, что может предусматривать захоронение на полигоне или сжигание.

Примечание. Следуйте всем местным правилам и, если применимо, стандартным операционным процедурам учреждения здравоохранения.

Гарантия и сервисное обслуживание

Ко всем продаваемым изделиям применяются стандартные условия и сроки. Копия предоставляется по запросу. В ней содержатся все детали условий гарантии, и она не ограничивает законных прав потребителя.

По вопросам сервисного и технического обслуживания, а также любым другим вопросам относительно данного или любого другого изделия обращайтесь к местному дистрибутору.

Символы



Рекомендуемая температура стирки:
15 мин. при 60 °C



Максимальная температура стирки:
15 мин. при 95 °C



Не гладить



Название медицинского учреждения



Сушка в сушильной машине при 60 °C
Максимальная температура сушки — 80 °C



Протирать все поверхности
очищающим раствором, затем
протирать тканью, смоченной водой,
и вытираять насухо.



Дата первого использования



См. инструкции для пользователя



Регулярная дезинфекция: 1000 м. д.



Огнестойкость



Безопасная рабочая нагрузка (SWL)
140 кг / 309 фунтов



Маркировка CE указывает
на соответствие гармонизированному
законодательству Европейского
сообщества



Означает, что продукт представляет
собой медицинское устройство
согласно регламенту EC
по медицинским устройствам 2017/745

RU



ЕСКЕРТУ




Жарақатты болдырмау үшін өнімді пайдаланудан бұрын осы пайдалану нұсқаулары мен бірге берілген құжаттарды оқып шығыңыз.

Пайдалану нұсқауларын міндепті түрде оқу керек.

Өнім сипаттамалары

Матрасты ауыстыру жүйесі

Pentaflex® Elegance матрасты ауыстыру құрылымы қайтымды 4 жақты бұрылыстан, 2 жақты кергімен қорғалған, 5 анатомиялық қысымды қайта бөлуші аумақтары бар ілгіштігі жоғары полиуретан езектен, бу өткізіш, су өткізбейтін қаптамадан тұрады.

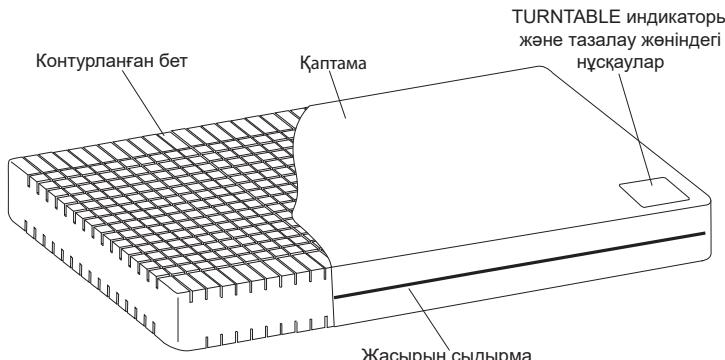

Pentaflex Elegance көбік толтырмасы (бөлшек нөмірі SQB2) орнатылған кереует үзартқыштарымен бірге пайдалану үшін қолжетімді және ол ұзынырақ пациент үшін қосымша 15 см қамтамасыз етеді.

ЕСКЕРТУ

Матрас тұтқалары матрасты тасымалдауға ғана арналған.

Клиникалық қолдану

Пайдалану нұсқаулары

Pentaflex Elegance салмағы 140 кг (308 фунт / 22 стоун) дейінгі пайдаланушыларға арналған. Сыртқы жаралары бар пациенттердің көс алғанда, пациенттердің көн ауқымына жарамды (жеке күтім жасау жоспарымен бірге).

Ескерте: Бұлар тек ұзыныстар болып табылады және клиникалық тәжірибелі немесе бағалауды алмастырмайды. Пациенттің жағдайы жақсармаса, маманмен кенесу керек.

ЕСКЕРТУ

Бұл өнімнің қаптамасы бу өткізеді, бірақ ауа өткізбейді және тұншығу қаупін тұдырыу мүмкін. Пайдаланушының бұл өнімді қауісіз түрде пайдалануы үшін күтім жасаушы жауапты болады.

Осы медициналық құрылымға қатысты қауіпті инцидент орын алып, пайдаланушыға немесе пациентке әсер ететін болса, пайдаланушы немесе пациент қауіпті инцидент туралы өндірүшіге немесе дистрибуторға хабарлауы керек. Сонымен қатар Еуропалық Одақтағы пайдаланушы өзі орналасқан мүшесі мемлекеттегі өкілдегі үйимға қауіпті инцидент туралы хабарлауы керек.

Пайдалану нұсқаулары

Матрасты ауыстыру жүйесі:

KK

1. Қаптаманы толығымен алып тастаңыз.
2. Pentaflex Elegance матрасты ауыстыру жүйесін кереует жақтауына қойыңыз, қаптаманы жыртуы мүмкін үшкір жиектердің болмауына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Қаптамасыз матрасты пайдаланбаңыз. Ол көбіктің биологиялық ластануына қарсы қорғаныш тосқауылды қамтамасыз етеді.

3. Қаптаманың төменгі жағында Turntable™ индикаторында айдың дұрыс көрсетілгенін тексеріңіз. Егер ай дұрыс көрсетілмесе, төменгі жағында ай дұрыс көрсетілетін етіп матрасты бұрыңыз. Айлар билай көрсетіледі:
1/12 = Қантар
2/12 = Ақпан, т.б.
4. Turntable индикаторын матрасты ай сайын бұру және айналдыру нұсқаулығы ретінде пайдаланыңыз. Бұл матрастың тозуын азайтуға және өнімді пайдалану мерзімін ұзартуға көмектеседі.

Деконтаминация

Қаптаманы тазалау

Барлық ашық беттерді қаралайым жуғыш құралмен және сүмен ылғалданған шүберекпен сұртіңіз. Беттерге жабысқан органикалық қалдықтарды жойыңыз. Толық құргатыңыз.

Қаптаманы заарсыздандыру

Заарсыздандыру үшін хлор бөлгіш агентті ұсынамыз, мысалы, NaOCl немесе NaDCC, 1000 ppm (ластану жағдайы мен жергілікті саясатқа байланысты ауқым 250 және 10 000 ppm арасында өзгеруі мүмкін) дейін сүйылтылған.

Таза сүмен ылғалданған шүберекпен сұртіңіз және толық құргатыңыз.

Әйтпесе, спиртпен (70%) ылғалданған шүберекті пайдаланып, ауда құргатыңыз.

Жоспарлы тексерулер

Бұлғын, ластану немесе кірлеу белгілерін анықтау мақсатында көбік өзекті және қаптаманы жүйелі түрде тексеріп түрү керек.

Техникалық деректер

Стандартты кереует өлшемі			Acute бір өлшемі			Жалпы стандартты өлшемі	Жалпы қос өлшем
Arjo кереуеті үшін жарамды	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 және 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 және Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 және 980	-	-
Өлшемі (см) Ұ x Е x Қ x Нx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Өнім коды	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Материал	Илігіштірілген жоғары полиуретан көбік						
Қаптама материалы	Беріктірілген жоғары полиуретан жабынмен қапталған полиэстерден жасалған мата						

KK

PentaFlex Elegance матрастары басқа арнаіы өлшемдерде қолжетімді, мысалы, PEYYY/ZZZHx, мұндағы YYY үзындықты көрсетеді (140 және 216 см арасында) және ZZZ енін көрсетеді (66 және 140 см арасында), Hx тұтқалар санын көрсетеді (қолжетімді тұтқалар саны: 2, 4, 5, 6 немесе 7). Барлық өлшемдер 2 см қадаммен көрсетіліп керек.

Жоғарыда көрсетілген кестеден тыс кереуеттер мен матрастарды бірге пайдаланғанда, матрас пен кереует жақтауының үйлесімділігіне тұтынушының өзі жауапты болады. Кереуетті өндірушілердің ұсынған матрас өлшемдерін қараңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін Arjo компаниясына хабарласыңыз.

Өртті бөгөу мүмкіндігі:



Жүйе BS EN 597-1 талаптарына сәйкес келеді: 1995, BS EN 597-2: 1995, және BS 6807: 2006, 5.

ӨРТ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Шылым, оттық, ашық жалын және ашық қыздырығыш элементтер, мысалы, электр каминдері (және басқа электр құрылғылардағы) өрт қаупінің көздері болып табылады және төсекті, көрпені және киімді тұтатуы мүмкін. Мұндай өрт көздерін матрасқа жақыннатпау керек.

NB: Төсекте шылым шегу өте қауіпті.

Жарамдылық мерзімі аяқталғанда утилизациялау

Келесі көнеш ұсынылады:

- Матрasta пайдаланылатын мата материалы немесе басқа да матадан жасалған бүйімдар немесе полимер не пластикалық материалдар және т.б. жанғыш қоқыстар ретінде сұрыпталуы керек.
- Жарамдылық мерзімі аяқталған матрастар ұлттық немесе жергілікті талаптарға сәйкес кемілетін немесе өртепетін қоқыстар ретінде утилизациялануы керек.

Ескертпе: Барлық жергілікті ережелерді, егер қолданылса, медициналық мекеменің стандартты пайдалану процедураларын орындаңыз.

Кепілдік және қызмет көрсету

Барлық сатылымдарға стандартты шарттар қолданылады. Көшірме сұрату арқылы қолжетімді. Олар кепілдік шарттары жайлы толық мәліметтерді қамтиды және тапсырыс берушінің заңды құқықтарын шектемейді.

Қызмет көрсету, жөндеу және осы өнімге қатысты кез келген сұрақтар бойынша жергілікті жергілікті дистрибуторға хабарласыңыз.

Таңбалар



Ұсынылған жуу температуrasesы:
15 минут, 60°C
Максималды жуу температуrasesы:
15 минут, 95°C



Үтіктеуге болмайды



Фенол негізіндеі тазалағыш
ерітінділерді пайдаланбаңыз



Аурухана атауы



Кептіру 60°C
Максимал кептіру температуrasesы
80°C



Барлық беттерді тазалағыш
ерітіндімен сүртіңіз, содан кейін
сүмен ылғалданған шуберекпен
сүртіп, мұқият құргатыңыз.



Пайдалануды бастау күні



Пайдалану жөніндегі нұсқауларды
қараңыз



Жоспарлы заарсыздандыру:
1000 ppm.



Өтті бөгөу мүмкіндігі



Қауіпсіз жұмыс жүктемесі (SWL)
140 кг / 309 фунт



Еуропалық Одақтың келісілген
заяннамасына сәйкестігін көрсететін
CE белгісі



Өнімнің ЕО 2017/745 медициналық
құрылғы реттеуіне сәйкес
медициналық құрылғы екенін
білдіреді

KK



UYARI

Yaralanmayı önlemek için, ürünü kullanmadan önce mutlaka bu Kullanım Talimatlarını ve ürünle birlikte verilen belgeleri okuyun.




Kullanım Talimatlarının okunması zorunludur.

Ürün Tanımları

Şilte sistemi

Pentaflex® Elegance şilte tasarımında, 2 yönlü gerdirilebilir, su buharını geçiren fakat suya dirençli bir kılıf ile korunan, her tarafında 5 anatomik basınç yeniden dağılım bölgelerine sahip tersine çevrilebilen ve 4 taraflı kullanılabilen dayanıklılığı yüksek poliüretan dolgu bulunmaktadır.

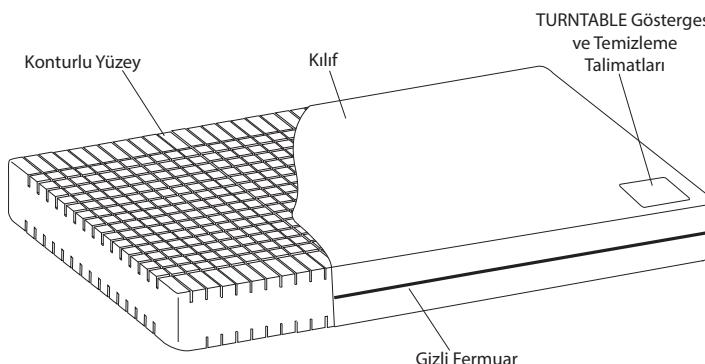

Pentaflex Elegance köpük minder (parça no. SQB2), uzun boylu hastalar için 15 cm ilave uzunluk sağlayan dahili yatak uzatmalarıyla birlikte kullanılabilir.

UYARI

Şilte kolları, sadece şiltenin taşınması içindir.

Klinik uygulamalar

Kullanım Endikasyonları

Pentaflex Elegance, ağırlığı 140 kg'yi (308 lb / 22 taşı) geçmeyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Yüzeysel ülserli hastalar da dahil olmak üzere geniş bir hasta yelpazesi için uygundur (kişiselleştirilmiş bakım planıyla bağlantılı olarak).

Not: Bunlar, sadece bir kılavuzdur ve klinik bir deneyimin veya hükmün yerini almamalıdır. Hastanın durumunda iyileşme kaydedilemezse uzman tavsiyesine başvurulmalıdır.

UYARI

Bu ürünün kılıfı buhar geçirir ancak hava geçirmez ve boğulma riski doğurabilir. Kullanıcının bu ürünü güvenli bir şekilde kullanması, sağlık personelinin sorumluluğundadır.

Bu tıbbi cihaza ilişkin olarak kullanıcıyı veya hastayı etkileyen ciddi bir olayın meydana gelmesi durumunda kullanıcı veya hasta, bu ciddi olayı tıbbi cihaz üreticisine veya distribütöre bildirmelidir. Avrupa Birliği'nde, kullanıcı bu ciddi olayı bulunduğu üye ülkedeki Yetkili Makama da bildirmelidir.

Kullanım Talimatları

Şilte sistemi:

1. Tüm ambalajı çıkartın.
2. *Pentaflex Elegance* şilteyi, kılıfı yırtabilecek keskin kenarlar olmadığından emin olarak yatak profiline yerleştirin.

DİKKAT

Şilteyi kılıfsız kullanmayın. Kılıf, köpük kaynaklı biyolojik kirlenmelere karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.

3. Kılıfın ayak ucu kısmındaki Turntable™ göstergesinde doğru ayın gösterildiğinden emin olun. Yanlış ay gösteriliyorsa ayak ucunda doğru ay gösterilecek şekilde şilteyi döndürün. Aylar şu şekilde gösterilir:
1/12 = Ocak
2/12 = Şubat vb.
4. *Turntable* göstergesini, hem aylık rotasyonda hem de şilteyi çevirmede bir kılavuz olarak kullanın. Bu durum, eşit derecede aşınmasına ve ömrünün uzamasına yardımcı olur.

Dekontaminasyon

Kılıfı Temizlemek için

Tüm açık yüzeyleri basit bir deterjan ve suda nemlendirilmiş bez ile silin. Yüzeylere yapışabilecek tüm organik tortuları temizlediğinizden emin olun. İyice kurulayın.

Kılıfı Dezenfekte Etmek için

Dezenfeksiyon için 1000 ppm'e (kirlilik durumuna ve yerel mevzuata bağlı olarak aralık 250 ppm ve 10.000 ppm arasında değişebilir) seyreltilmiş NaOCl veya NaDCC gibi klor salan bir madde kullanılması önerilir.

Temiz suyla nemlendirilmiş bir bezle silin ve iyice kurulayın.

Alternatif olarak alkol (%70) ile nemlendirilmiş bir bez kullanın ve açık havada kurumaya bırakın.

Rutin kontroller

Sünger ve kılıfı, hasara, kirliliğe ve lekelere karşı düzenli olarak incelenmelidir.

Teknik Veriler

Tipik Yatak boyutu	-	-	Klinik Tek Boyut	-	-	Evde Bakım Standart Boyutu	Evde Bakım Çiftli Boyutu
Arjo Yatak Profili Üzerinde kullanılabilir	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 ve 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 ve Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 ve 980	-	-
Ebat (cm) U x G x D x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Ürün Kodu	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Malzeme	Yüksek dayanıklı poliüretan sünger						
Kılıf Malzemesi	Daha yüksek dayanıklılığa sahip poliüretan kaplı polyester kumaş						

TR

Pentaflex Elegance şılteleri, PEYYY/ZZZHx gibi özel yapılmış boyuttarda da mevcuttur. YYY uzunluğu (140 cm ila 216 cm), ZZZ ise genişliği (66 cm ila 140 cm) belirtir. Hx tutma yeri sayısını belirtir (kullanılabilir tutma yeri sayısı: 2, 4, 5, 6 veya 7). Tüm boyutlar, 2 cm'lik artışlarla belirtilmelidir.

Yatakları ve şılteleri yukarıda verilen tablo haricinde bir araya getirirken şilte ve yatak profiline uyumluluğunu sağlamak müşterinin sorumluluğundadır. Önerilen yatak boyutları için lütfen yatak üreticilerine başvurun. Daha fazla ayrıntı için Arjo ile irtibata geçin.

Yanma geciktiricilik:



Sistemin gereksinimlerini karşıladığı standartlar şunlardır: BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, ve BS 6807: 2006, 5.

YANGIN UYARISI

Sigaralar, çakmaklar, kontrollsüz alevler ve elektrikli soba gibi (ve diğer elektrikli cihazlar) açık isıtma elementleri, yanın tehlikesi için bir kaynaktır ve yatak çarşafını, battaniyeleri ve kıyafetleri tutuşturabilir. Bu yanın kaynaklarının şilteden uzak tutulması önemlidir.

NB: Yataktta sigara içmek oldukça tehlikelidir.

Kullanım Ömrü Sonunda Atma

Aşağıdaki işlem tavsiye edilir:

- Şiltelerde kullanılan kumaş malzemesi veya herhangi bir diğer tekstil ürünü, polimerler veya plastik malzemeler vb. yanıcı atık olarak sınıflandırılmalıdır.
- Kullanım ömrü dolmuş şilteler, ulusal veya yerel gereklilikler uyarınca atık gömme veya yakma yoluyla atık olarak imha edilmelidir.

Not: Tüm yerel düzenlemelere ve varsa sağlık kuruluşunun standart işletme prosedürlerine uyun.

Garanti ve Servis

Standart huküm ve şartlar tüm satışlar için geçerlidir. Talep üzerine bir kopya temin edilebilir. Bu, garanti koşullarının tüm detaylarını içerir ve tüketicinin yasal haklarını sınırlamaz.

Bu ürün veya herhangi bir ürünle ile ilgili servis, bakım ve tüm sorularınız için, lütfen yerel bayinize başvurun.

Semboller

Önerilen yıkama sıcaklığı:

60°C'de 15 dak

Maksimum yıkama sıcaklığı:

95°C'de 15 dak



Ütülemeyin



Fenol bazlı temizlik çözeltileri kullanmayın



Hastane adı



60°C'de tamburlu kurutma
Maksimum kurutma sıcaklığı
80°C'dir



Tüm yüzeyleri temizlik çözeltisi ile silerek temizleyin ve suyla nemlendirilmiş bezle sildikten sonra iyice kurulayın.



İlk kullanım tarihi



Kullanım talimatlarına bakın



Rutin dezenfeksiyon: 1000 ppm.



Yanmaya dayanıklı



Güvenli Çalışma Yükü (SWL)
140 kg/309 lb



Avrupa Topluluğu uyumlulAŞtırılmış yönetmeliklerine uyumluluğu gösteren CE işaretü



2017/745 sayılı AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre bu ürünün bir Tıbbi Cihaz olduğunu gösterir

TR



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή τραυματισμών, πάντα να διαβάζετε τις παρούσες Οδηγίες χρήσης και τα συνοδευτικά έγγραφα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.



Υποχρέωση ανάγνωσης των Οδηγιών χρήσης.

Πολιτική σχεδιασμού και πνευματικά δικαιώματα
Τα ® και ™ είναι εμπορικά σήματα, τα οποία ανήκουν στον όμιλο εταιρειών Arjo.


© Arjo 2019.

Δεδομένου ότι η πολιτική της εταιρείας μας στοχεύει στη διαρκή βελτίωση, διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης σχεδίων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αντιγραφή των περιεχομένων αυτής της έκδοσης χωρίς τη συγκατάθεση της Arjo.

Περιγραφές Προϊόντος

Σύστημα αντικατάστασης στρώματος

Το στρώμα Pentaflex® Elegance αποτελείται από ένα 4 κατευθύνσεων τοποθέτησης πυρήνα πολυουρεθάνης υψηλής ελαστικότητας με 5 ζώνες ανακατανομής της πίεσης, ο οποίος προστατεύεται από ένα ελαστικό κάλυμμα 2 κατευθύνσεων, διαπερατό από τον ατμό και ανθεκτικό στο νερό.

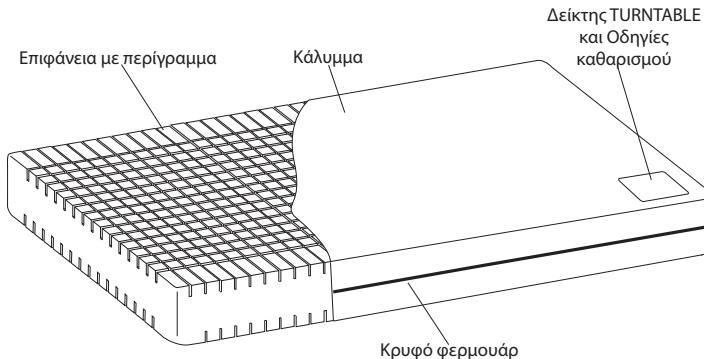

Με τις ενσωματωμένες επεκτάσεις της κλίνης διατίθεται για χρήση αφρώδες επίθεμα Pentaflex Elegance (εξάρτημα αρ. SQB2), προσφέροντας επιπλέον 15 cm για ψηλότερους ασθενείς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι χειρολαβές του στρώματος προορίζονται για τη μεταφορά του στρώματος μόνο.

Κλινικές εφαρμογές

Ενδείξεις χρήσης

Το Pentaflex Elegance ενδέικνυται για χρήστες με βάρος μέχρι 140 κιλά (308 λίβρες/22 stones). Είναι κατάλληλο για ένα μεγάλο φάσμα ασθενών, συμπεριλαμβανομένων όσων εμφανίζουν επιπλανειακά έλκη (σε συνδυασμό με το εξατομικευμένο πρόγραμμα ιατρικής φροντίδας)

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες οδηγίες και δεν υποκαθιστούν την κλινική εμπειρία ή κρίση. Εάν δεν διαπιστώνεται βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς, πρέπει να αιτείται συμβούλη ειδικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το κάλυμμα αυτού του προϊόντος είναι διαπερατό από τον ατμό αλλά όχι τον αέρα και μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας. Η ευθύνη για τη διασφάλιση της χρήσης αυτού του προϊόντος με ασφάλεια από το χειριστή ανήκει στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Εάν προκύψει σοβαρό περιστατικό σε σχέση με αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν που επηρεάζει τον χρήστη ή τον ασθενή, ο χρήστης ή ο ασθενής θα πρέπει να αναφέρει το σοβαρό περιστατικό στον καπασευαστή ή τον διανομέα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χρήστης θα πρέπει επίσης να αναφέρει το σοβαρό περιστατικό στην Αρμόδια Αρχή στο Κράτος Μέλος όπου βρίσκεται.

Οδηγίες χρήσης

Σύστημα αντικατάστασης στρώματος:

- Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία.
- Τοποθετήστε το στρώμα Pentaflex Elegance επάνω στο πλαίσιο της κλίνης, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν αιχμές που μπορούν να σχίσουν το κάλυμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε το στρώμα χωρίς κάλυμμα. Παρέχει ένα προστατευτικό φραγμό ενάντια στην βιολογική μόλυνση του αφρού.

- Διασφαλίστε ότι ο δείκτης Turntable™ στο άκρο ποδιών του καλύμματος εμφανίζει το σωστό μήνα. Εάν δεν εμφανίζεται ο σωστός μήνας, περιστρέψτε το στρώμα ώστε ο σωστός μήνας να βρίσκεται στο άκρο ποδιών. Οι μήνες υποδεικνύονται ως εξής:
1/12 = Ιανουάριος
2/12 = Φεβρουάριος, κ.λπ.
- Χρησιμοποιήστε το δείκτη Turntable ως οδηγό για τη μηνιαία περιστροφή και αναστροφή του στρώματος. Αυτό βοηθά στην εξουάλυνση της φθοράς του στρώματος και την επέκταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

EL

Απολύμανση

Για να καθαρίσετε το κάλυμμα

Σκουπίστε όλες τις εκτεθειμένες επιφάνειες με πανί ποτισμένο σε απόλο (ουδέτερο) απορρυπαντικό και νερό. Διασφαλίστε ότι απομακρύνετε τα οργανικά υπολείμματα που ενδέχεται να έχουν επικολληθεί στις επιφάνειες. Στεγνώστε σχολαστικά.

Για να απολυμάνετε το κάλυμμα

Για την απολύμανση συστήνεται η χρήση καθαριστικού με αποδέσμευση χλωρίου όπως NaOCl ή NaDCC αραιωμένο κατά 1.000 ppm (η αναλογία μπορεί να διαφέρει μεταξύ 250 & 1000 ppm ανάλογα με την κατάσταση μόλυνσης και την τοπική πολιτική).

Τεχνικά Στοιχεία

Τυπικό μέγεθος κλίνης	-	-	Acute Μέγεθος μονής κλίνης	-	-	Community Τυπικό μέγεθος	Community Μέγεθος διπλής κλίνης
Κατάλληλο για χρήση στο πλαίσιο κλίνης Αριό	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 και 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 and Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 and 980	-	-
Διαστάσεις (cm) L x W x D x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Κωδικός προϊόντος	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Υλικό	Μεγάλης ανθεκτικότητας αφρός πολυουρεθάνης						
Υλικό καλύμματος	Ύφασμα πολυεστέρα με επίστρωση πολυουρεθάνης με ενισχυμένη αντοχή						

EL

Τα στρώματα PentaFlex Elegance διατίθενται και σε άλλα προσαρμοσμένα μεγέθη, π.χ. EYYY/ZZZHx, όπου το YYY προσδιορίζει το μήκος (μεταξύ 140 και 216cm) και το ZZZ προσδιορίζει το πλάτος (μεταξύ 66 και 140cm), το Hx προσδιορίζει αριθμό λαβών (διαθέσιμος αρθιμός λαβών 2, 4, 5, 6 or 7). Όλα τα μεγέθη πρέπει να προσδιορίζονται σε προσαυξήσεις των 2 cm.

Κατά το συνδυασμό κλίνων και στρωμάτων εκτός του παραπάνω πίνακα, αποτελεί ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει τη συμβατότητα του στρώματος και του πλαισίου της κλίνης. Ανατρέξτε στα συνιστώμενα μεγέθη στρώματος των κατασκευαστών των κλίνων. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την Αριό.

Επιβράδυνση φλόγας:



Το σύστημα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, και BS 6807: 2006, 5.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Τα τσιγάρα, οι αναπτήρες, η γυμνή φλόγα και τα εκτεθειμένα θερμαντικά στοιχεία, π.χ. σε ηλεκτρικές πυρκαγιές (και άλλες ηλεκτρικές συσκευές) αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς και μπορούν να αναφλέξουν τα κλινοσκεπάσματα, τις κουβέρτες και τα ενδύματα. Είναι σημαντικό αυτές οι πηγές πυρκαγιάς να διατηρούνται μακριά από το στρώμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να καπνίζετε στην κλίνη.

Απόρριψη στο τέλος του κύκλου ζωής

Συστήνονται τα παρακάτω:

- Τα υφασμάτινα υλικά που χρησιμοποιούνται στα στρώματα ή οποιαδήποτε άλλα υφάσματα, πολυμερή ή πλαστικά υλικά κ.λπ. Θα πρέπει να ταξινομούνται ως εύφλεκτα απόβλητα.
- Τα στρώματα στο τέλος της διάρκειας ζωής τους θα πρέπει να απορρίπτονται ως απόβλητα σύμφωνα με τις εθνικές ή τοπικές απαιτήσεις, όπως υγειονομική ταφή ή καύση.

Σημείωση: Ακολουθήστε όλες τις τοπικές νομοθεσίες και, όπου είναι εφικτό, τις στερεότυπες λειτουργικές διαδικασίες των κέντρων υγείας.

Εγγύηση και σέρβις

Εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για όλα τα προϊόντα. Υπάρχει διαθέσιμο αντίγραφο κατόπιν αιτήματος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιέχουν πλήρεις λεπτομέρειες των όρων εγγύησης και δεν περιορίζουν τα δικαιώματα του καταναλωτή.

Για τις εργασίες σέρβις, συντήρησης και τυχόν ερωτήματα σχετικά με αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα.

Σύμβολα



Συνιστώμενη θερμοκρασία πλυσίματος:
15 λεπτά στους 60°C

Μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος:
15 λεπτά στους 95°C



Μη σιδερώνετε



Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά διάλυμα με βάση τη φαινόλη



Ονομασία νοσοκομείου



Μηχανικό στέγνωμα στους 60°C
Μέγιστη θερμοκρασία στεγνώματος 80°C



Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με διάλυμα καθαρισμού και στη συνέχεια με ένα πανί νοτισμένο με νερό και στεγνώστε διεξοδικά.



Ημερομηνία πρώτης χρήσης



Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης



Τυπική απολύμανση: 1.000 ppm.



Επιβράδυνση φλόγας



Φορτίο ασφαλούς λειτουργίας (SWL)
140 κιλά / 309 λίβρες



Σήμανση CE που υποδηλώνει συμμόρφωση με την εναρμονισμένη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας



Υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 2017/745

EL



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



За да избегнете нараняване, винаги четете тези Инструкции за употреба и придружаващите документи, преди да използвате продукта.

Задължително е да прочетете Инструкциите за употреба.

BG

Политика за дизайн и авторско право

® и ™ са търговски марки, притежание на групата компании Arjo.


© Arjo 2019.

Тъй като нашата политика е насочена към непрекъснато усъвършенстване, ние си запазваме правото да променяме дизайна без предизвестие. Съдържанието на настоящата публикация неможе да се копира – изцяло или частично – без съгласието на Arjo.

Описания на продуктите

Система на сменяемия матрак

Конструкцията на системата на сменяемия матрак Pentaflex® Elegance се състои от обръщащо се на 4 посоки ядро от полиуретанова пяна с висока гъвкавост с 5 анатомични зони за преразпределение на натиска от всяка страна, защитено от 2-посочен, разтягащ се, пропускливи на пари и устойчив на вода калъф.

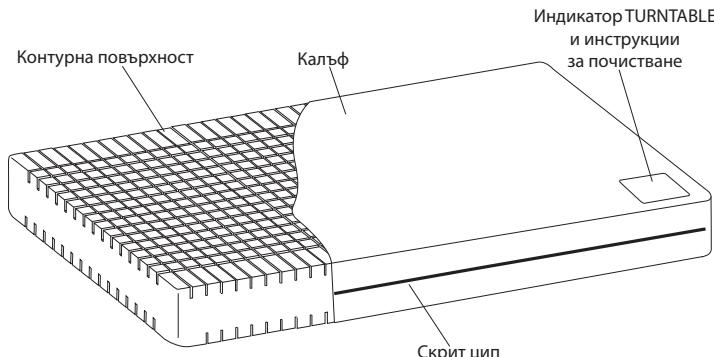

Предлага се за използване възглавничка от пяна Pentaflex Elegance (номер на част SQB2) с вградени удължения на леглото, осигуряваща допълнителни 15 см за по-високите пациенти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дръжките на матрака са предназначени само за транспортирането му.

Клинични приложения

Указания за употреба

Pentaflex Elegance е предназначен за потребители до 140 kg (308 фунта / 22 стона). Подходящ е за множество пациенти, включително за тези с несериозни рани (съвместно с индивидуализиран план за грижи).

Забележка: Това са само препоръки и не трябва да заменят клиничната преценка или опит.

Ако няма подобрене в състоянието на пациента, трябва да се потърси съвет на специалист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Калъфът на този продукт е пропусклив на пари, но не и въздухопропусклив – затова може да представлява риск от задушаване. Отговорност на болногледача е да се увери, че потребителят може да използва този продукт по безопасен начин.

Ако възникне сериозен инцидент, свързан с това медицинско устройство и засягаш потребител или пациента, то потребителят или пациентът трябва да съобщят за този инцидент на производителя или дистрибутора на медицинското изделие. В Европейския съюз потребителят трябва да съобщи за сериозния инцидент също и на компетентния орган в държавата членка, където се намира.

Инструкции за употреба

Система на сменяемия матрак:

1. Премахнете цялата опаковка.
2. Разстелете сменяемия матрак Pentaflex Elegance върху рамката на леглото, като се уверите, че няма остри ръбове, които може да раздерат калъфа.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте матрака без калъф. Тя осигурява защитна бариера срещу биологичното замърсяване на пянатата.

3. Уверете се, че на индикатора Turntable™ в долния край на калъфа е показан правилният месец. Ако се показва грешен месец, завъртете матрака, така че в края за краката да се покаже правилният месец. Месеците са указаны, както следва:
1/12 = януари
2/12 = февруари и т.н.
4. Използвайте индикатора Turntable като насока за месечното завъртане и обръщане на матрака. Това помага да се изравни износването и да се удължи животът на продукта.

Обеззаразяване

За почистване на калъфа

Избръшете всички отворени повърхности с кърпа, която е била навлажнена в обикновен дегергент и вода. Трябва да премахнете всякакви органични нечистотии, които може да са се залепили към повърхностите. Изсушете старательно.

За дезинфекциране на калъфа

За дезинфекция препоръчваме отделящ хлор агент, като например NaOCl или NaDCC, разтворени в съотношение 1000 ppm (диапазонът може да варира между 250 и 10 000 ppm в зависимост от степента на контаминация и местната политика).

Избръшете с кърпа, навлажнена с чиста вода, и подсушете щателно.

Също така може да използвате кърпа, навлажнена със спирт (70%) и да оставите да изсъхне на въздух.

Рутинни проверки

Ядрото от пяна и калъфт трябва да се инспектират редовно за всякакви следи наповреда, замърсяване или петна.

Технически данни

Стандартен размер на легло	-	-	Остро, единичен размер	-	-	Общностно, стандартен размер	Общностно, двоен размер
Подходящо за използване с рамки за легло на Arjo	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 и 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 и Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 и 980	-	-
Размери (см) Д x Ш x В x Нx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Продуктов код	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Материал	Полиуретанова пяна с висока гъвкавост						
Материал на калъфа	Покрита с полиуретан полиестерна тъкан с повишенна издръжливост						

Матраките Pentaflex Elegance се предлагат в други персонализирани размери, като например PEYYY/ZZZHx, където YYY указва дължината (между 140 и 216 см), а ZZZ указва широчината (между 66 и 140 cm), Hx указва броя дръжки (предлагат се 2, 4, 5, 6 или 7 дръжки). Всички размери трябва да са указаны в стъпки от по 2 см.

Когато се комбинират легла и матраци извън дадената по-горе таблица, потребителят носи отговорност за осигуряване на съвместимостта на матрака и рамката на леглото. Направете справка с препоръчаните размери на матраци от производителите на леглото. За допълнителни подробности се свържете с Arjo.

Забавяне на горенето:



Системата отговаря на изискванията на BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, и BS 6807: 2006, 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЖАР

Цигари, запалки, открити пламъци и открити нагревателни елементи, като например електрически камини (и други електрически уреди) са източници на опасност от пожар и могат да доведат до подпалване на бельото на леглото, завивките и дрехите.
От особена важност е тези източници на запалване да се държат далеч от матрака.

Забележка: Изключително опасно е да се пуши в легло.

Изхвърляне след края на жизнения цикъл

Препоръчително е да се спазва следното:

- Тъканите на матраките или каквото и да са други текстилни, полимерни или пластмасови материали и т.н., трябва да се сортират като горими отпадъци.
- След края на жизнения си цикъл матраките трябва да се изхвърлят съгласно националните или местните изисквания, които може да включват изхвърляне в депо за отпадъци или изгаряне.

Забележка: Спазвайте всички местни нормативни разпоредби и, ако е приложимо, стандартните работни процедури на здравното заведение.

Гаранция и сервизно обслужване

Към всички продажби са приложими стандартните правила и условия. При поискване се предлага копие. Те съдържат пълните подробности за гарционните условия и не ограничават установените по закон права на потребителя.

За сервизно обслужване, поддръжка и въпроси, свързани с този или който и да е друг продукт, се свържете с местния дистрибутор.

Символи



Препоръчителна температура на пране: 15 мин при 60°C
Максимална температура на пране: 15 мин при 95°C



Да не се глади



Не използвайте почистващи фенолни разтвори



Име на болницата



Сушене в сушилня при 60°C
Максимална температура на сушене 80°C



Избръшете всички повърхности с почистващ разтвор, след това избръшете с кърпа, навлажнена с вода, и подсушете щателно.



Дата на първо използване



Направете справка с инструкциите за потребителя



Рутинна дезинфекция: 1000 ppm.



Забавяне на горенето



Безопасно работно натоварване (БРН)
140 kg / 309 фунта



CE маркировка, показваща съответствие с хармонизираното законодателство на Европейската общност



Указва, че продуктът е медицинско устройство съгласно Регламент 2017/745 на ЕС относно медицинските изделия

BG



UPOZORENJE

Da biste izbjegli ozljede, uvijek pročitajte ove Upute za upotrebu i popratne dokumente prije upotrebe proizvoda.



Obavezno pročitajte Upute za upotrebu.

HR

Politika dizajna i autorsko pravo

® i ™ zaštitni su znakovi koji pripadaju grupaciji Arjo.


© Arjo 2019.

Budući da je naša politika stalno poboljšavanje, zadržavamo pravo izmjene dizajna bez prethodne obavijesti. Sadržaj ove publikacije ne smije se kopirati ni u cijelosti ni djelomično bez pristanka tvrtke Arjo.

Opisi proizvoda

Sustav zamjene madraca

Konstrukcija zamjenskog madraca Pentaflex® Elegance sastoji se od reverzibilne visokootporne poliuretanske jezgre s mogućnošću četverostranog okretanja i 5 anatomske zona za preraspodjelu pritiska po stranici, zaštićene dvostranom rastezljivom, paropropusnom, vodoootpornom navlakom.

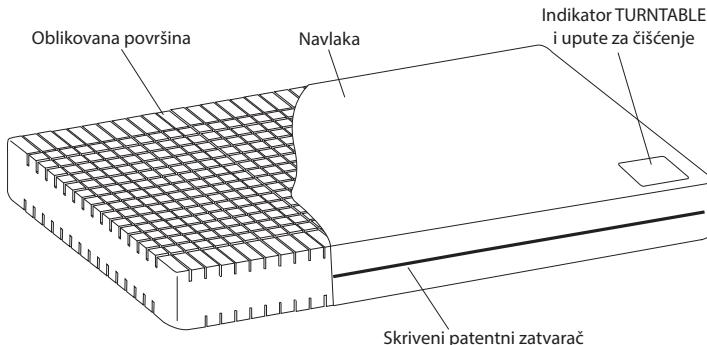

Pjenasti naslon *Pentaflex Elegance* (kat. br. SQB2) dostupan je za upotrebu s ugrađenim produžecima za krevet čime se dobiva 15 cm za više pacijente.

UPOZORENJE

Ručice madraca služe samo za prijenos madraca.

Kliničke primjene

Indikacije za upotrebu

Pentaflex Elegance indiciran je za korisnike težine do 140 kg (308 lbs/22st.). Prikladno za širok spektar pacijenata, uključujući one s površinskim dekubitusima (u kombinaciji s individualiziranim planom skrbi).

Napomena: Ovo su samo smjernice i ne bi trebale biti zamjena za iskustvo ili procjenu liječnika. Ako ne dođe do poboljšanja pacijentova stanja, potražite stručni savjet.

UPOZORENJE

Navlaka ovog proizvoda propusna je za isparavanja, ali ne i za zrak te može predstavljati opasnost od gušenja. Njegovatelj mora osigurati da korisnik upotrebljava ovaj proizvod na siguran način.

Ako dođe do ozbiljne nezgode s ovim medicinskim uređajem koja utječe na korisnika ili pacijenta, korisnik ili pacijent treba prijaviti taj incident proizvođaču ili dobavljaču medicinskog uređaja. U Europskoj uniji korisnici također trebaju prijaviti incident ovlaštenom tijelu u državi članici u kojoj se nalaze.

Upute za upotrebu

Sustav zamjene madraca

1. Uklonite cijelokupnu ambalažu.
2. Položite zamjenski madrac *Pentaflex Elegance* na okvir kreveta pazeći da nema oštih rubova koji bi mogli rasporiti madrac.

OPREZ

Madrac ne upotrebljavajte bez navlake. Ona pruža zaštitnu barijeru protiv biološke kontaminacije pjene.

HR

3. Provjerite prikazuje li se ispravan mjesec na indikator Turntable™ u podnožju pokrova. Ako se prikazuje neispravan mjesec, zarotirajte madrac tako da se u podnožju prikazuje ispravan mjesec. Mjeseci su označeni na sljedeći način:
1/12 = siječanj
2/12 = veljača, itd.
4. Upotrijebite indikator Turntable kao smjernicu za mjesечно rotiranje i okretanje madraca. To pomaže u ravnomjernjem trošenju madraca i produljenju životnog vijeka proizvoda.

Dekontaminacija

Postupak čišćenja navlake

Prebrišite sve izložene površine krpom navlaženom običnim deterdžentom i vodom. Obavezno uklonite sve organske ostatke koji su se možda prilijepili za površine. Dobro osušite.

Postupak dezinfekcije navlake

Za dezinfekciju preporučujemo sredstvo koje otpušta klor, kao što je NaOCl ili NaDCC razrijeđen na 1.000 ppm (raspon može varirati između 250 i 10.000 ppm, ovisno o stanju kontaminacije i lokalnim propisima).

Obrišite krpom navlaženom čistom vodom i temeljito osušite.

Umjesto toga možete upotrijebiti krpnu navlaženu alkoholom (70 %) i pustiti da se osuši na zraku.

Redovni pregledi

Pjenastu jezgru i navlaku treba redovno pregledavati kako bi se utvrdilo ima li znakova oštećenja, zaprljanja ili mrlja.

Tehnički podaci

Tipične dimenzije kreveta			Dimenzije jednostrukog kreveta za hitne slučajevе			Standardne dimenzije za upotrebu u zajednici	Dimenzije dvostrukog kreveta za upotrebu u zajednici
Pogodno za upotrebu na okviru kreveta tvrtke Arjo	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 i 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 i Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 i 980	-	-
Veličina (cm) D x Š x V x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Šifra proizvoda	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Materijal	Visokootporna poliuretanska pjena						
Materijal navlake	Polihidroksilna poliuretanska tkanina presvučena poliesterom poboljšane izdržljivosti						

PentaFlex Elegance dostupni su u drugim prilagođenim dimenzijama, npr. PMYYY/ZZZHx, pri čemu YYY određuje duljinu (između 140 i 216 cm), ZZZ određuje širinu (između 66 i 140 cm), a Hx broj ručica (dostupna broj ručica je 2, 4, 5, 6 ili 7). Sve dimenzije moraju se navesti u povećanjima od 2 cm.

HR

Pri kombiniranju kreveta i madraca koji ne odgovaraju specifikacijama navedenim u gornjoj tablici, kupac je dužan osigurati kompatibilnost madraca i okvira kreveta. Provjerite preporučene dimenzije madraca koje je naveo proizvođač kreveta. Za dodatne pojedinosti obratite se tvrtki Arjo.

Vatrootpornost:



Sustav ispunjava zahtjeve norme BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, i BS 6807: 2006, 5.

UPOZORENJE NA OPASNOST OD POŽARA

Cigaretе, upaljačи, otvoreni plamen i izloženi grijачи, npr. u električnim grijalicama (i drugim električnim uređajima), izvor su opasnosti od požara i mogu zapaliti posteljinu, pokrivače i odjeću. Bitno je da se ti izvori požara drže dalje od madraca.

Napomena: pušenje u krevetu iznimno je opasno.

Odlaganje u otpad

Preporučuje se sljedeće:

- Materijal tkanina, drugi tekstili ili polimeri i plastični materijal i sl. moraju se razvrstati kao zapaljiv otpad.
- Madraci se nakon isteka životnog vijeka moraju odložiti u skladu s nacionalnim ili lokalnim zahtjevima kao otpad koji može biti deponijski otpad ili zapaljivi otpad.

Napomena: Pridržavajte se svih lokalnih propisa, i ako postoje, uobičajenih postupaka za rad zdravstvene ustanove.

Jamstvo i servis

Za sve prodane proizvode vrijede standardne odredbe i uvjeti. Kopija je dostupna na zahtjev. Oni sadrže potpune pojedinosti o jamstvenim uvjetima i ne ograničavaju zakonska prava potrošača.

Za servis, održavanje i sva ostala pitanja vezana uz ovaj proizvod obratite se lokalnom distributeru.

Simboli



Preporučena temperatura pranja:
15 min na 60 °C
Maksimalna temperatura pranja:
15 min na 95 °C



Ne glačati



Nemojte upotrebljavati otopine za čišćenje na bazi fenola



Naziv bolnice



Sušiti u sušilici rublja na 60 °C
Maksimalna temperatura sušenja
80 °C



Prebrišite sve površine otopinom za čišćenje, a zatim krpom navlaženom vodom te temeljito osušite.



Datum prve upotrebe



Pogledajte Korisničke upute



Redovna dezinfekcija: 1.000 ppm.



Vatrootpornost



Sigurnosno radno opterećenje
(SWL) 140 kg / 309 lb



CE oznaka označava usklađenost sa zakonodavstvom Europske zajednice



Znači da je proizvod medicinski uređaj sukladno EU Direktivi o medicinskim proizvodima 2017/745

HR



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед використанням виробу уважно ознайомтеся з Інструкціями з використання й супровідними документами, щоб уникнути травм.



Обов'язково ознайомтеся з Інструкціями з використання.

УК

Методика проектування й авторське право
«®» та «™» — торгові марки, що належать групі компаній Arjo.


© Arjo, 2019 р.

Оскільки компанія дотримується політики постійного вдосконалення, вона залишає за собою право видозмінювати конструкцію без попереднього повідомлення. Повне або часткове копіювання змісту цієї публікації без згоди Arjo заборонене.

Опис виробу

Система замінника матраца

Система замінника матраца Pentaflex® Elegance складається з чотиристоронньої високоеластичної поліуретанової основи з 5 анатомічними зонами для перерозподілу тиску з кожної сторони та захисного двостороннього еластичного проникного для пари водонепроникного чохла.

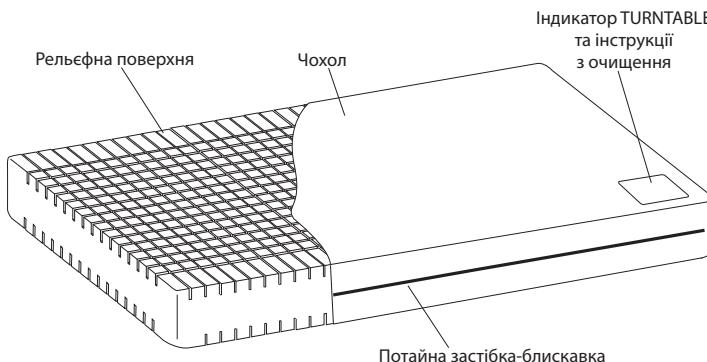

З умонтованими подовжувачами ліжка можна використовувати подушку Pentaflex Elegance зі спіненого матеріалу (номер деталі SQB2), яка дає змогу подовжити ліжко на 15 см для вищих пацієнтів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Рукоятки призначені лише для транспортування матраца.

Застосування в медичній практиці

Інструкції з використання

Система замінника матраца Pentaflex Elegance призначена для пацієнтів вагон до 140 кг (308 фунтів / 22 стоуні). Ця система підходить для широкого кола пацієнтів, зокрема для пацієнтів із поверхневими пролежнями (слід використовувати як частину індивідуального плану лікування).

Примітка. Ці твердження є лише рекомендаційними й не замінюють експертну думку лікарів. Якщо стан здоров'я пацієнта не покращується, слід порадитися з відповідним лікарем.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Чохол цього виробу проникний для пари, але непроникний для повітря, тому існує ризик задушенння. Доглядч забов'язаний подати про те, щоб користувач міг безпечно користуватися цим виробом.

У разі серйозного інциденту, пов'язаного з даним медичним пристроєм, що стосується користувача або пацієнта, користувач або пацієнт повинен повідомити про серйозний інцидент виробника або дистрибутора цього медичного пристроя. У Європейському Союзі користувач також повинен повідомити про серйозний інцидент компетентний орган у державі-члені, в якій він перебуває.

Інструкції з використання

Система замінника матраца

1. Зніміть усі пакувальні матеріали.
2. Установіть замінник матраца Pentaflex Elegance на каркас ліжка та подбайте про те, щоб не було гострих країв, які можуть порвати чохол.

ОБЕРЕЖНО!

Не використовуйте матрац без чохла. Він захищає від біологічного забруднення спіненого матеріалу.

3. Перевірте, чи на індикаторі Turntable™ на чохлі з боку ніг пацієнта відображається правильний місяць. Якщо місяць відображається неправильно, розверніть матрац. Правильний місяць має відображатися на кінці з боку ніг. Місяці мають такий формат:
1/12 = січень
2/12 = лютий тощо.
4. Використовуйте індикатор Turntable як джерело інструкцій щодо щомісячного обертання та розвороту матраца. Це допоможе захистити матрац від зносу та подовжити строк його служби.

UK

Дезінфекція

Очищення чохла

Протріть усі відкриті поверхні тканиною, змоченою водою зі звичайним мийним засобом. Обов'язково видаліть усе органічне сміття, яке могло потрапити на поверхню. Ретельно просушіть.

Дезінфекція чохла

Для дезінфекції радимо використовувати хлоровмісні засоби, як-от NaOCl або NaDCC, з концентрацією хлору 1000 частин на мільйон (концентрація може змінюватися від 250 до 10 000 частин на мільйон залежно від місцевої політики та стану забруднення).

Протріть виріб тканиною, змоченою чистою водою, і ретельно просушіть.

Крім того, виріб можна протерти тканиною, просоченою розчином спирту (70 % об.), і висушити на повітрі.

Планові перевірки

Чохол і основу зі спіненого матеріалу слід регулярно перевіряти на наявність ознак пошкодження, забруднення або плям.

Технічні дані

Типорозмір ліжка			Розмір односпального ліжка для інтенсивної терапії			Розмір стандартного ліжка	Розмір двоспального ліжка
Придатний для використання з каркасом ліжка Arjo	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 i 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 i Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 i 980	-	-
Розмір (см) Д x Ш x Г x Р	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Код виробу	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Матеріал	Високоеластичний спінений поліуретан						
Матеріал чохла	Поліефірна тканіна з поліуретановим покриттям підвищеної міцності						

Є можливість виготовляти матраци *Pentaflex Elegance* спеціальних розмірів на замовлення, наприклад PEYYY/ZZZHx, де YYY — довжина (140–216 см), а ZZZ — ширина (66–140 см), а Hx — кількість рукояток (2, 4, 5, 6 або 7). Усі розміри слід указувати з кроком 2 см.

Комбінуючи ліжка та матраци, не перераховані в наведений вище таблиці, клієнт несе відповідальність за сумісність матраца та каркаса ліжка. Рекомендовані розміри матраців див. у документації виробників ліжок. За детальною інформацією зверніться до компанії Arjo.

UK

Вогнестійкість



Система відповідає вимогам стандартів BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, і BS 6807: 2006, 5.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ

Сигарети, запальнички, відкрите полум'я та відкриті нагрівальні елементи, наприклад в електрообігрівачах (і інших електричних пристроях) можуть бути пожежонебезпечними й можуть призвести до займання постільної білизни, ковдри та одягу.

Важливо тримати їх подалі від матраца.

Примітка. Палити в ліжку дуже небезпечно.

Утилізація після закінчення терміну служби

Візьміть до уваги такі поради:

- Тканинний матеріал, який використовується для виготовлення матраців, або будь-який інший текстильний, полімерний або пластиковий матеріал тощо слід сортувати як горючі відходи.
- Матраци в кінці терміну служби слід утилізувати як відходи відповідно до національних або місцевих вимог; їх може бути поховано на звалищі або спалено.

Примітка. Дотримуйтесь всіх місцевих норм і, якщо це застосовно, визначених у медичному закладі стандартних процедур експлуатації.

Гарантія та обслуговування

Щодо всіх продажів застосовуються стандартні положення та умови, копії яких можна отримати за запитом. Ці положення та умови містять повну інформацію щодо гарантійних умов і не обмежують законні права споживача.

З питань сервісного обслуговування, технічного обслуговування та будь-яких питань щодо цього виробу звертайтесь до місцевого дистрибутора.

Символи



Рекомендована температура прання:
15 xb за температури 60 °C
Максимальна температура прання:
15 xb за температури 95 °C



Прасувати забороняється



Забороняється використовувати мийні розчини на основі фенолу



Назва медичного закладу



Сушка в сушильній машині
за температури 60 °C
Максимальна температура сушки:
80 °C



Промийте всі поверхні мийним розчином, потім протріть вологою тканиною й ретельно просушіть



Дата першого використання



Див. інструкції з використання



Регулярна дезінфекція:
1000 частин на мільйон



Вогнестійкість



Номінальна вантажопідйомність (НВП)
140 kg / 309 фунтів



Маркування CE, яке вказує
на відповідність узгодженим
законодавчим актам
Європейського Співтовариства



Указує, що продукт є медичним
пристроем відповідно до Регламенту
ЄС 2017/745 щодо медичного
обладнання

UK



OPOZORILO

Pred uporabo izdelka vedno preberite ta navodila za uporabo in priložene dokumente, da preprečite nastanek telesnih poškodb.



Navodila za uporabo je treba obvezno prebrati.

SL

Oblikovanje in avtorske pravice

Znaka ® in ™ označujeta blagovne znamke, ki pripadajo skupini podjetij Arjo.


© Arjo 2019.

Ker si prizadevamo za nenehno izboljševanje izdelkov, si pridržujemo pravico do sprememb modelov brez predhodnega obvestila. Vsebino te publikacije je prepovedano delno ali v celoti kopirati brez predhodne privolitve podjetja Arjo.

Opis izdelka

System za zamenjavo vzmetnice

Sistem za zamenjavo vzmetnice Pentaflex® Elegance je obojestransko in 4-stranska obrniljiva ter ima visoko odporno poliuretansko jedro s 5 anatomsksimi območji za prerazporejanje pritiska, zaščiteno z 2-smerno raztegljivo prevleko, ki je prepustna za paro in vodooodporna.

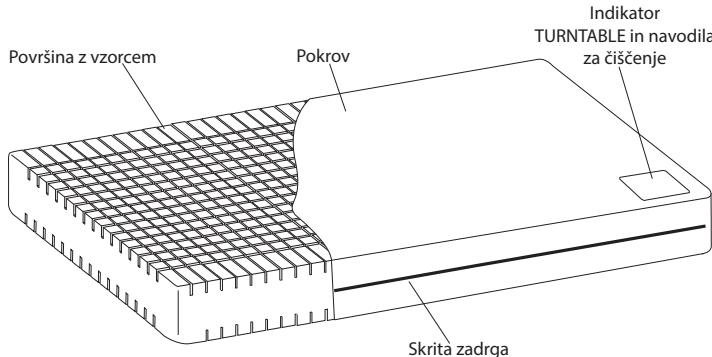

Na voljo je penasta blazina *Pentaflex Elegance* (št. dela SQB2) za uporabo z vgrajenimi podaljški postelje, ki zagotavlja dodatnih 15 cm za višje bolnike.

OPOZORILO

Ročaji vzmetnice so namenjeni samo prenašanju vzmetnice.

Klinična uporaba

Indikacije za uporabo

Pentaflex Elegance je namenjen uporabnikom s težo do 140 kg (308 lb/22 funtov).

Primerno za širok nabor bolnikov, vključno s tistimi, ki imajo površinske razjede (v povezavi s posameznim načrtom nege).

Opomba: To so le smernice in ne nadomeščajo kliničnih izkušenj ali presoje. Če se stanje bolnika ne izboljša, se morate posvetovati s specialistom.

OPOZORILO

Prevleka tega izdelka prepušča vodno paro, vendar ne prepušča zraka, zato lahko predstavlja tveganje zadušitve. Odgovornost negovalca je poskrbeti, da lahko uporabnik varno uporablja ta izdelek.

Če se zgodi resen incident v zvezi s tem medicinskim pripomočkom, ki vpliva na uporabnika ali oskrbovanca, mora uporabnik ali oskrbovanec ta incident prijaviti proizvajalcu ali distributerju medicinskega pripomočka. V Evropski uniji mora uporabnik prijaviti resen incident pristojnjemu organu v državi članici, kjer se nahaja.

Navodila za uporabo

System za zamenjavo vzmetnice:

- Odstranite vso embalažo.
- Nadomestno žimnico *Pentaflex Elegance* položite na posteljni okvir, pri čemer se prepričajte, da ni nobenih ostrih robov, ki bi lahko pretrgali prevleko.

SVARILO

Ne uporabljajte vzmetnice brez prevleke. Zagotavlja zaščitno pregrado pred biološkim onesnaženjem pene.

- Preverite, ali je na indikatorju Turntable™ ob vznožju prevleke prikazan pravilen mesec. Če ni prikazan pravilen mesec, žimnico obrnite tako, da prikazan pravilen mesec ob vznožju. Meseci so prikazani tako:
1/12 = januar
2/12 = februar itd.
- S pomočjo indikatorja *Turntable* spremljajte mesečno vrtenje in obračanje žimnice. Tako bo obraba žimnice enakomerна, življenska doba izdelka pa se bo podaljšala.

Dekontaminacija

Čiščenje prevleke

Vse izpostavljene površine očistite s krpo, ki je bila navlažena v preprostem detergentu in vodi. Odstraniti morate vse organske ostanke, ki so morda prilepljeni na površine. Temeljito osušite.

Razkuževanje prevleke

Z razkuževanje priporočamo sredstvo, ki sprošča klor, kot je NaOCl ali NaDCC, razredčeno na 1000 ppm (razpon lahko sega med 250 in 10.000 ppm, odvisno od stanja kontaminacije in lokalnih pravilnikov).

Površine obrišite z vlažno krpo in nato temeljito posušite.

Druga možnost je, da uporabite krpo, navlaženo z alkoholom (70 %), in pustite, da se posuši na zraku.

Redni pregledi

Penasto jedro in prevleko morate redno preverjati in pregledati, ali kaže znake poškodb, umazanje ali madežev.

Tehnični podatki

Običajna velikost postelje			Ena velikost za akutne primere			Standardna velikost v skupnosti	Dvojna velikost v skupnosti
Primerno za uporabo na posteljnem okvirju Arjo	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 in 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 in Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 in 980	-	-
Velikost (cm) D x Š x G x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Koda izdelka	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Material	Visoko odporna poliuretanska pena						
Material prevleke	Poliestrska tkanina s prevleko iz poliuretana z izboljšano trajnostjo						

Žimnice Pentaflex Elegance o na voljo v drugih velikostih po meri, npr. PEYYYY/ZZZHx, kjer YYYY določa dolžino (med 140 in 216 cm), ZZZ določa širino (med 66 in 140 cm), Hx pa določa število ročajev (na voljo je 2, 4, 5, 6 ali 7 ročajev). Vse velikosti morajo biti določene v korakih po 2 cm.

Če kombinirate postelje in žimnice, ki niso navedene v zgornji tabeli, je za zagotavljanje združljivosti žimnice in posteljnega okvirja odgovorna stranka. Glejte velikosti žimnic, ki jih priporoča proizvajalec vaše postelje. Za dodatne informacije se obrnite na podjetje Arjo.

SL

Odpornost na ogenj:



Sistem ustreza zahtevam standarda BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, in BS 6807: 2006, 5.

OPOZORILO PRED POŽAROM

Cigarette, vžigalniki, odprtvi ognji in izpostavljeni grelni elementi, npr. pri električnem ogrevanju (in druge električne naprave) so viri nevarnosti za požar in lahko vnamejo posteljnino, odeje in obleke. Te vire ognja morate nujno hraniti stran od žimnice.

OPOMBA: Kajenje v postelji je zelo nevarno.

Odstranjevanje ob koncu življenjske dobe

Priporočila za odlaganje:

- Tekstilni material na žimnicah ali morebitne druge tekstilije, polimere ali plastične materiale itd., je treba razvrščati kot gorljive odpadke.
- Izrabljene vzmetnice je treba odstraniti kot odpadke v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi zahtevami, to je na odlagališča ali v zažigalnice.

Opomba: upoštevajte vse lokalne predpise in, če je primerno, standardne postopke zdravstvene ustanove.

Garancija in servis

Za vse prodane izdelke veljajo običajna določila in pogoji. Kopijo dokumenta je mogoče dobiti na zahtevo. Določila in pogoji zajemajo vse podrobnejše informacije o pogojih garancije in ne omejujejo zakonskih pravic potrošnika.

Za servis, vzdrževanje in morebitna druga vprašanja v zvezi s tem izdelkom se obrnite na lokalnega distributerja.

Simboli



Priporočena temperatura pranja:
15 min pri 60°C
Najvišja temperatura pranja:
15 min pri 95 °C



Ne likajte



Pri čiščenju ne uporabljajte raztopin na osnovi fenola



Ime bolnišnice



Sušenje v sušilnem stroju pri 60 °C
Najvišja temperatura sušenja 80 °C



Vse površine pobrišite s čistilno raztopino, nato pa jih pobrišite z vlažno krpo in temeljito osušite.



Datum prve uporabe



Glejte navodila za uporabo



Redno razkuževanje: 1000 ppm.



Odpornost na ogenj



Varna delovna obremenitev (SWL)
140 kg/309 lb



Oznaka CE, ki pomeni skladnost z usklajeno zakonodajo Evropske skupnosti



Ta simbol pomeni, da je izdelek medicinski pripomoček v skladu z uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745

SL



VAROVANIE

Aby sa predišlo úrazom, pred použitím tohto výrobku si vždy prečítajte tento návod na používanie a sprievodnú dokumentáciu.



Používateľ je povinný si prečítať návod na používanie.

SK

Stratégia dizajnu a autorské práva

® a ™ sú ochranné známky patriace skupine spoločnosti Arjo.


© Arjo 2019.

Našou filozofiou je neustále zlepšovanie, preto si vyhradzujeme právo na technické zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Bez súhlasu spoločnosti Arjo nesmie byť kopírovaný obsah tejto publikácie vcelku ani po častiach.

Popisy výrobkov

Systém náhrady matraca

Dizajn náhradného matraca Pentaflex® Elegance pozostáva z obojstranného 4-smerného, vysokoodolného polyuretánového jadra s 5 anatomickými zónami redistribúcie tlaku na každej strane, ktoré chráni obojstranný, napínací paropriepustný a vodovzdorný poťah.

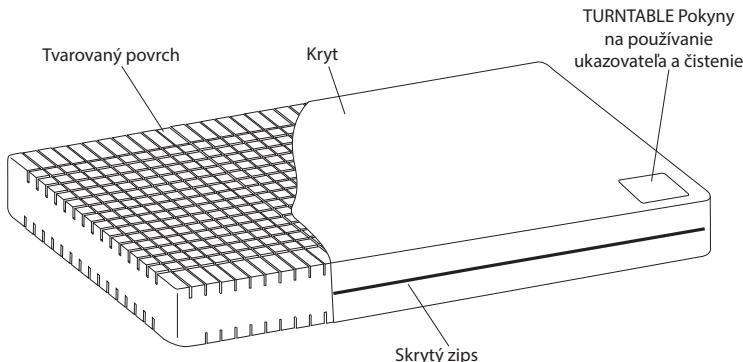

Pre zabudované predĺženia lôžka je k dispozícii penové operadlo Pentaflex Elegance (č. dielu SQB2), ktoré vyším pacientom poskytne 15 cm navyše.

VAROVANIE

Rukoväte matraca slúžia iba na jeho prepravu.

Klinické použitie

Určené použitie

Pentaflex Elegance je určený pre používateľov s hmotnosťou do 140 kg (308 lb/22 kameňov). Matrac je vhodný pre širokú škálu pacientov vrátane pacientov s povrchovými preležaniami (spolu s individuálnym plánom starostlivosti).

Poznámka: Tieto pokyny je potrebné brať len ako usmernenia. Nedokážu nahradíť odborné stanovisko lekára. V prípade, že sa stav pacienta nezlepší, vyhľadajte pomoc odborníka.

VAROVANIE

Poťah tohto produktu je paropriepustný, pričom však neprepúšťa vzduch a môže spôsobiť zadusenie. Zodpovednosťou poskytovateľa starostlivosti je zabezpečiť, aby používateľ mohol produkt používať bezpečným spôsobom.

V prípade výskytu závažného incidentu v súvislosti so zdravotníckou pomôckou, ktorý ovplyvňuje používateľa alebo pacienta, používateľ alebo pacient musia tento závažný incident nahlásiť výrobcovi alebo distribútorovi zdravotníckej pomôcky. V Európskej únii by mal používateľ tento závažný incident nahlásiť aj príslušnému orgánu v tom členskom štáte, v ktorom sa nachádza.

Návod na používanie

Systém náhrady matraca:

1. Odstráňte celý obal.
2. Náhradný matrac Pentaflex Elegance položte na rám lôžka, pričom sa uistite, že na ňom nie sú žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť poťah.

UPOZORNENIE

Matrace nepoužívajte bez poťahu. Poskytuje ochrannú bariéru pred biologickou kontamináciou peny.

3. Uistite sa, že sa na ukazovateli točne Turntable™ v nožnej časti poťahu zobrazuje správny mesiac. Ak sa nezobrazuje správny mesiac, otočte matrac tak, aby sa v nožnej časti zobrazoval správny mesiac. Mesacie sú vyjadrené nasledovne:
1/12 = január
2/12 = február atď.
4. Ukazovateľ točne Turntable používajte ako usmernenie pre mesačné točenie a obracanie matraca. Príspejte to k rovnomernejšiemu opotrebovaniu matraca a predĺženiu životnosti produktu.

SK

Dekontaminácia

Cistenie potáhu

Všetky vystavené povrhy utrite tkaninou, ktorá je navlhčená vodou s bežným čistiacim prostriedkom. Ubezpečte sa, že odstráňte všetky organické zvyšky, ktoré mohli prílnúť k povrchu. Dôkladne vysušte.

Dezinfeckia potáhu

Na dezinfekciu odporúčame používať prípravok uvoľňujúci chlór, napríklad NaOCl alebo NaDCC zriadený na 1 000 ppm (rozsah sa môže lísiť od 250 a 10 000 ppm v závislosti od úrovne kontaminácie a miestnych predpisov).

Utrite tkaninou navlhčenou v čistej vode a dôkladne vysušte.

Rovnako môžete použiť tkaninu navlhčenú v alkohole (70 %) a nechať voľne uschnúť.

Bežné kontroly

Penové jadro a poťah je potrebné pravidelne kontrolovať, či na nich nie sú známky poškodenia, znečistenia alebo škvŕny.

Technické údaje

Typické rozmery lôžka	-	-	Akútne, jednolôžko	-	-	Komunitné štandardné rozmery	Komunitné dvojlôžko
Vhodné na použitie s rámom lôžka Arjo	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 a 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 a Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 a 980	-	-
Rozmery (cm) D x Š x H x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Kód produktu	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Materiál	Vysokoodolná polyuretanová pena						
Materiál poťahu	Polyuretanom potiahnutá polyesterová tkanina so zvýšenou odolnosťou						

Matrace Pentaflex Elegance sú k dispozícii v ďalších veľkostach na mieru, napríklad PEYYY/ZZZHx, kde YYY uvádzá dĺžku (od 140 do 216 cm), ZZZ uvádzá šírku (od 66 do 140 cm) a Hx uvádzá počet držadiel (dostupný počet držadiel je 2, 4, 5, 6 alebo 7). Všetky veľkosti musia byť uvádzané v prírastkoch po 2 cm.

V prípade lôžok a matracov mimo vyššie uvedenej tabuľky je zákazník zodpovedný za zaistenie kompatibility matraca a rámu lôžka. Pozrite si odporúčané veľkosti matracov u výrobcu svojho lôžka. Ďalšie informácie vám poskytne spoločnosť Arjo.

Protipožiarna odolnosť:



Systém spĺňa požiadavky normy BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, a BS 6807: 2006, 5.

PROTIPOŽIARNE VAROVANIE

Cigarety, zapalovače, otvorené plamene a vystavené vykurovacie prvky, napríklad v elektrických kozuboch (a iných elektrických zariadeniach) sú zdroje požiarneho nebezpečenstva a môžu spôsobiť vznietenie posteľnej bielizne, paplónov a oblečenia.

Je mimoriadne dôležité, aby ste uchovávali takéto zdroje ohňa mimo matraca.

Poznámka: Fajčenie na lôžku je mimoriadne nebezpečné.

Likvidácia po dobe životnosti

Odporúča sa dodržiavať nasledovné:

- Textilný materiál používaný na matracoch a všetky ostatné textilné, polymérne či plastové materiály a pod. je potrebné separovať ako spáliteľný odpad.
- Matrace je na konci životnosti potrebné likvidovať ako odpad v súlade s vnútrosťami alebo miestnymi požiadavkami, ktoré môžu nariadiť skladku alebo spaľovanie.

Poznámka: Dodržiavajte všetky miestne predpisy a prípadne bežné prevádzkové postupy zdravotníckeho zariadenia.

Záruka a servis

Na všetky predané výrobky sa vzťahujú štandardné podmienky. Kópia je k dispozícii na vyžiadanie Obsahuje všetky podrobnosti o záručných podmienkach a neobmedzuje zákonné práva spotrebiteľa.

V prípade zájmu o servis, údržbu alebo zodpovedanie otázok týkajúcich sa tohto alebo iného produktu sa obráťte na svojho miestneho distribútoru.

Symboly



Max 95°C
15 min.

Odporúčaná teplota prania:
15 min pri teplote 60 °C
Maximálna teplota prania:
15 min pri teplote 95 °C



Nežehlite



Nepoužívajte čistiace roztoky na báze fenolu



Názov nemocnice



60°C
Max 80°

Sušte v sušičke pri teplote 60 °C
Maximálna teplota sušenia 80 °C



Všetky povrchy utrite čisticím roztokom a potom ich utrite tkaninou navlhčenou vo vode a dôkladne vysušte.



Dátum prvého použitia



Prečítajte si pokyny pre používateľa



1000ppm
NaOCl
NaDCC

Pravidelná dezinfekcia: 1 000 ppm.



Protipožiarna odolnosť



Bezpečné pracovné zaťaženie (BPZ)
140 kg/309 lb



Označenie CE indikuje zhodu s harmonizovanými právnymi predpismi Európskeho spoločenstva



Udáva, že výrobok je zdravotnícka pomôcka podľa nariadenia EÚ č. 2017/745 o zdravotníckych pomôckach

SK



BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no traumu gūšanas, pirms izstrādājuma izmantošanas vienmēr izlasiet lietošanas pamācību un tai pievienotos dokumentus.




Obligāti izlasiet šo lietošanas pamācību.

Izstrādājuma apraksts

Matrača aizstājēja iekārta

Pentaflex® Elegance matrača aizstājēja konstrukcija ietver maināmu 4 virzienu pagriešanu, augstas izturības poliuretāna apvalku ar 5 anatomiskām, spiedienu izlīdzinošām zonām, kuras aizsargā 2 virzienos elastīgs, tvaikcaurlaidīgs, ūdensnecaurlaidīgs apvalks.

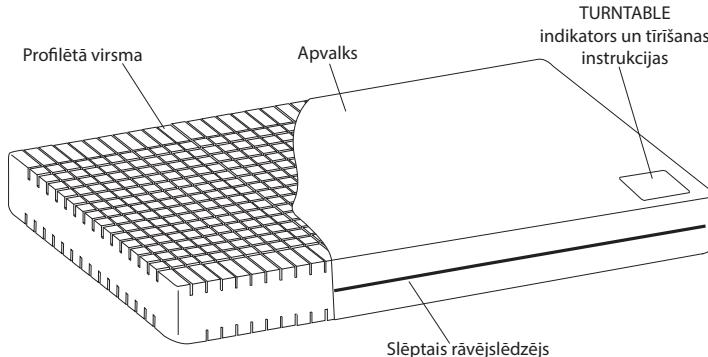

Pentaflex Elegance putu mala (daļas Nr. SQB2) ir pieejama lietošanai ar iebūvētiem gultas pagarinājumiem, nodrošinot papildu 15 cm garākiem pacientiem.

BRĪDINĀJUMS

Matrača rokturi paredzēti tikai matrača transportēšanai.

Klīniskais pielietojums

Lietošanas indikācijas

Pentaflex Elegance ir indicēts lietotājiem ar kermeņa svaru līdz pat 140 kg (308 mārciņām / 22 stouniem). Piemērots plašam pacientu lokam, tostarp pacientiem ar superficiāliem izgulējumiem (papildus individualizētam aprūpes plānam).

Piezīme. Iepriekš minētā informācija ir tikai norādījumi, kuri neaizstāj klīnisko pieredzi vai vērtējumu. Ja pacienta veselības stāvoklis neuzlabojas, meklējiet speciālista palīdzību.

BRĪDINĀJUMS

Šā izstrādājuma apvalks ir tvaikcaurlaidīgs, taču ne gaisa caurlaidīgs, tāpēc iespējams nosmakšanas risks. Aprūpes speciālists atbild par to, lai lietotājs šo izstrādājumu varētu droši lietot.

Ja saistībā ar šo medicīnisko ierīci notiek nopietns negadījums, kas ietekmē lietotāju vai pacientu, tad lietotājam vai pacientam par šonopietno negadījumu jāziņo medicīniskās ierīces ražotājam vai izplatītājam. Eiropas Savienībā lietotājam par šo nopietno negadījumu jāziņo arī kompetentajai iestādei savā mītnes dalībvalstī.

Lietošanas pamācība

Matrača aizstājēja iekārta

1. Nonemiet visu iepakojumu.
2. Novietojiet Pentaflex virsmatraci uz gultas rāmja, pārliecinieties, ka nav asu stūru, kas varētu saplēst apvalku.

UZMANĪBU!

Nelietojiet matraci bez apvalka. Apvalks nodrošina aizsargbarjeru pret bioloģisku putu kontamināciju.

3. Pārliecinieties, ka "Turntable"™ indikatorā, kas atrodas apvalka kājgalī, parādās pareizas mēnesis. Ja parādās nepareizais mēnesis, rotējiet matraci, lai kājgalī parādītos pareizais mēnesis. Mēnešiem ir šādi apzīmējumi:
1/12 = janvāris
2/12 = februāris utt.
4. Izmantojiet Turntable indikatoru kā ikmēneša rotācijas un matrača pagriešanas vadotni. Tas nodrošina vienmērīgu matrača nolietojumu un paildzina izstrādājuma kalpošanas laiku.

Attīrišana

Apvalka tīrišana

Noslaukiet visas ārējās virsmas ar parastā mazgāšanas līdzeklī un ūdenī samitrinātu drānu. Pārliecīnieties, ka ir nonemti visi organiskie pārpalikumi, kas var pieķerties virsmai. Rūpīgi nosusiniet.

Apvalka dezinficēšana

Dezinficēšanai iesakām hloru izdalošus tīrišanas līdzekļus, piemēram, NaOCl vai NaDCC, atšķaidītu līdz 1000 ppm (atkarībā no vietējās politikas un piesārņojuma stāvokļa var atšķirties robežas no 250 līdz 10 000 ppm).

Noslaukiet ar tīrā ūdenī samitrinātu drānu un rūpīgi nosusiniet.

Varat arī izmantot spirtā (70 %) samitrinātu drānu, ļaujot izžūt istabas temperatūrā.

Periodiskās pārbaudes

Regulāri pārbaudiet, vai putu pamatnei un apvalkam nav bojājumu, netīrības vai traipu pazīmju.

Tehniskie dati

Tipisks gultas izmērs	-	-	Akūtas aprūpes vienas personas izmērs	-	-	Kopienas standarta izmērs	Kopienas divguļamais izmērs
Piemērots lietošanai "Arjo" gultas rāmī	20050C "Child Anniversary" TM	"Contura" TM 420 and 430	"Contura" 350, 360, 460, 480, 560 un "Minuet" [®] 2	"Minuet" 1	"Contura" 880 un 980	-	-
Izmērs (cm) G x P x Dz x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Izstrādājuma kods	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Materiāls	Augstas izturības poliuretāna putas						
Apvalka materiāls	Ar palielinātās izturības poliestera audumu pārklāts poliuretāns						

Pieejami citu individuālu izmēru *Pentaflex Elegance* matrači, piem., PEYYY/ZZZHx, kur YYY apzīmē garumu (no 140 līdz 216 cm) un ZZZ apzīmē platumu (no 66 līdz 140 cm), Hx apzīmē rokturu skaitu (pieejamais rokturu skaits ir 2, 4, 5, 6 vai 7). Visiem parametriem ir jābūt norādītiem ar 2 cm palielinājumu.

Kombinējot gultas un matračus, kas neatbilst iepriekš minētajai tabulai, klients uzņemas atbildību par matrača un gultas rāmja saderību. Lūdzu, skatiet gultas ražotāja ieteiktos matrača izmērus. Papildinformācijai sazinieties ar "Arjo".

Ugunsizturība:



Sistēma atbilst BS EN 597-1 prasībām: 1995, BS EN 597-2: 1995, un BS 6807: 2006, 5.

BRĪDINĀJUMS PAR UGUNSBĪSTAMĪBU

Cigaretes, šķiltavas, atklātas liesmas un ārēji siltumelementi, piem., elektriskos kamīnos (un citās elektroierīcēs), ir ugunsbīstamības avoti un var aizdedzināt gultasvelu, segas un apģērbu.
Ir joti svarīgi turēt šos uguns avotus lielā attālumā no matrača.

NB: smēķēšana gultā ir joti bīstama!

Nodošana apsaimniekošanai darbmūža beigās

Iz ieteicams ievērot tālāk minētos ieteikumus.

- Matračiem izmantotā drēbe vai visi pārējie tekstilmateriāli, polimēri vai plastmasas materiāli u. c. jāklasificē kā degošie atkritumi.
- Matrači darbmūža beigās saskaņā ar valsts vai vietējiem noteikumiem jānodod apsaimniekošanai kā poligonā noglabājami vai dedzināmi atkritumi.

Piezīme. levērojet visus vietējos noteikumus un, ja piemērojams, veselības aprūpes iestādes standarta darba procedūras.

Garantija un serviss

Visiem pārdotajiem izstrādājumiem piemērojami standarta noteikumi un nosacījumi. Pēc pieprasījuma pieejama dokumenta kopija. Noteikumos iekļauta informācija par garantijas nosacījumiem, un tā neierobežo patēriņtāja likumīgās tiesības.

Lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai iegūtu informāciju par apkopi, uzturēšanu vai jebkādiem jautājumiem saistībā ar šo vai jebkuru citu izstrādājumu.

Apzīmējumi

Ieteicamā mazgāšanas temperatūra:

15 min 60 °C temperatūrā

Maksimālā mazgāšanas temperatūra:

15 min 95 °C temperatūrā



Negludināt.



Neizmantot tīrīšanas šķīdumus uz fenola bāzes



Slimnīcas nosaukums



Žāvēt velas žāvētājā

60 °C temperatūrā

Maksimālā žāvēšanas temperatūra: 80 °C



Noslaukiet visas virsmas ar mazgāšanas līdzekli, tad noslaukiet ar ūdeni samitrinātu drānu un rūpīgi nosusiniet.



Pirmās lietošanas reizes datums



Izlasiet šo lietošanas pamācību.



Periodiska dezinficēšana:
1000 ppm.



Ugunsizturība



Pieļaujamā darba slodze (SWL)
140 kg / 309 mārciņas



Apzīmējums CE norāda atbilstību Eiropas Kopienas saskaņotajai likumdošanai



Norāda, ka izstrādājums ir medicīniska ierīce saskaņā ar ES Medicīnisko ierīču regulu 2017/745

LV



ISPĖJIMAS

Prieš pradėdami naudoti gaminį, kad išvengtumėte sužalojimo, visada perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir pridedamus dokumentus.



Būtina perskaityti naudojimo instrukciją.

LT

Dizaino taisyklės ir autorų teisės

® and ™ yra „Arjo“ bendrovių grupės prekių ženklai.


© „Arjo“, 2019.

Kadangi mes siekiame nuolatinio tobulėjimo, pasiliekame teisę atlikti dizaino pakeitimus be išankstinio pranešimo. Leidinyje esančią informaciją ar jos dalis draudžiama kopijuoti be „Arjo“ leidimo.

Gaminiai aprašymai

Čiužinio keitimo sistema

„Pentaflex® Elegance“ čiužinio keitimo sistemą sudaro 4-iomis kryptimis apverčiamas, labai tamprus poliuretano pagrindas su 5-iomis anatominio spaudimo paskirstymo zonomis kiekvienoje pusėje, apsaugotomis 2-iem kryptimis ištempiamu, garams laidžiu ir vandeniu atspariu užvalkalu.

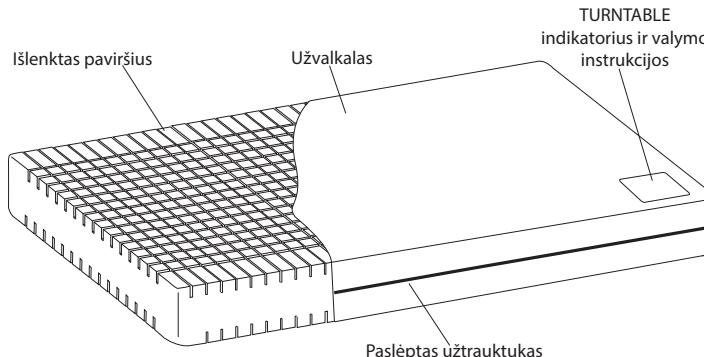

„Pentaflex Elegance“ putų pagalvėlę (dalių nr. SQB2) galima naudoti lovų pailginimuose; jie suteikia papildomai 15 cm aukštesniam pacientui.

ĮSPĖJIMAS

Čiužinio rankenos yra skirtos tik čiužiniui gabenti.

Klinikinio naudojimo paskirtys

Naudojimo indikacijos

„Pentaflex Elegance“ yra indikuota naudotojams iki 140 kg (308 sv. / 22 akmenys). Tinka įvairiems pacientams, išskaitant turinčius paviršines opas (taikant individualų priežiūros planą).

Pastaba: Tai yra tik rekomendacijos ir jos negali pakeisti klinikinės patirties ar įvertinimo. Jeigu paciento būklė nepagerėja, reikėtų kreiptis patarimo į specialistą.

ĮSPĖJIMAS

Šio gaminio užvalkalas praleidžia garus, bet nepraleidžia oro, todėl gali kilti grėsmė uždusti.
Saugytojas privalo užtikrinti, kad naudotojas galėtų saugiai naudoti šį gaminį.

Įvykus rintam su šiuo medicinos prietaisu susijusiam incidentui, turinčiam poveikio naudotojui arba pacientui, naudotojas arba pacientas turi apie tai pranešti medicinos prietaiso gamintojui arba platintojui. Be to, Europos Sajungoje naudotojas turi pranešti apie rintą incidentą kompetentingai institucijai, išskūrusiai jo buvimo vietas valstybėje narėje.

Naudojimo instrukcijos

Čiužinio keitimo sistema

1. Nuimkite visą pakuoṭę.
2. Padėkite „Pentaflex Elegance“ čiužinio pakeitimo sistemą ant lovos rémo, išsitikinę, kad nėra ašturių kraštų, galinčių suplešti užvalkalą.

ATSARGIAI

Nenaudokite čiužinio be užvalkalo. Jis apsaugo nuo putplasčio biologinės taršos.

3. Išsitinkinkite, kad „Turntable™“ indikatoriuje, užvalkalo apačioje, yra rodomas tinkamas ménuso. Jeigu rodomas netinkamas ménuso, pasukite čiužinį, kad kojūgalyje būtų rodomas tinkamas ménuso. Ménesiai yra rodomi taip:
1/12 = sausis
2/12 = vasaris ir t. t.
4. Naudokite Turntable indikatorių kaip orientyrą kas ménesij pakeisti ir čiužiniui pasukti. Tai padės vienodai nudėvėti čiužinį ir pailgins gaminio naudojimo trukmę.

LT

Nukenksminimas

Užvalkalo valymas

Nuvalykite visus atvirus paviršius šluoste, sudrėkinta paprastu plovikliu ir vandeniu. Būtinai pašalinkite visus organinius nešvarumus, kurie gali būti prilipę prie paviršių. Krupočiai išdžiovinkite.

Užvalkalo dezinfekavimas

Dezinfeikuoti rekomenduojame naudoti chlorą išskiriančias medžiagas, pavyzdžiui, NaOCl ar NaDCC, praskiestas iki 1000 ppm (intervalus gali skirtis nuo 250 iki 10 000 ppm priklausomai nuo užterštumo būsenos ir vietinės tvarkos).

Techniniai duomenys

Iprastas lovos dydis	-	-	„Acute“ viengulė	-	-	„Community“ standartinio dydžio	„Community“ dvigulė
Tinka naudoti su „Arjo“ lovos rému	„20050C Child Anniversary™“	„Contura™ 420“ ir 430	„Contura 350“, 360, 460, 480, 560 ir „Minuet® 2“	„Minuet 1“	„Contura 880“ ir 980	-	-
Dydis (cm) I x P x G x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
„PENTAFLEX ELEGANCE“ Gaminio kodas	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Medžiagos	Labai tamprus poliuretano putplastis						
Užvalkalo medžiaga	Padidinto patvarumo poliuretanu dengtas poliesterio audinys						

„Pentaflex Elegance“ čiužinius galima įsigyti kitų pritaikytų dydžių, pvz., PEYYY/ZZZHx, kur YYY yra ilgis (nuo 140 iki 216 cm), o ZZZ – plotis (nuo 66 iki 140 cm), Hx reiškia rankenų skaičių (galimas rankenų skaičius – 2, 4, 5, 6 ar 7). Visi dydžiai turi būti nurodyti 2 cm tikslumu.

Kai deriname lovas ir čiužinius ne pagal pirmiau pateiktą lentelę, klientas privalo užtikrinti čiužinio ir lovos rémo suderinamumą. Žr. lovos gamintojų rekomenduojamus čiužinio dydžius. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Arjo“.

Antipireninės savybės:



Sistema atitinka BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, ir BS 6807: 2006, 5.

ISPĖJIMAS DĖL GAISRO

Cigaretės, žiebtuvėliai, atvira liepsna ir atviri kaitinimo elementai, pvz., elektriniuose židiniuose (ir kituose elektriniuose prietaisuose) yra gaisro pavojaus šaltiniai ir jie gali uždegти patalynę, antklodes ir drabužius. Svarbu, kad šie gaisro šaltiniai būtų laikomi atokiau nuo čiužinio.

Dėmesio! Rūkyti lovoje yra labai pavojinga.

Šalinimas pasibaigus naudojimo laikui

Rekomenduojami šie patarimai.

- Ant čiužinių naudotų audinių medžiagą ar visus kitus tekstilinius gaminius, polimerus ar plastikines medžiagas ir pan. reikia rūšiuoti kaip degias atliekas.
- Pasibaigus naudojimo laikotarpiui čiužinius reikia šalinti kaip atliekas pagal nacionalinius ar vietinius reikalavimus, pvz., sąvartyne arba sudeginant.

Pastaba. Laikykite visų vietinių taisyklių ir, jeigu taikytina, sveikatos priežiūros įstaigos standartinių veiklos procedūrų.

Garantija ir remontas

Iprastinės sąlygos taikomos visiems parduodamiesiems gaminiams. Kopiją galima gauti paprašius. Jose pateikiamas išsamios garantijos sąlygos ir jos neapriboja įstatymų nustatytą naudotojo teisių.

Dėl remonto, techninės priežiūros ir kitų klausimų, susijusių su šiuo ar bet kokiui kitu gaminiu, kreipkitės į vietinį platintoją.

Simboliai



Max 95°C
15 min.

Rekomenduojama skalbimo temperatūra: 15 min. esant 60 °C
Maksimali skalbimo temperatūra: 15 min. esant 95 °C



Nelyginti laidyne.



Nenaudoti valymo tirpalu su fenolais



Ligoninės pavadinimas



Max 80°

Džiovinti elektriniame džiovintuve 60 °C temperatūroje
Maksimali džiovinimo temperatūra 80 °C



Visus paviršius nuvalykite valymo tirpalu, po to nuvalykite vandenye sudrékinta šluoste ir kruopščiai išdžiovinkite.



Pirmais panaudojimo data



Žr. naudotojo instrukciją



Iprastas dezinfekavimas: 1000 ppm.



Antipirenenės savybės



Saugi darbinė apkrova
140 kg / 309 svarai



CE ženklinimas, rodantis atitinkti Europos Bendrijos derinamiesiems teisés aktams



Nurodo, kad gaminys yra medicinos prietaisas pagal ES Medicininos prietaisų reglamentą 2017/745

LT



HOIATUS

Vigastuste vältimiseks lugege kasutusjuhend ja muud toote komplekti kuuluvad dokumendid enne toote kasutamist kindlasti läbi.



Kasutusjuhendi lugemine on kohustuslik.

ET


Konstruktsionipõhimõtted ja autoriõigus
® ja ™ on Arjo kontsernile kuuluvad kaubamärgid.
© Arjo 2019.

Kuna meie tegevuspõhimõtete hulka kuulub ka pidev täiustamine, jätame endale õiguse muuta konstruktsioone ilma eelneva ettteteatamiseta. Väljaande sisu ei tohi ilma Arjo nõusolekuta täielikult ega osaliselt kopeerida.

Toote kirjeldus

Survet ümber jaotav madratsisüsteem

Survet ümber jaotav madratsisüsteem Pentaflex® Elegance koosneb neljasuunaliselt ümberpööratavast ülitugevast polüuretaansüdamikust, mille igal küljel on viis anatoomilist surve ümberjaotustsooni ning mida katab kahesuunaliselt veniv auru läbilaskev veekindel kate.

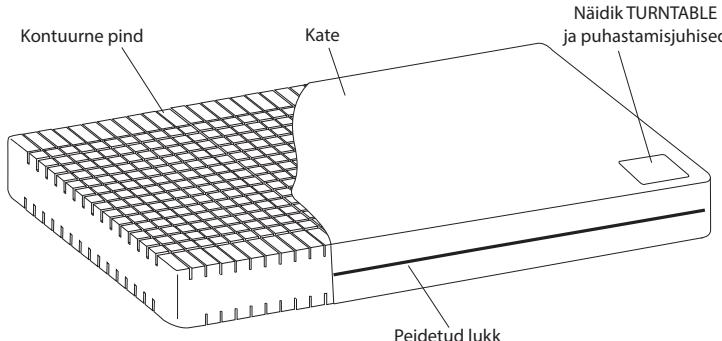

Sisseehitatud voodipikendustega kasutamiseks on saadaval Pentaflex Elegance'i vahtpadi (osa nr SQB2), mis teeb voodi pikema patsiendi jaoks 15 cm pikemaks.

HOIATUS

Madratsi käepidemed on möeldud vaid madratsi transportimiseks.

Kliinilised rakendused

Näidustused

Pentaflex Elegance on möeldud kuni 140 kg (308 lb / 22 naela) kaaluvatele kasutajatele. Sobib paljudele patsientidele, sealhulgas pindmiste haavanditega patsientidele (koos individuaalse hoolduskavaga).

Märkus: Need on ainult suunised ega tohiks asendada kliinilisi kogemusi ja otsuseid. Kui patsiendi seisund ei parane, tuleb pöörduda spetsialisti poole.

HOIATUS

Selle toote kate on auru läbilaskev, kuid mitte öhku läbilaskev ja võib põhjustada lämbumisohu. Hooldaja on kohustatud tagama, et kasutaja saaks seda toodet ohultult kasutada.

Kui meditsiiniseadmega seoses toimub tõsine vahejuhtum, mis mõjutab kasutajat või patsienti, peaks kasutaja või patsient sellest vahejuhtumist teatama meditsiiniseadme tootjale või edasimüüjale. Euroopa Liidus peaks kasutaja teatama tõsisest vahejuhtumist ka oma asukoha liikmesriigi pädevale asutusele.

Kasutusjuhend

Survet ümber jaotav madratsisüsteem

1. Eemaldage pakend.
2. Asetage survet ümber jaotav madratsisüsteem Pentaflex Elegance voodiraami külge, kontrollides, et puuduksid teravad servad, mis võivad katet kahjustada.

ETTEVAATUST

Ärge kasutage toodet ilma katteta. See pakub kaitsetöket vahu bioloogilise saastumise eest.

3. Veenduge, et katte jalutsis asetsev näidik Turntable™ kuvaks õiget kuud. Kui kuvatud on vale kuu, siis pöörake madratsit nii, et jalutsis oleks kuvatud õige kuu. Kuud on kuvatud järgmises vormis:
1/12 = jaanuar
2/12 = veebruar jne.
4. Kasutage näidikut Turntable madratsi igakuse pööramise ja keeramise juhisena. See aitab madratsil ühtlaselt kuluda ja pikendada toote kasutusiga.

ET

Puhastamine

Katte puhastamine

Pühkige kõik pinnad lapiga, mida on niisutatud tavalises pesuvahendis ja vees. Veenduge, et oleksite eemaldanud kõik pindadele kleepunud biojäätmeh. Kuivatage hoolikalt.

Katte desinfitseerimine

Soovitame desinfitseerimiseks kasutada klori vabastavat ainet, näiteks NaOCl või NaDCC, lahjendatud 1000 ppm-ni (vahemik võib olla 250 kuni 10 000 ppm, olenevalt saastatuse tasemest ja kohalikest eeskirjadest).

Pühkige puhtas vees niisutatud lapiga ja kuivatage pöhjalikult.

Alternatiivina võite kasutada alkoholiga (70%) niisutatud lappi ja lasta õhu käes kuivada.

Rutiinsed kontrollid

Vahtsdamikku ja katet tuleks regulaarselt kontrollida, et poleks kahjustusi või määrdumist.

Tehnilised andmed

Tüüpiline voodisuurus			Akuutse ravi üheinimesevoodi			Hooldusravi standardne suurus	Hooldusravi topeltsuurus
Sobib kasutamiseks Arjo voodiraamiga	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 ja 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 ja Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 ja 980	-	-
Suurus (cm) P × L × K × Hx (Käepide)	170 × 86 × 15 × H2	182 × 78 × 15 × H2	198 × 86 × 15 × H2	200 × 90 × 15 × H2	202 × 88 × 15 × H2	190 × 92 × 15 × H2	190 × 138 × 15 × H2
PENTAFLEX ELEGANCE Tootekood	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Materjal	Ülitugev polüuretaanvaht						
Kattematerjal	Suurendatud vastupidavusega polüuretaankattega polüesterriie						

Pentaflex Elegance'i madratsid on saadaval ka muudes mõõtmetes, nt PEYYYY/ZZZHx, kus YYY näitab pikkust (vahemikus 140 kuni 216 cm), ZZZ näitab laiust (vahemikus 66 kuni 140 cm) ja Hx näitab käepidemete arvu (käepidemete arv võib olla 2, 4, 5, 6 või 7). Kõik suurused tuleb täpsustada sammuga 2 cm.

Ülaltoodud tabelisse mittekuuluvate voodite ja madratsite kombineerimisel on kliendi kohustus tagada madratsi ja voodiraami ühilduvus. Palun vaadake vooditootja soovitatud madratsisuurus. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Arjoga.

Tulekindlus



Süsteem vastab standardite BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, ja BS 6807: 2006, 5 nõuetele.

TULEHOIATUS

Sigaretid, tulemasinad, lahtine leek ja lahtised kütteelemendid, nt elektripõlengutes, (ja muud elektriseadmed) on tuleohuallikad ning võivad süüdata voodipesu, tekke ja röivaid. On oluline, et neid tuleallikaid hoitakse madratsist eemal.

NB! Voodis suitsetamine on äärmiselt ohtlik.

Kasutusjärgne kõrvaldamine

Soovitatav on järgida järgmist nõuannet.

- Madratsitel kasutatud kangamaterjal ja muid teksteile, polümeere või plastmaterjale jne peaks sorteerima põlevate jäätmetena.
- Kasutuskõlbmatud madratsid tuleks kõrvaldada jäätmetena vastavalt riiklikele või kohalikele nõuetele, mis võib tähendada prügimäge või põletamist.

Märkus: Järgige kõiki kohalikke eeskirju ja vajaduse korral tervishoiuasutuste standardset töökorda.

Garantii ja hooldus

Tüüpitingimused kehtivad kogu müügile.

Koopia on saadaval soovi korral. Tingimustes on toodud üksikasjad garantiitingimustega kohta ning nendega ei piirata kliendi seadusjärgseid õigusi.

Teeninduse, hoolduse ja mistahes muude selle toote kohta käivate küsimustega korral võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Sümbolid



Soovitatav pesutemperatuur:
15 min 60 °C juures
Kõrgeim pesutemperatuur:
15 min 95 °C juures



Mitte triikida



Mitte kasutada fenoolipõhist puhastusainet



Haigla nimi



Trummelkuivatus 60 °C juures
Kõrgeim kuivatustemperatuur
80 °C



Pühkida kõiki pindu
puhastuslahusega, seejärel
pühkida veega niisutatud lapiga
ja kuivatada korralikult.



Esmakasutamise kuupäev



Tutvuge kasutusjuhendiga



Rutiinne desinfiteerimine:
1000 ppm.



Tulekindlus



Lubatav koormus (SWL)
140 kg / 309 lb



CE märgis näitab vastavust
Euroopa Ühenduse ühtlustatud
seadusandlusele



Näitab, et toode on meditsiiniseade,
mis vastab ELi meditsiiniseadmete
määrusele 2017/745

ET



FIGYELMEZTETÉS

A sérülés elkerülése érdekében a termék használata előtt mindig olvassa el ezt a Használati útmutatót és a kapcsolódó dokumentumokat.



A Használati útmutató elolvasása kötelező!

HU

Formatervezés és szerzői jogok

Az ® és a ™ az Arjo vállalatcsoport védjegyeit jelölik.


© Arjo 2019.

Mivel cégbünk fontos elvnek tekinti a folyamatos fejlesztést, fenntartjuk a jogot, hogy a termékek konstrukcióján előzetes bejelentés nélkül bármikor változtassunk. Jelen kiadvány tartalmát minden részben, minden egészében tilos az Arjo engedélye nélkül másolni.

Termékleírások

Pótmatracrendszer

A Pentaflex® Elegance egy 4 féle helyzetbe fordítható, oldalanként 5 anatómiai nyomáselosztási zónát tartalmazó nagy ellenállóképességű poliuretán magból, valamint egy két irányban nyíló, vízálló, páraáteresztő védőhuzatból áll.

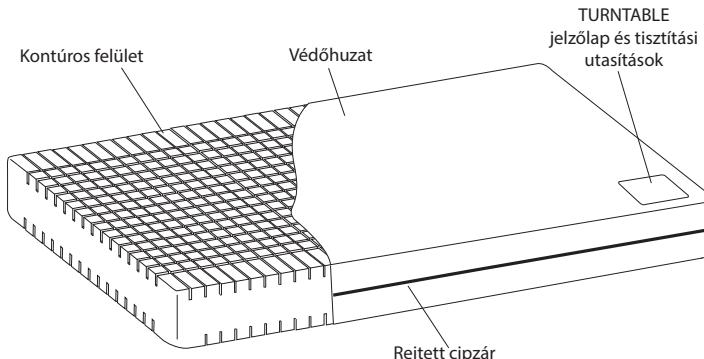

Beépített ágyhosszabbításhoz Pentaflex Elegance habszivacs támla (Cikkszám: SQB2) áll rendelkezésre, amely további 15 cm-t biztosít a magas betegek számára.

FIGYELMEZTETÉS

A matrac fogantyúi csak a matrac szállítására szolgálnak.

Klinikai alkalmazások

Használati javallat

A Pentaflex Elegance legfeljebb 140 kg (308 font / 22 kő) testsúlyú felhasználók számára készült. Betegek széles köre használhatja, köztük felszínes fekéllyel rendelkezők is (egyenre szabott kezelési tervükkel összhangban).

Megjegyzés: Az itt közölt információk csupán iránymutatásul szolgálnak, nem váltatható ki velük a klinikai tapasztalat és megtétel. Ha a beteg állapotára nem javul, specialista véleményét kell kikérni.

FIGYELMEZTETÉS

A termék védőhuzata a párat áteresztő, a levegőt azonban nem, ezért fulladást okozhat. Az ápoló feladata annak biztosítása, hogy a felhasználó biztonságosan használja a terméket.

Ha a jelen orvostechnikai eszközzel összefüggésben a felhasználót vagy a beteget érintő súlyos esemény következik be, akkor a felhasználónak vagy a betegnek jelentenie kell a súlyos eseményt az orvostechnikai eszköz gyártója vagy forgalmazója részére. Az Európai Unióban a felhasználónak a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága részére is jelentenie kell a súlyos eseményt.

Használati útmutató

Pótmatracrendszer:

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Fektesse a Pentaflex Elegance pótmatracot az ágykeretre – győződjön meg róla, hogy az ágykereten nincs olyan éles, kiálló rész, ami kárt tehet a védőhuzatban.

VIGYÁZAT

Ne használja a matracot védőhuzat nélkül. A huzat védőgátat képez a habszivacs biológiai szennyezettségével szemben.

3. Ellenőrizze, hogy a Turntable™ jelzőlap a huzat lávbégen a megfelelő hónapot mutatja-e. Ha nem a megfelelő hónap látható rajta, akkor fordítsa a matracot olyan helyzetbe, hogy a megfelelő hónap legyen a lávbégen. A hónapok jelzése a következő: 1/12 = Január
2/12 = február, stb.
4. A Turntable jelzőlap segítségül szolgál a matrac havonkénti megfordításához. Ezell egyenletekkel tehető a matrac kopása, és meghosszabbítható a termék élettartama.

HU

Dekontaminálás

A huzat tisztítása

Törölje meg a szabad felületeket egyszerű tisztítószerrel és vízzel nedvesített ruhával. Ügyeljen rá, hogy hiánytalanul eltávolítsa a felületre tapadt szerves maradványokat. Alaposan szárítsa meg.

A védőhuzat fertőtlenítése

A fertőtlenítéshez klórt felszabadító szer, például nátrium-hipoklorit vagy nátrium-diklórizocianurát 1000 ppm-es oldatát javasoljuk (a tartomány a szennyeződés állapotától és a helyi előírásoktól függően 250–10 000 ppm lehet).

Műszaki adatok

Tipikus ágyméret	-	-	Akut egyszemélyes	-	-	Szenderd ápolási méret	Kétszemélyes ápolási méret
Használható Arjo ágykereten	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 és 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 és Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 és 980	-	-
Méret (cm) H x SZ x M x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Termékkód	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Anyag	Nagy ellenállóképességű poliuretan habszivacs						
Védőhuzat anyaga	Hosszabb élettartamú, poliuretan bevontatú poliszterszövet						

A PentaFlex Elegance matracok egyéb, egyedi méretekben is rendelhetők, pl. PEYYY/ZZZHx, ahol az YYY a hosszúságot (140–216 cm), a ZZZ a szélességet (66–140 cm), a Hx pedig a fülek számát (2, 4, 5, 6 vagy 7) jelenti. A méretek 2 cm-es lépésekben adhatók meg.

A fenti táblázatban nem szereplő ágyak és matracok kombinálásakor az ügyfél felelőssége a matrac és az ágykeret kompatibilitásának biztosítása. Vegye figyelembe az ágyak gyártói által ajánlott matracmóréteket. További részletekért forduljon az Arjo cégezhez.

Tűzálló képesség:



A rendszer megfelel a következő szabványok követelményeinek: BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, és BS 6807: 2006, 5.

TÜZZEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

A cigaretta, az öngyújtó, a nyílt láng és a szabad fűtőelemek, pl. elektromos kandallóban (és egyéb elektromos készülékekben) tűzveszély forrását jelentik. Lágra lobbantathatják az ágyneműt, a takarót és a ruházatot. Az ilyen tűzforrásokat feltétlenül távol kell tartani a matractól.

FONTOS: Az ágyban dohányozni rendkívül veszélyes.

Ártalmatlanítás az életciklus végén

Az alábbiakat javasoljuk:

- A matracokon használt szövetanyagokat és az egyéb textíliákat, polimereket vagy műanyagokat stb. éghető hulladékként kell kezelni.
- Életciklusuk végén a matracokat a nemzeti vagy helyi követelményeknek megfelelően kell hulladékként ártalmatlanítani hulladéklerakóban vagy égetéssel.

Megjegyzés: Tartson be minden helyi előírást és az egészségügyi intézmény működési eljárásait.

Garancia és szerviz

Minden vásárlásra a normál feltételek vonatkoznak. Kérésre rendelkezésre bocsátunk egy példányt a feltételeket tartalmazó dokumentumból. A feltételek tartalmazzák a garanciális feltételek részleteit, és a vevő törvény által biztosított jogait nem korlátozzák.

A javítással, karbantartással, vagy a jelen termékkel vagy bármely más termékkel kapcsolatos bármilyen kérdéssel forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Szimbólumok



Max 95°C

15 min.



Ajánlott mosási hőmérséklet:

15 perc 60 °C-on

Maximális mosási hőmérséklet:

15 perc 95 °C-on



Tilos vasalni



Ne használjon fenolalapú tisztítószert



A kórház neve



Gépi szárítás 60 °C-on

A maximális szárítási hőmérséklet

80 °C



Minden felületet töröljön le tisztítóoldattal, utána vizes ruhával, majd törölje szárazra.



Az első használat dátuma



Lásd a felhasználói utasításokat



Rutinfertőtlénítés: 1000 ppm.



Tűzálló képesség



Biztonságos terhelhetőség (SWL)

140 kg / 309 font



A CE-jelölés az Európai Közösségi harmonizációs jogszabályainak való megfelelést jelzi.



Azt jelzi, hogy a termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745/EU rendelet előírásainak.

HU



UWAGA

**Aby nie doznać obrażeń, przed użyciem urządzenia
należy się zapoznać z instrukcją obsługi
i dodatkowymi do niej dokumentami.**




**Zapoznanie się z Instrukcją obsługi
jest obowiązkowe.**

Opis produktu

Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka

Materac Pentaflex® Elegance ma obrotowe, 4-kierunkowe wypełnienie wykonane z bardzo trwałego poliuretanu z 5 strefami redystrybucji ciśnienia anatomicznego po każdej stronie oraz zabezpieczone rozciągliwym w 2 kierunkach, przepuszczającym parę wodną i wodooodpornym pokrowcem.

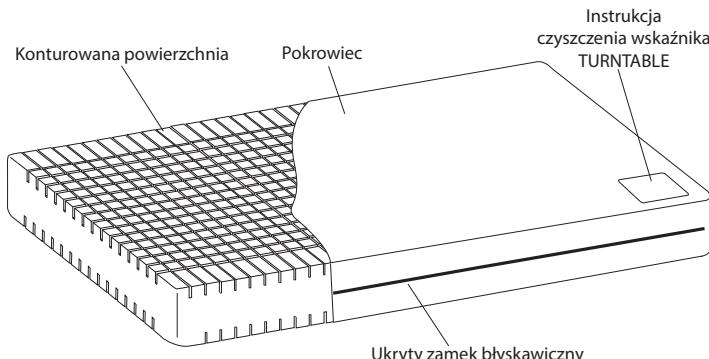

Piankowa przedłużka *Pentaflex Elegance* (nr katalogowy SQB2) jest przeznaczona do użycia ze zintegrowanym przedłużeniem łóżka i umożliwia wydłużenie o dodatkowe 15 cm dla wyższych pacjentów.

UWAGA

Uchwyty materaca służą wyłącznie do celów transportowych.

Zastosowania kliniczne

Zalecenia dotyczące użytkowania

Materac *Pentaflex Elegance* jest przeznaczony dla użytkowników o wadze do 140 kg (308 lb / 22 stones). Odpowiedni do użytkowania dla różnych pacjentów, również w przypadku odleżyn (w połączeniu z indywidualnym planem opieki).

Wskazówka: Powyższe informacje to jedynie wskazówki i nie powinny zastępować doświadczenia ani oceny klinicznej. W razie braku poprawy stanu pacjenta należy zasięgnąć specjalistycznej porady.

UWAGA

Pokrowiec tego produktu przepuszcza parę wodną, jednak nie przepuszcza powietrza, więc może stwarzać ryzyko uduszenia. Odpowiedzialność za bezpieczne korzystanie z produktu przez użytkownika ponosi opiekun.

W razie poważnego zdarzenia niepożdanego z udziałem wyrobu medycznego, które stanowi zagrożenie dla użytkownika lub pacjenta, użytkownik lub pacjent powinny zgłosić to poważne zdarzenie niepożданe do producenta lub dystrybutora wyrobu medycznego. W Unii Europejskiej użytkownik powinien także zgłosić to poważne zdarzenie niepożданe właściwemu organowi w danym kraju członkowskim.

Instrukcja obsługi

Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka:

1. Wyjąć zawartość opakowania.
2. Polóż materac *Pentaflex Elegance* bezpośrednio na ramę łóżka po uprzednim sprawdzeniu, czy nie ma na niej żadnych ostrych krawędzi, które mogłyby rozdręczyć pokrowiec.

OSTRZEŻENIE

Nie używać materaca bez pokrowca. Pokrowiec pełni rolę ochronną przed skażeniem biologicznym pianki.

3. Sprawdzić, czy na wskaźniku Turntable™, który znajduje się w części nożnej pokrowca, jest zaznaczony bieżący miesiąc. Jeśli bieżący miesiąc nie jest widoczny, obrócić materac w taki sposób, aby numer bieżącego miesiąca znalazł się w części nożnej. Miesiące są oznaczane w następujący sposób:
1/12 = styczeń
2/12 = luty itd.
4. Wskaźnik *Turntable* pomaga w comiesięcznej zmianie ustawienia materaca. Dzięki temu materac zużywa się równomiernie i zwiększa się jego żywotność.

Dekontaminacja

Czyszczenie pokrowca

Przemyć wszystkie powierzchnie miękką szmatką, zanurzoną w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Usunąć wszelkie pozostałości organiczne z powierzchni. Dokładnie osuszyć.

Desyngfekcja pokrowca

Do dezynfekcji zalecamy środek z aktywnym chloretem, np. NaOCl lub NaDCC o stężeniu 1000 ppm (stężenie może się zawierać w przedziale od 250 do 10 000 ppm w zależności od stanu zanieczyszczenia i lokalnych przepisów).

Dane techniczne

Typowy rozmiar łóżka	-	-	Oddziały intensywnej opieki — łóżko pojedyncze	-	-	Domy opieki — standardowe	Domy opieki — podwójne
Przeznaczone do użycia z ramą Arjo	20050C Child Anniversary™	Contura™ 420 i 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 i Minuet® 2	Minuet 1	Contura 880 i 980	-	-
Wymiary (cm) dł. x szer. x gł. x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE KOD PRODUKTU	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Materiał	Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości						
Materiał pokrowca	Tkanina poliestrowa powlekana poliuretanem o zwiększonej trwałości						

Na zamówienie materace PentaFlex Elegance są również dostępne w innych rozmiarach, np. PEYYY/ZZZHx, gdzie YYY oznacza długość (od 140 do 216 cm), ZZZ oznacza szerokość (od 66 do 140 cm), a Hx oznacza liczbę uchwytów (2, 4, 5, 6 lub 7). Wszystkie wymiary mogą się zmieniać co 2 cm.

W razie łączenia łóżek i materaców spoza powyższej tabeli za zapewnienie zgodności materaca z ramą łóżka odpowiada klient. Patrz rozmiar materaca zalecaný przez producenta łóżka. Więcej informacji można uzyskać od Arjo.

Ogniodporność pokrowca



Materac spełnia wymagania normy BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, oraz BS 6807: 2006, 5.

OSTRZEŻENIE POŻAROWE

Papierosy, zapalniczki, otwarty ogień oraz odsłonięte źródła ciepła, np. kominki elektryczne i inne urządzenia elektryczne, stanowią zagrożenie pożarowe i mogą spowodować zapłon pościeli, koców lub ubrań. Materac należy bezwzględnie przechowywać z dala od takich źródeł ognia.

Ważne: palenie w łóżku stwarza zagrożenie pożarowe

Utylizacja po zakończeniu eksplotacji

Zaleca się stosowanie do poniższej rady:

- Wszelkie tkaniny, polimery lub plastiki itp. posortować jako materiały łatwopalne.
- Po zakończeniu eksplotacji materace przekazać na odpady zgodnie z przepisami prawa krajowego lub lokalnego, czyniąc na składowisko lub do spalenia.

Wskazówka: stosować się do przepisów lokalnych oraz, w razie potrzeby, standardowych procedur operacyjnych zakładu opieki medycznej.

Gwarancja i serwis

Standardowe zasady i warunki mają zastosowanie do wszystkich zakupionych urządzeń. Kopia jest dostępna na żądanie. Zawiera ona szczegóły warunków gwarancji i nie ogranicza gwarantowanych ustawowo praw konsumenta.

W sprawie serwisu, konserwacji oraz wszelkich innych pytań dotyczących tego lub innego urządzenia należy kontaktować się z miejscowym dystrybutorem.

Symboly



Zalecana temperatura prania:
15 min w temp. 60°C
Maksymalna temperatura prania:
15 min w temp. 95°C.



Nie prasować



Nie używać środków czyszczących na bazie fenolu



Nazwa szpitala



Suszyć mechanicznie w temp. 60°C
Maksymalna temperatura suszenia:
80°C



Wytrzeć wszystkie powierzchnie środkiem czyszczącym, a następnie przetrzeć szmatką nawilżoną wodą i dokładnie osuszyć.



Data pierwszego użycia



Zapoznać się z instrukcją użycia



Rutynowa dezynfekcja: 1000 ppm.



Ogniodporność pokrowca



Bezpieczne obciążenie robocze (BOR)
140 kg / 309 lb



Znak CE oznaczający zgodność
ze zharmonizowanymi przepisami
Wspólnoty Europejskiej



Wskazuje, że produkt jest wyrobem
medycznym w rozumieniu
rozporządzenia o wyrobach
medycznych 2017/745



CẢNH BÁO

Để tránh thương tích, hãy luôn đọc **Hướng dẫn Sử dụng** này và các tài liệu kèm theo trước khi sử dụng sản phẩm.



Bắt buộc phải đọc Hướng dẫn sử dụng.


Chính sách thiết kế và bản quyền
® và ™ là các nhãn hiệu thuộc tập đoàn Arjo.
© Arjo 2019.

Vì chính sách của chúng tôi là cài tiến liên tục nên chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa thiết kế mà không thông báo trước. Không được phép sao chép toàn bộ hay một phần nội dung của ấn bản này trừ khi có sự đồng ý của Arjo.

Mô tả Sản phẩm

Hệ thống thay thế đệm

Thiết kế thay thế đệm Pentaflex® bao gồm vòng quay 4 chiều có thể đảo ngược, lõi polyurethane có tính đàn hồi cao với 5 vùng phân phối lại sự tỳ đè do giải phẫu mỗi bên, được bảo vệ bởi một lớp vỏ bọc có tính kéo căng 2 chiều, thấm hơi, chống thấm nước.

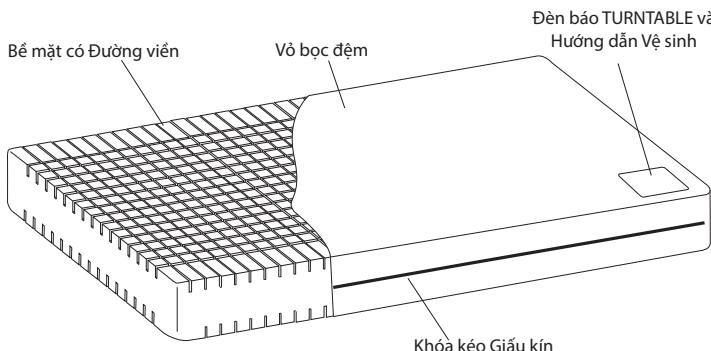

Một miếng xốp Pentaflex Elegance (phần số SQB2) được sử dụng cùng với phần mở rộng được thiết kế của giường, cung cấp 15 cm thêm dành cho bệnh nhân cao hơn.

CẢNH BÁO

Tay cầm nệm chỉ sử dụng cho vận chuyển nệm.

Ứng dụng lâm sàng

Chỉ dẫn Sử dụng

Pentaflex Elegance được chỉ định cho người dùng nặng tối đa 140 kg (308 lb/22 stōn). Thích hợp cho nhiều loại bệnh nhân, bao gồm cả những người bị loét da (kết hợp với một kế hoạch chăm sóc cá nhân).

Lưu ý: Đây là chỉ những hướng dẫn và không thay thế cho kinh nghiệm hoặc đánh giá lâm sàng. Nếu không có sự cải thiện trong tình trạng của bệnh nhân, nên tìm lời khuyên của chuyên gia.

CẢNH BÁO

Vỏ bọc của sản phẩm này có thể thấm hơi nước nhưng không thấm khí và có thể gây nguy cơ nghẹt thở. Trách nhiệm của người chăm sóc bệnh nhân là phải đảm bảo rằng người dùng có thể sử dụng an toàn sản phẩm này.

Nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng liên quan tới thiết bị y tế này, gây ảnh hưởng tới người sử dụng hoặc bệnh nhân, người sử dụng hoặc bệnh nhân phải báo cáo sự cố nghiêm trọng ấy tới nhà sản xuất thiết bị y tế hoặc nhà phân phối. Trong Liên minh châu Âu, người sử dụng cũng phải báo cáo sự cố nghiêm trọng ấy tới Cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia thành viên nơi họ đang sinh sống.

Hướng dẫn sử dụng

Hệ thống thay thế đệm:

1. Tháo bỏ tất cả bao bì.
2. Đặt hệ thống thay thế đệm Pentaflex Elegance lên khung giường, đảm bảo rằng không có cạnh sắc nhọn nào làm rách vỏ bọc đệm.

THẬN TRỌNG

Không sử dụng đệm không có vỏ bọc. Vỏ bọc cung cấp một hàng rào bảo vệ chống lại sự nhiễm bẩn sinh học cho lớp xốp.

3. Đảm bảo tháng chính xác được hiển thị trên chỉ báo Turntable™ hình tròn ở chân vỏ bọc. Nếu hiển thị tháng không chính xác, hãy xoay đệm để hiển thị đúng tháng ở phần cuối. Tháng được hiển thị như sau:
1/12 = Tháng 1
2/12 = Tháng 2 v.v
4. Sử dụng đèn báo Turntable làm hướng dẫn cho việc xoay và quay hàng tháng của đệm. Điều này giúp cho việc sử dụng đệm đến khi hao mòn và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Khử trùng

Để Vệ sinh Vỏ bọc

Lau tất cả các bề mặt tiếp xúc bằng một miếng vải đã được làm ẩm bằng chất tẩy rửa đơn giản và nước. Đảm bảo loại bỏ bất kỳ mảnh vụn hữu cơ nào có thể dính chặt vào bề mặt. Làm khô thật kỹ.

Để Khử trùng Vỏ bọc

Để khử trùng, chúng tôi khuyến cáo sử dụng chất giải phóng clo như NaOCl hoặc NaDCC pha loãng đến 1.000 ppm (phạm vi có thể thay đổi từ 250 đến 10.000 ppm tùy theo tình trạng nhiễm khuẩn và chính sách của địa phương).

Lau bằng một miếng vải thấm nước sạch và lau khô hoàn toàn.

Hoặc sử dụng vải thấm cồn (70%) để phơi khô.

Kiểm tra định kỳ

Nên kiểm tra lỗi và vỏ bọc xốp thường xuyên để kiểm tra các dấu hiệu hư hỏng, bẩn hoặc sự biến màu.

Dữ liệu kỹ thuật

Kích thước Giường Điện hình	-	-	Kích thước Đơn Cấp tính	-	-	Kích thước Tiêu chuẩn cho Cộng đồng	Kích thước Đôi cho Cộng đồng
Phù hợp để sử dụng với Khung giường Arjo	20050C Child Anniversary™	Contoura™ 420 và 430	Contura 350, 360, 460, 480, 560 và Minuet® 2	Minuet 1	Contoura 880 và 980	-	-
Kích thước (cm) D x R x C x Hx	170 x 86 x 15 x H2	182 x 78 x 15 x H2	198 x 86 x 15 x H2	200 x 90 x 15 x H2	202 x 88 x 15 x H2	190 x 92 x 15 x H2	190 x 138 x 15 x H2
PENTAFLEX ELEGANCE Mã sản phẩm	PE170/086H2	PE182/078H2	PE198/086H2	PE200/090H2	PE202/088H2	PE190/092H2	PE190/138H2
Vật liệu	Xốp polyurethane có tính đàn hồi cao						
Chất liệu của Vỏ bọc	Vải polyester phủ polyurethane được tăng cường độ bền						

Đệm PentaFlex Elegance có sẵn với các kích thước tùy chỉnh khác, ví dụ: PEYYY/ZZZHx, trong đó YYY thể hiện chiều dài (từ 140 đến 216cm) và ZZZ thể hiện chiều rộng (từ 66 đến 140cm), Hx thể hiện số lượng tay cầm (số lượng tay cầm có sẵn 2, 4, 5, 6 hoặc 7). Tất cả các kích thước phải được xác định theo giá số 2cm.

Khi ghép giường với đệm ngoài kích thước được cung cấp bên trên, khách hàng có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương thích của đệm và khung giường. Vui lòng tham khảo các nhà sản xuất giường được khuyến nghị cho kích thước đệm của bạn. Để biết thêm chi tiết, liên hệ với Arjo.

Chống cháy:



Hệ thống đáp ứng các yêu cầu của BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995, và BS 6807: 2006, 5.

CÀNH BÁO CHÁY

Thuốc lá, bật lửa, ngọn lửa trần và các yếu tố làm nóng khi tiếp xúc, ví dụ: trong các vụ cháy do chập điện (và các thiết bị điện khác) là các nguồn gây cháy và có thể đốt cháy khăn trải giường, chăn và quần áo. Điều quan trọng là các nguồn gây cháy này được giữ cách xa đệm.

NB: Rất nguy hiểm khi hút thuốc trên giường.

Tiêu hủy khi hết vòng đời sử dụng

Lời khuyên sau đây được khuyến nghị:

- Các vật liệu vải dùng cho đệm hay các vật liệu vải, polymer hay nhựa khác, vân vân... phải được phân thành rác có thể đốt được.
- Khi hết vòng đời sử dụng, đệm được coi là rác phải tiêu hủy theo yêu cầu của quốc gia hoặc địa phương, tức là có thể là rác đưa tới bãi chôn rác hoặc có thể đốt được.

Lưu ý: Tuân theo tất cả các quy định của địa phương và, nếu áp dụng, quy trình vận hành tiêu chuẩn của cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Bảo hành và Dịch vụ

Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn được áp dụng cho tất cả các giao dịch bán hàng. Một bản sao được cung cấp theo yêu cầu. Tài liệu này bao gồm đầy đủ chi tiết về điều khoản bảo hành và không giới hạn ở quyền của người tiêu dùng theo luật định.

Liên quan đến dịch vụ, bảo trì và bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm này hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác, vui lòng liên hệ nhà phân phối tại địa phương bạn.

Biểu tượng



Nhiệt độ giặt theo khuyến cáo:
15 phút ở 60°C
Nhiệt độ giặt tối đa: 15 phút ở 95°C



Không là ủi



Không sử dụng các dung dịch vệ sinh có gốc phenol



Tên bệnh viện



Sấy khô ở 60°C
Nhiệt độ sấy tối đa 80°C



Lau tất cả bề mặt bằng dung dịch vệ sinh, rồi dùng vải thấm nước lau sạch và làm khô hoàn toàn.



Ngày sử dụng đầu tiên



Tham khảo hướng dẫn sử dụng



Khử trùng định kỳ: 1.000 ppm.



Chống cháy



Tải trọng làm việc cho phép (SWL)
140 kg / 309 lb



Dấu CE chứng tỏ đã tuân thủ luật định hài hòa của Cộng đồng Châu Âu



Cho biết rằng sản phẩm này là Thiết bị Y tế theo Quy định của EU về Thiết bị Y tế 2017/745

Intentionally left blank

AUSTRALIA
Arjo Australia Pty Ltd
78, Forsyth Street
O'Connor
AU-6163 Western Australia
Tel: +61 89337 4111
Free: +1 800 072 040
Fax: +61 89337 9077

BELGIQUE / BELGIË
Arjo NV/SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 ERPE-MERE
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.be

BRASIL
Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufui Zanfelice, 329 PB02
Galpão - Lapa
São Paulo - SP - Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA
Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tel: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
e-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK
Arjo A/S
Vässingerøde vej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND
Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA
Arjo Ibérica S.L.
Parque Empresarial Rivas Futura, C/
Marie Curie 5
Edificio Alfa Planta 6 oficina 6.1.-62
ES-28521 Rivas Vacía, MADRID
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: info.es@arjo.com

FRANCE
Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG
Arjo Hong Kong Limited
Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
Tel: +852 2960 7600
Fax: +852 2960 1711

ITALIA
Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST
Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,
HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park,
Al Barsha South
P.O Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND
Arjo BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@arjo.com

NORGE
Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH
Arjo GmbH
Lemböckgasse 49 / Steige A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel: +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA
Arjo Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.
(Distribuidor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ
Arjo AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontutte 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260
E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MÄLMO
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM
Arjo UK and Ireland
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN
Arjo Japan K.K.
東京都港区虎ノ門三丁目7番8号 ランディ
ック第2虎ノ門ビル9階
電話:+81 (0)3-6435-6401

Address page - REV 24: 04/2019

At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo

CE